


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/04/2026 - 09/05/2026
Dias de utilização	6/36 dias (17%)	
>= 4 horas	4 dias (11%)	
< 4 horas	2 dias (6%)	
Horas de utilização	33 horas 34 minutos	
Utilização média (total de dias)	56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 40 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/05/2026)	3,712 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.3	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 9.8	
Fugas — l/min	Mediana: 2.0	Percentil 95.º: 15.8	Máximo: 42.4	
Eventos por hora	IA: 2.9	IH: 0.3	IAH: 3.2	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	1.4
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

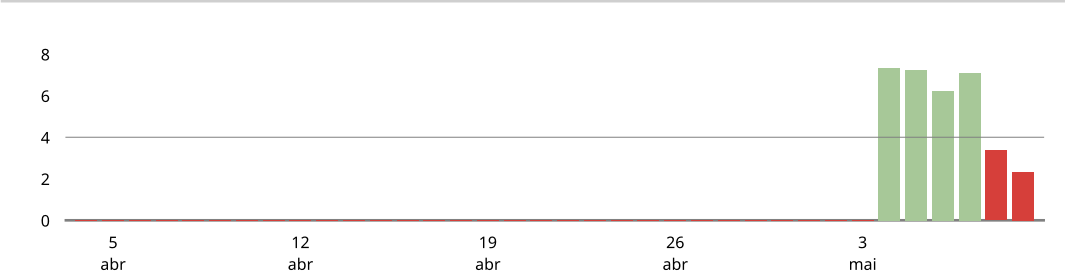


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611


Utilização (horas)

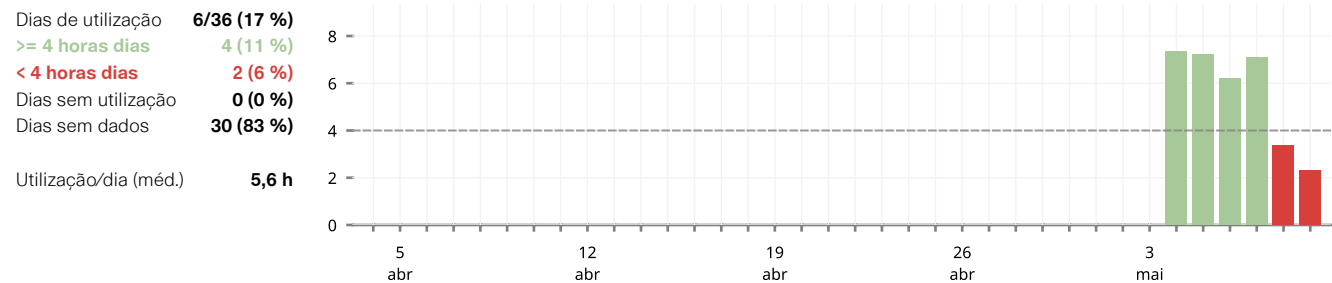

Fuga (l/min)

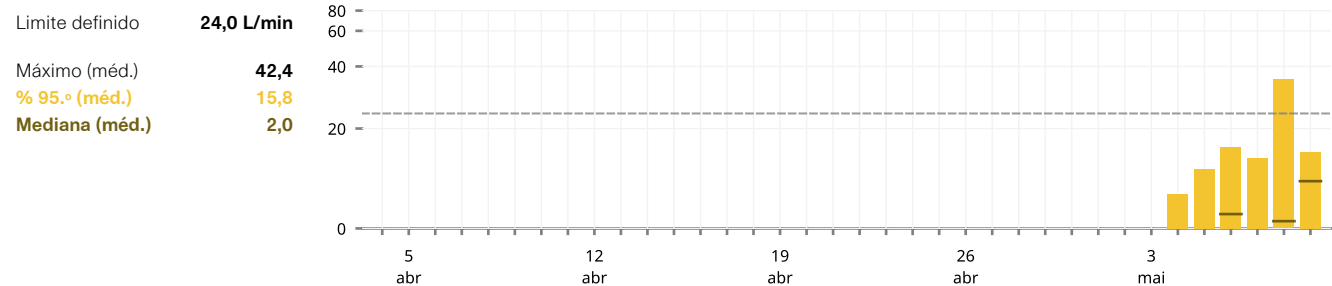

Pressão (cmH2O)

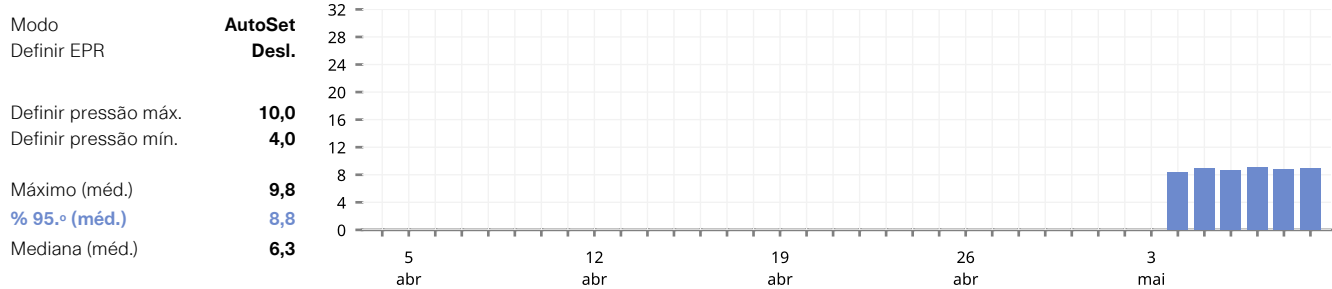

IAH (eventos/hora)

