

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. EDSON CARLOS RAMOS**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **5 novembro 1974** Idade: **51**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **25/11/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

26/10/2025 - 24/11/2025		Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191652140)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 8,6 cmH2O	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 1,0 cmH2O	Activar APE: OFF	Activação paciente APE: OFF	
Activação subida: ON	Tempo de rampa: 10,0 Minutos	Acesso: LIGADO	
Fuga - l/min			
Mediana: 7,2	Percentil 95: 34,8	Máximo/a: 48,0	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,1	Índice de hipopneia: 0,2	AHI: 0,3	
Obstrutiva: 0,0	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 0,0	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 25	Dias de Uso < 4 horas : 4	% Dias de Uso >= 4 horas : 83	
Dias de não utilização: 1	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 161:56	
Mediana do uso diário: 5:41	Média de uso diário: 5:23		


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


26/10/2025 - 24/11/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191652140)


Pressão

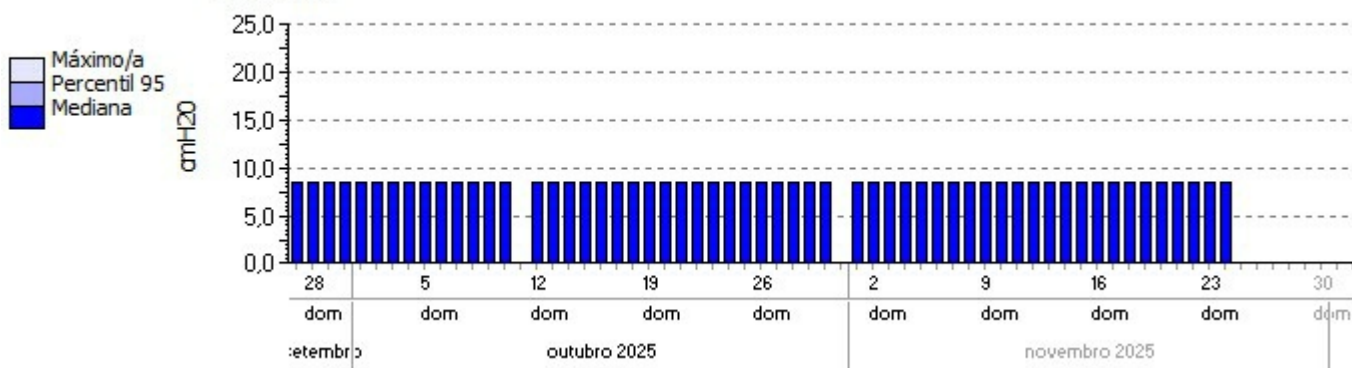


Fuga

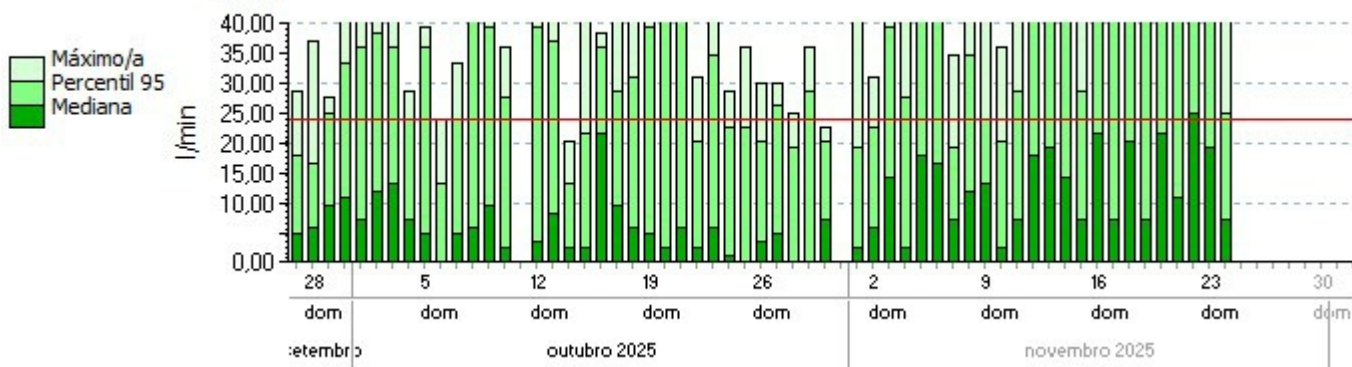

IAH & IA

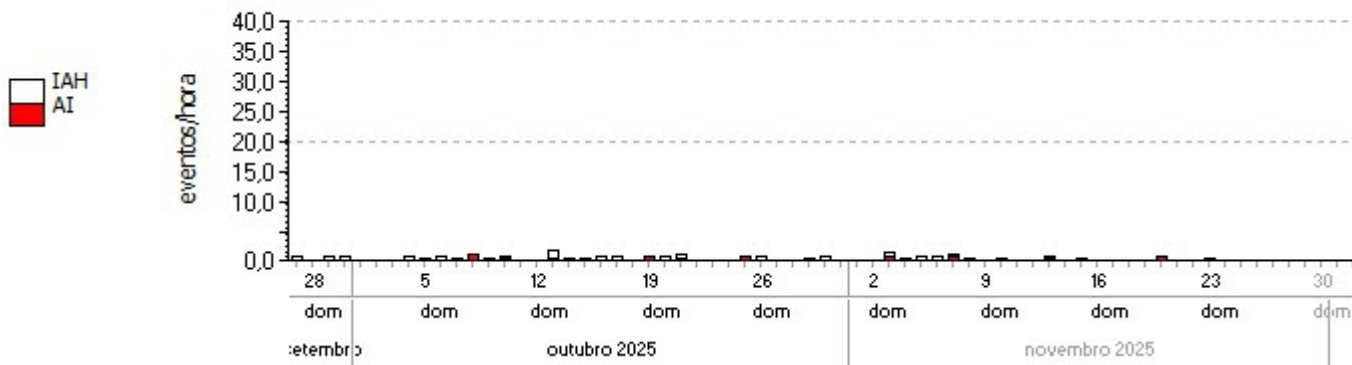

Uso

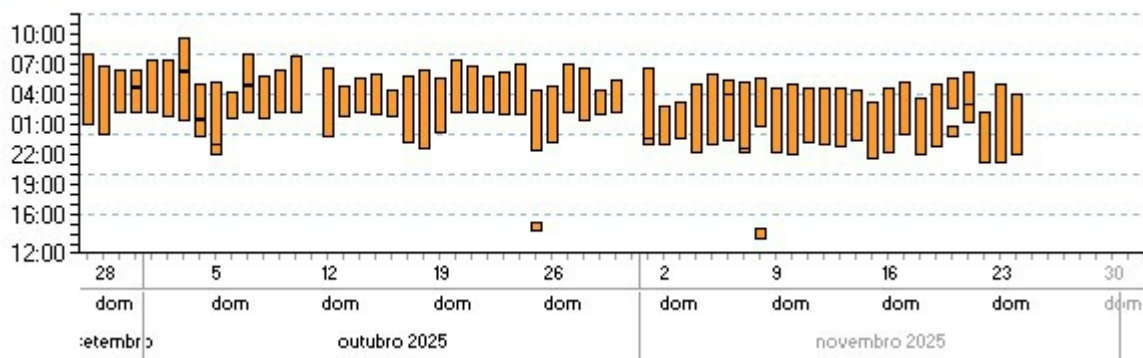

Utilização total e Cheyne-Stokes

