


Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |              | 28/10/2025 - 26/11/2025 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Dias de utilização                                           |              | 30/30 dias (100%)       |                 |
| >= 4 horas                                                   |              | 25 dias (83%)           |                 |
| < 4 horas                                                    |              | 5 dias (17%)            |                 |
| Horas de utilização                                          |              | 179 horas 33 minutos    |                 |
| Utilização média (total de dias)                             |              | 5 horas 59 minutos      |                 |
| Utilização média (dias de utilização)                        |              | 5 horas 59 minutos      |                 |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |              | 6 horas 35 minutos      |                 |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 26/11/2025) |              | 567 horas               |                 |
| AirSense 10 AutoSet                                          |              |                         |                 |
| Número de série                                              |              | 22242260535             |                 |
| Modo                                                         |              | CPAP                    |                 |
| Pressão definida                                             |              | 7.4 cmH2O               |                 |
| EPR                                                          |              | Apenas rampa            |                 |
| Nível de EPR                                                 |              | 1                       |                 |
| Terapia                                                      |              |                         |                 |
| Fugas — l/min                                                | Mediana: 2.6 | Percentil 95.º: 11.1    | Máximo: 84.1    |
| Eventos por hora                                             | IA: 2.1      | IH: 0.2                 | IAH: 2.3        |
| Índice de apneia                                             | Central: 0.5 | Obstrutiva: 0.8         | Desconhecid 0.7 |
| Índice RERA                                                  |              | 0.2                     |                 |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)           |              | 0 minutos (0%)          |                 |

Horas de utilização

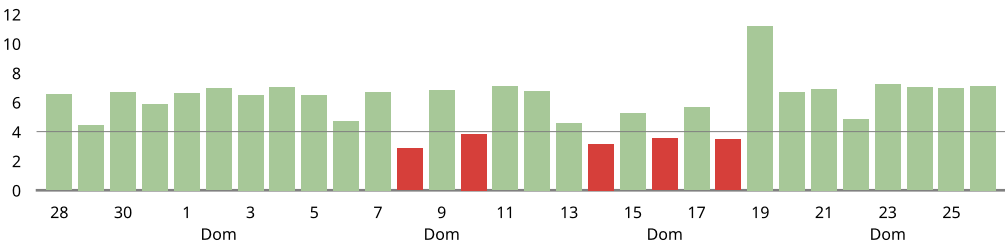


# Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260535


## Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**  
>= 4 horas dias **25 (83 %)**  
< 4 horas dias **5 (17 %)**  
Dias sem utilização **0 (0 %)**  
Dias sem dados **0 (0 %)**  
  
Utilização/dia (méd.) **6,0 h**

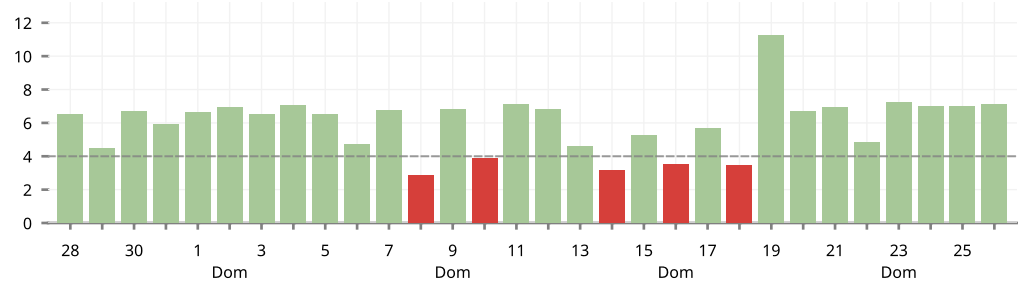


## Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**  
Máximo (méd.) **84,1**  
% 95.º (méd.) **11,1**  
Mediana (méd.) **2,6**

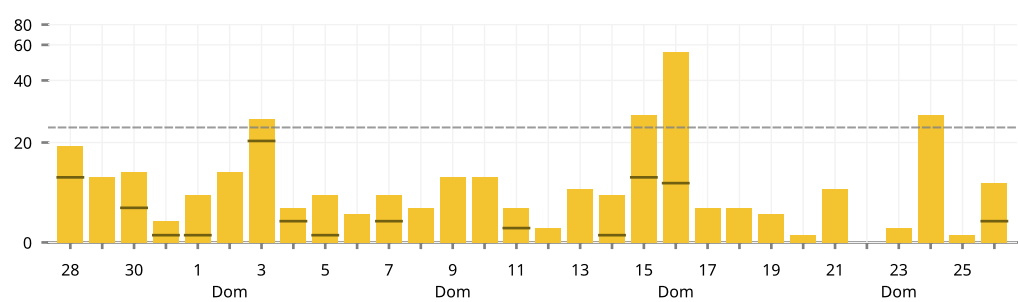

## Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**  
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**  
  
Pressão definida **7,4**

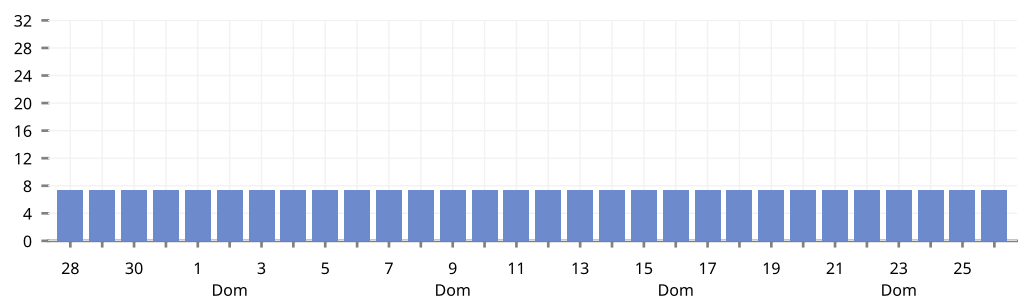

## IAH (eventos/hora)

IAH **2.3**  
IH **0.2**  
IA **2.1**  
IAC **0.5**  
IAO **0.8**  
IAD **0.7**  
RERA **0.2**  
%RCS (méd.) **0.0**

