

Data de nasc:	08/12/1986	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	04/02/2026 - 05/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	08/08/2025
ID do paciente:	ANTONIO RICARDOSI...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto BiPAP V1.1.8.3313 (700X180) J376021173C12				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 04/02/2026 - 05/03/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	04/02/2026 - 05/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	27 dias
Dias sem uso do aparelho	3 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	90,0%
Uso acumulado	7 dias 11horas. 31 min. 7 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 4 min. 24 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 59 min. 2 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 38 min. 55 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 20 min. 42 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	86,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	13,3%
Tempo total com soprador	7 dias 11horas. 50 min. 13 segundos.

Resumo de Bi-Level Automático

Titulação máxima da pressão IPAP	12,5 cmH2O
Da pressão IPAP do aparelho <= 90% do tempo	12,5 cmH2O
Titulação máxima da pressão EPAP	8,5 cmH2O
Da pressão EPAP do aparelho <= 90% do tempo	8,5 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	36 segundos.
Média de IAH	15,8


Definições do Dispositivo a partir de 05/03/2026

Modo do aparelho Auto Bi-Level - Bi-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
IPAP máx.	12,5 cmH ₂ O
EPAP mín.	8,5 cmH ₂ O
Suporte pressórico máx.	4 cmH ₂ O
Suporte pressórico mín.	4 cmH ₂ O
Configuração Bi-Flex	1
Bloqueio Bi-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso

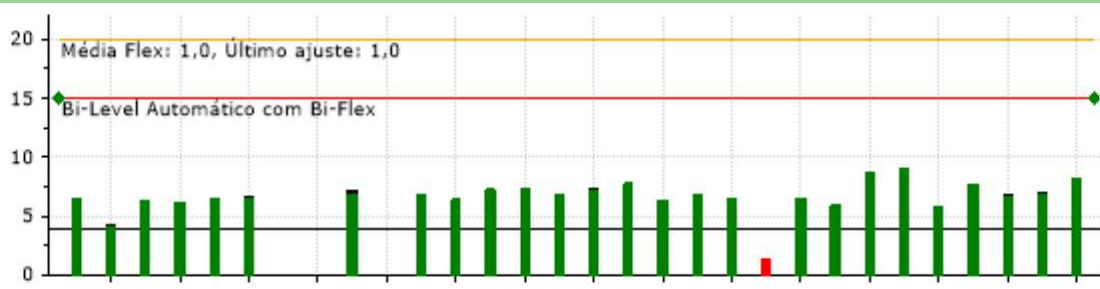

Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

