

Data de nasc:	08/12/1986	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	15/08/2025 - 31/08/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	08/08/2025
ID do paciente:	ANTONIO RICARDOSI...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto BiPAP V1.1.8.3313 (700X180) J376021173C12				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 15/08/2025 - 31/08/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	15/08/2025 - 31/08/2025 (17 dias)
Dias com uso do aparelho	17 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	5 dias 16horas. 52 min. 48 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 4 min. 15 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8horas. 3 min. 6 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8horas. 3 min. 6 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	6horas. 27 min. 45 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	5 dias 17horas. 17 min. 7 segundos.

Resumo de Bi-Level Automático

Titulação máxima da pressão IPAP	12,0 cmH2O
Da pressão IPAP do aparelho <= 90% do tempo	12,0 cmH2O
Titulação máxima da pressão EPAP	8,0 cmH2O
Da pressão EPAP do aparelho <= 90% do tempo	8,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	6 min. 4 segundos.
Média de IAH	14,6


Definições do Dispositivo a partir de 31/08/2025

Modo do aparelho Auto Bi-Level - Bi-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
IPAP máx.	12 cmH2O
EPAP mín.	8 cmH2O
Suporte pressórico máx.	4 cmH2O
Suporte pressórico mín.	4 cmH2O
Configuração Bi-Flex	1
Bloqueio Bi-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso

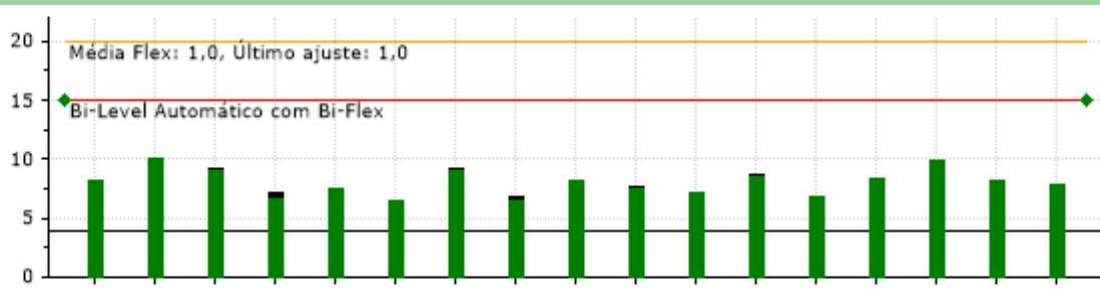

Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

