

Data de nasc: 08/12/1986

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 08/08/2025 - 14/08/2025

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA

Data de configuração: 08/08/2025

ID do paciente:

São José dos Campos, SP 12243690

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto BiPAP V1.1.8.3313 (700X180) J376021173C12

Equipa de cuidados médicosMATOS E FARIA, ANA FARIA E MATOS COMERCIO DE
CLAUDIA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDRUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA**Informações de aderência à terapêutica** 08/08/2025 - 14/08/2025**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	08/08/2025 - 14/08/2025 (7 dias)
Dias com uso do aparelho	7 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	2 dias 7horas. 6 min. 24 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 37 min. 4 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 52 min. 20 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 52 min. 20 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	7horas. 6 min. 20 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	2 dias 7horas. 6 min. 24 segundos.

Resumo de Bi-Level Automático

Titulação máxima da pressão IPAP	10,0 cmH2O
Da pressão IPAP do aparelho <= 90% do tempo	10,0 cmH2O
Titulação máxima da pressão EPAP	6,0 cmH2O
Da pressão EPAP do aparelho <= 90% do tempo	6,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	15,7

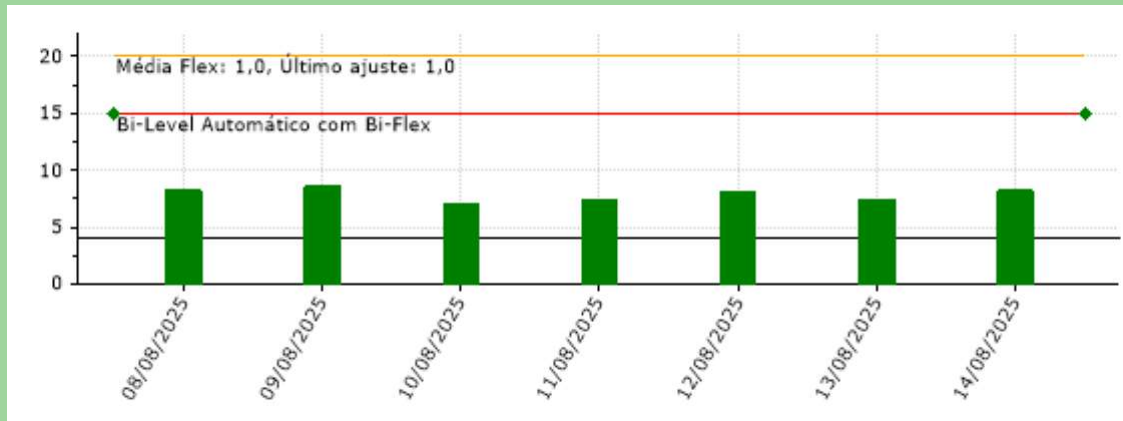
Definições do Dispositivo a partir de 14/08/2025

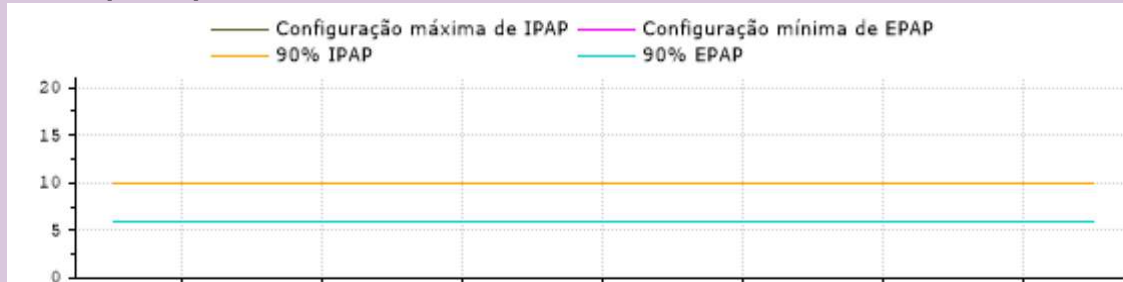
Modo do aparelho Auto Bi-Level - Bi-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
IPAP máx.	10 cmH ₂ O
EPAP mín.	6 cmH ₂ O
Suporte pressórico máx.	4 cmH ₂ O
Suporte pressórico mín.	4 cmH ₂ O
Configuração Bi-Flex	1
Bloqueio Bi-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

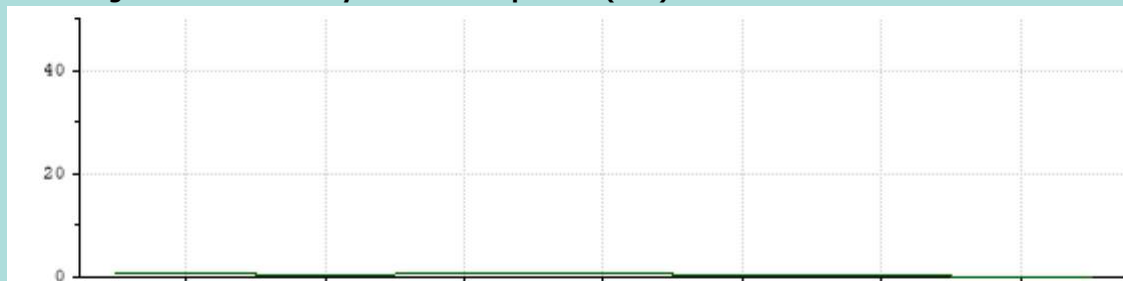
Horas de uso



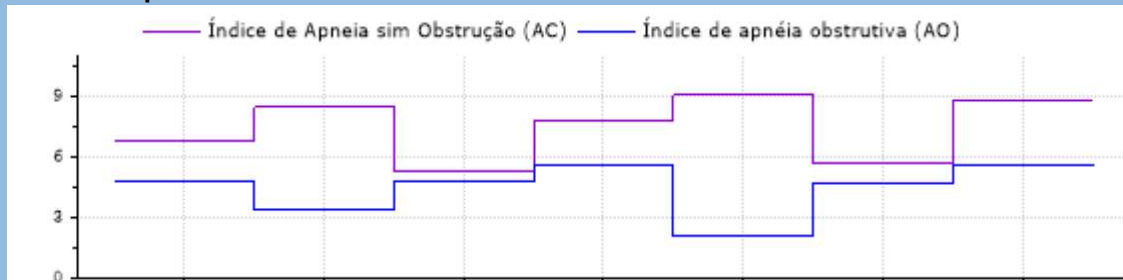
Pressão (cmH2O)

90% IPAP
10,0

90% EPAP
6,0

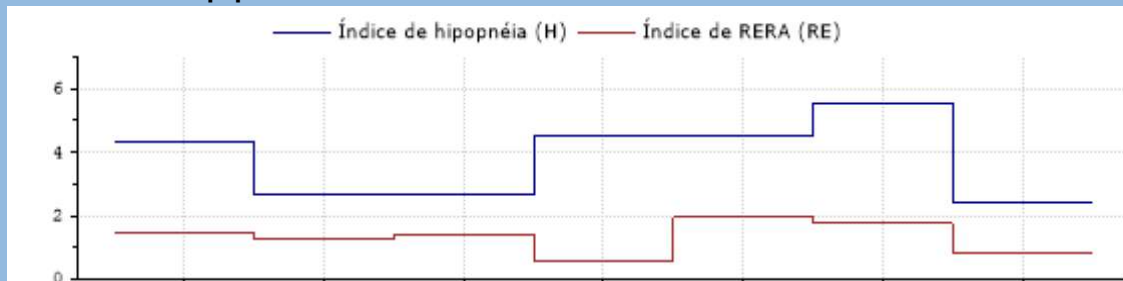
Porcentagem da noite em Cheyne-Stokes Respiration (CSR)

% média da noite em
Cheyne-Stokes Respiration
0,5%

Índices de apneia com via aérea desobstruída e via aérea obstruída

Média do índice de AC
7,5

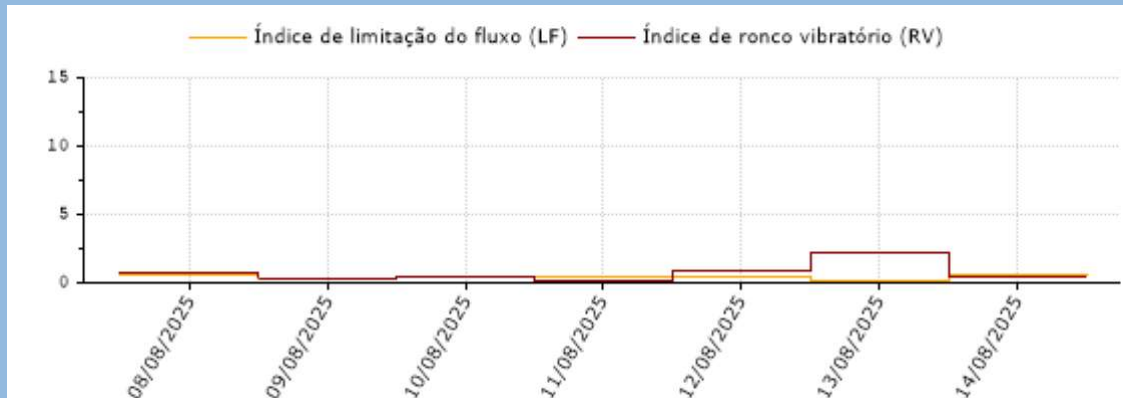
Média do índice de AO
4,4

Índice RERA de hipopnéia

Média do índice de
hipopnéia
3,8

Média do índice RERA
1,3

Média de IAH
15,7

Índices de eventos

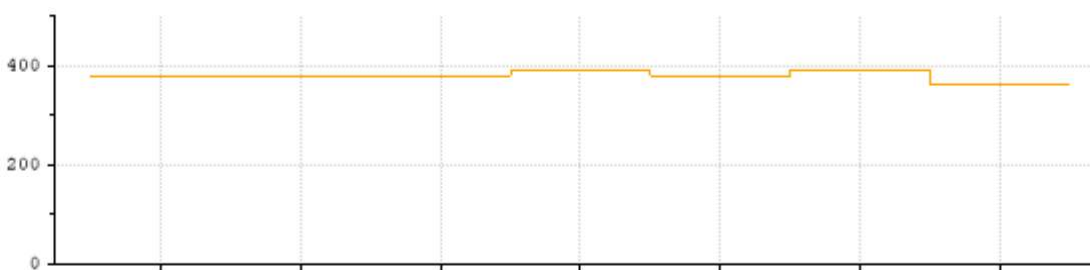
Média do índice de LF
0,4

Média do índice de RV
0,7

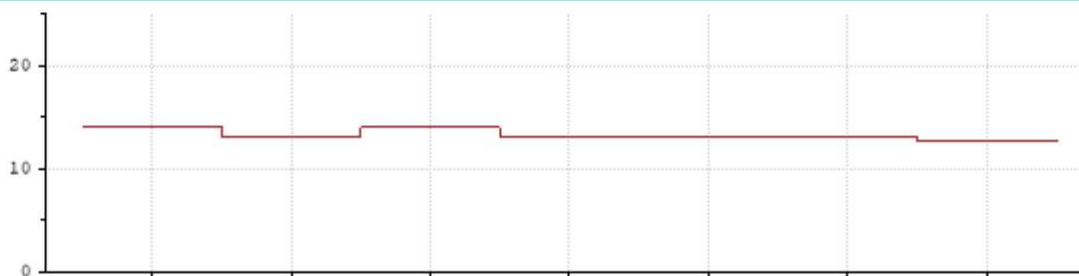
Porcentagem da noite com grande vazamento (VG)

% média da noite em vazamento grande
0,0%

Média de vazamento grande
0 segundos.

Volume corrente (ml)

Média do volume corrente
379,9 ml

Taxa respiratória (respirações por minuto)

Média da frequência respiratória
13,2 rpm

Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

