

Data de nasc:	08/12/1986	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	15/11/2025 - 14/12/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	08/08/2025
ID do paciente:	ANTONIO RICARDOSI...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto BiPAP V1.1.8.3313 (700X180) J376021173C12				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 15/11/2025 - 14/12/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	15/11/2025 - 14/12/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,3%
Uso acumulado	7 dias 18horas. 16 min. 53 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 16 min. 27 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 12 min. 33 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 39 min. 10 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3horas. 37 min. 30 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	90,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	10,0%
Tempo total com soprador	7 dias 18horas. 17 min. 57 segundos.

Resumo de Bi-Level Automático

Titulação máxima da pressão IPAP	12,0 cmH2O
Da pressão IPAP do aparelho <= 90% do tempo	12,0 cmH2O
Titulação máxima da pressão EPAP	8,0 cmH2O
Da pressão EPAP do aparelho <= 90% do tempo	8,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	51 segundos.
Média de IAH	12,5


Definições do Dispositivo a partir de 14/12/2025

Modo do aparelho Auto Bi-Level - Bi-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
IPAP máx.	12 cmH2O
EPAP mín.	8 cmH2O
Suporte pressórico máx.	4 cmH2O
Suporte pressórico mín.	4 cmH2O
Configuração Bi-Flex	1
Bloqueio Bi-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso

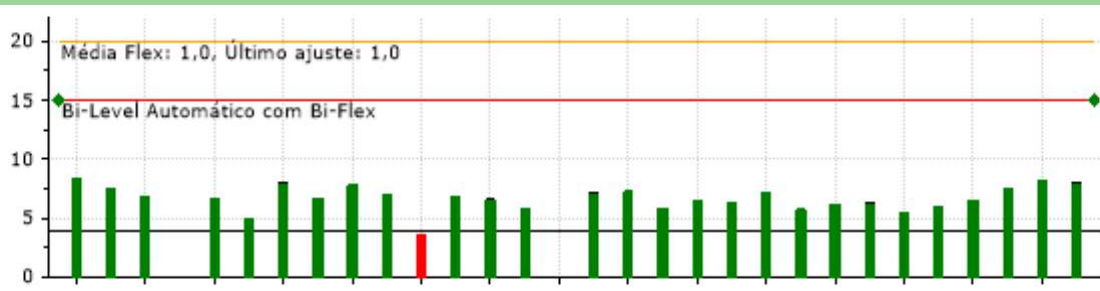

Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

