



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO
09/10/2025 a 07/11/2025

Paciente

9617

Idade:

63 anos

Peso:

Kg

Altura:

NaN

IMC:

SONOFISIO

sonofisio.mf@gmail.com

Relatório gerado em: 07/11/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente

 **Dados do Equipamento**

Máquina:

YH690B-246010257

Modo:

APAP

Pressão Inicial:

5 cmH2O

Pressão de terapia:

6 cmH2O

Rampa:

5 minutos

Nível de FPS:

1 cmH2O

Umidificação:

Automático

 **Utilização**

Dias de utilização:

29/30 dias (96%)

≥ 4 horas:

27 dias (90%)

< 4 horas:

2 dias (6%)

Horas de utilização:

211h34

Utilização média (por dia):

7h17

 **Terapia**

Pressão (cmH2O):

7.8

Mediana:

7.8

Percentil 90.º:

7.8

Máximo:

7.86

Fugas (L/min):

0.4

Mediana:

0.4

Percentil 90.º:

1.4

Máximo:

1.9

Eventos por hora:

IA 0.94

IH 2.07

IAC 0.19

IAH 3.01



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

09/10/2025 a 07/11/2025

Paciente 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:


SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 07/11/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Utilização

Uso 7h18


Valores médios dos indicadores

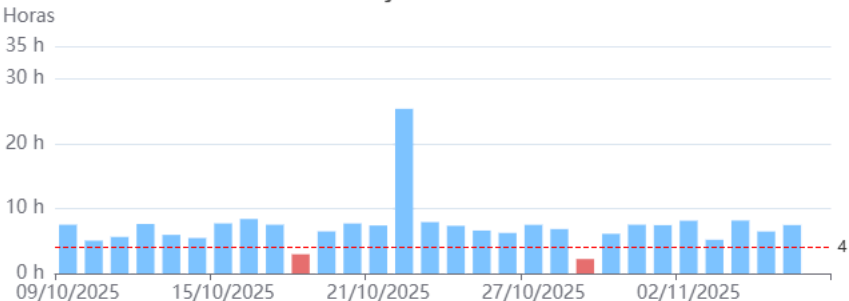

Fuga

Fuga 0.61


Valores médios dos indicadores

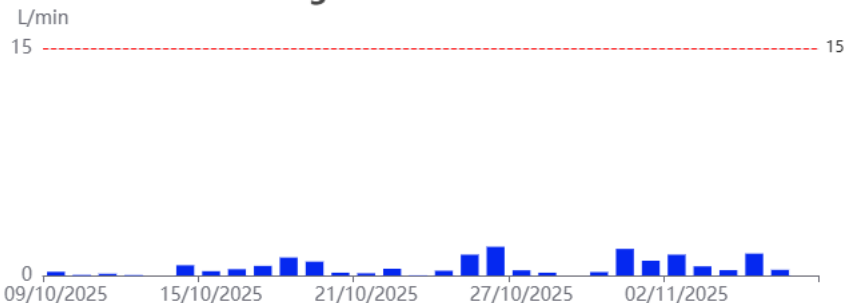

Pressão

Pressão APAP 7.75
Pressão CPAP 0.00
FPS 1.00


Valores médios dos indicadores

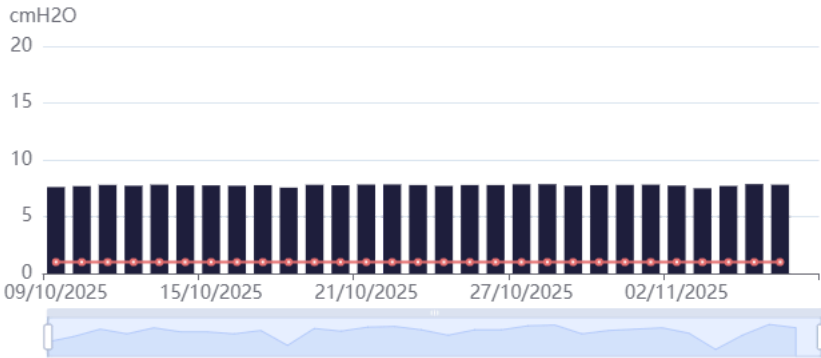

Eventos

IA 0.94
IH 2.07
IAC 0.19
IAH 3.01

Valores médios dos indicadores

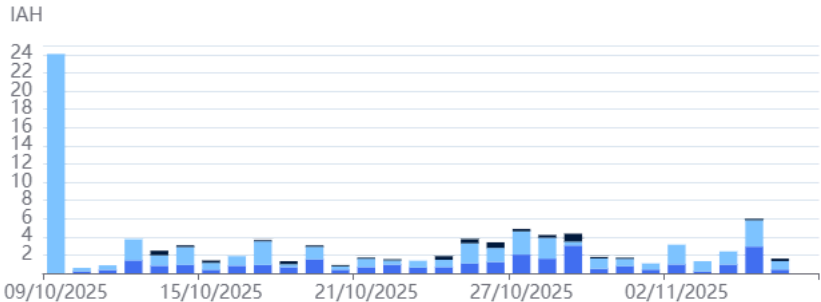



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)


Gerado por
sac@gaslive.com.br

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO
09/10/2025 a 07/11/2025

Paciente 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 07/11/2025 - Pág. 2/2

Ronco

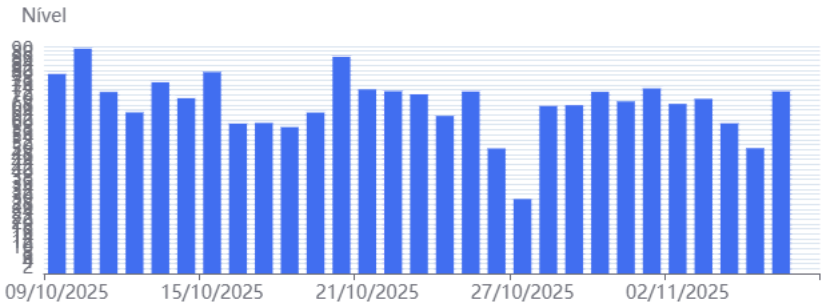

Valores médios dos indicadores

Ronco 68.40