



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

01/01/2026 a 30/01/2026

Paciente 9617
Idade: 64 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 30/01/2026 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente

 **Dados do Equipamento**

Máquina: YH690B-246010257

Modo: APAP

Pressão Inicial: 5 cmH2O

Pressão de terapia: 6 cmH2O

Rampa: 5 minutos

Nível de FPS: 1 cmH2O

Umidificação: Automático

 **Utilização**

Dias de utilização: 26/30 dias (86%)

≥ 4 horas: 21 dias (70%)

< 4 horas: 5 dias (16%)

Horas de utilização: 159h0

Utilização média (por dia): 6h6

 **Terapia**

Pressão (cmH2O):
Mediana: 7.8
Percentil 90.º: 7.8
Máximo: 8.83

Fugas (L/min):
Mediana: 0.6
Percentil 90.º: 2.1
Máximo: 3.2

Eventos por hora:
IA 2.00
IH 1.90
IAC 0.38
IAH 3.90



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com


CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

01/01/2026 a 30/01/2026

Paciente **9617**
Idade: **64 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 30/01/2026 - Pág. 2/2


Utilização

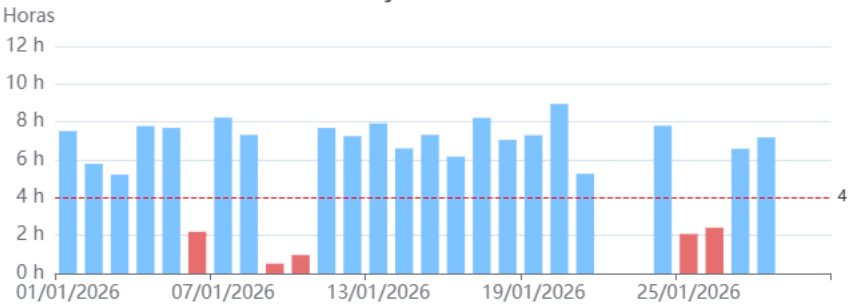

Valores médios dos indicadores

Uso 6h7


Fuga

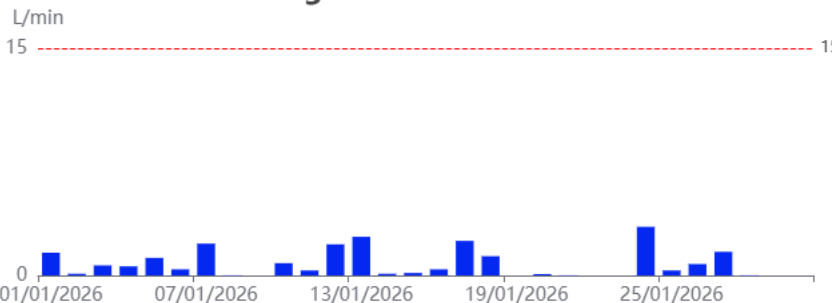

Valores médios dos indicadores

Fuga 0.94


Pressão

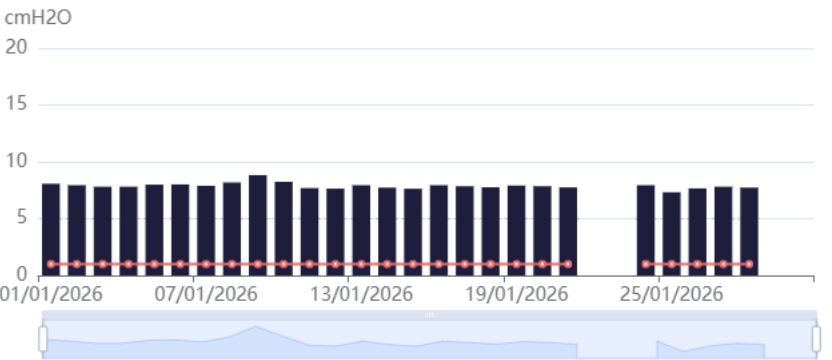

Valores médios dos indicadores

Pressão APAP 7.88
Pressão CPAP 0.00
FPS 1.00

Eventos

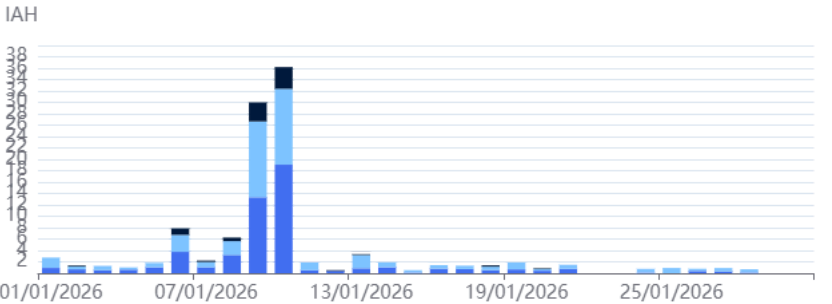

Valores médios dos indicadores

IA 2
IH 1.9
IAC 0.38
IAH 3.9



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

01/01/2026 a 30/01/2026

Paciente 9617
Idade: 64 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 30/01/2026 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

57.66

Valores médios dos indicadores

