



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO
25/02/2026 a 26/03/2026

Paciente: 9617
Idade: 64 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 26/03/2026 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Relatório do Paciente

 Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010257

Modo: APAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão mín: 6 cmH2O
Pressão máx: 9 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Automático

 Utilização

Dias de utilização: 29/30 dias (96%)

≥ 4 horas: 29 dias (96%)

< 4 horas: 0 dias (0%)

Horas de utilização: 210h18

Utilização média (por dia): 7h15

 Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 7.8	Mediana: 0.4	IA 0.41
Percentil 90.º: 7.8	Percentil 90.º: 1.3	IH 0.81
Máximo: 8.05	Máximo: 2.9	IAC 0.04
		IAH 1.22



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

25/02/2026 a 26/03/2026


Paciente: 9617
Idade: 64 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 26/03/2026 - Pág. 2/2

Utilização

Uso 7h15


Valores médios dos indicadores

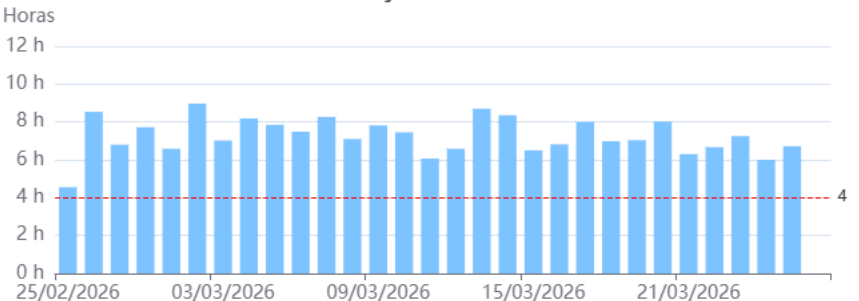

Fuga

Fuga 0.64


Valores médios dos indicadores

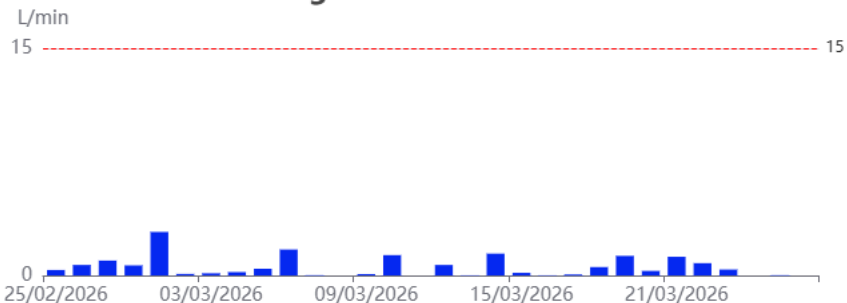

Pressão

Pressão APAP 7.81
Pressão CPAP 0.00
FPS 1.00


Valores médios dos indicadores

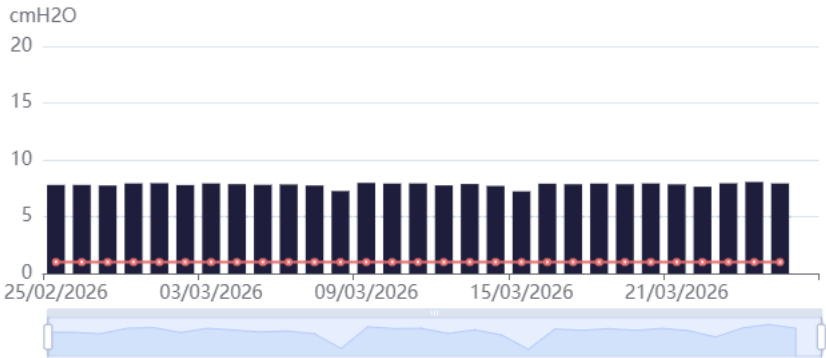

Eventos

IA 0.41
IH 0.81
IAC 0.04
IAH 1.22

Valores médios dos indicadores

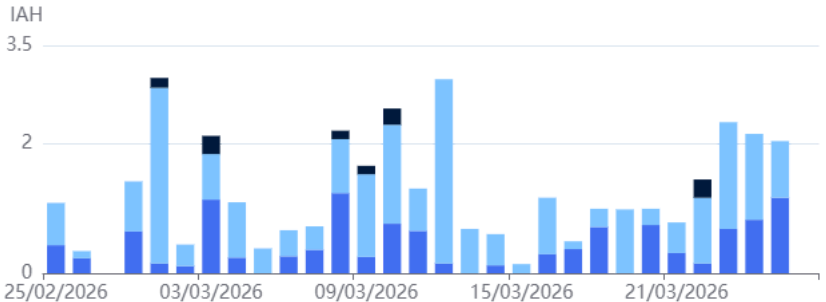



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

25/02/2026 a 26/03/2026

Paciente 9617
Idade: 64 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 26/03/2026 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

71.95

Valores médios dos indicadores

