


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/01/2026 - 11/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	301 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)	10 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	10 horas 3 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	10 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/02/2026)	2,233 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024582
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.0	Percentil 95.º: 8.5	Máximo: 8.5	
Fugas — l/min	Mediana: 29.2	Percentil 95.º: 61.2	Máximo: 75.8	
Eventos por hora	IA: 4.9	IH: 2.1	IAH: 7.0	
Índice de apneia	Central: 2.3	Obstrutiva: 1.3	Desconhecid	1.2
Índice RERA	2.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	3 minutos (1%)			

Horas de utilização

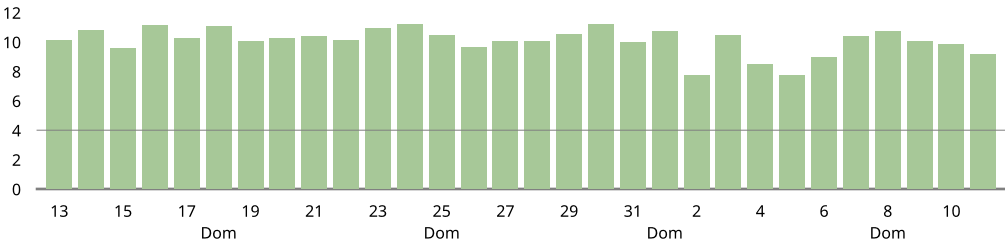


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024582


Utilização (horas)

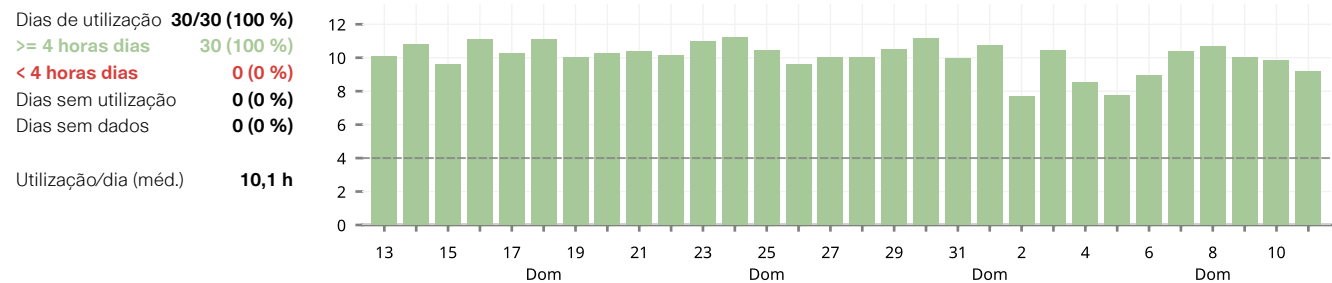

Fuga (l/min)

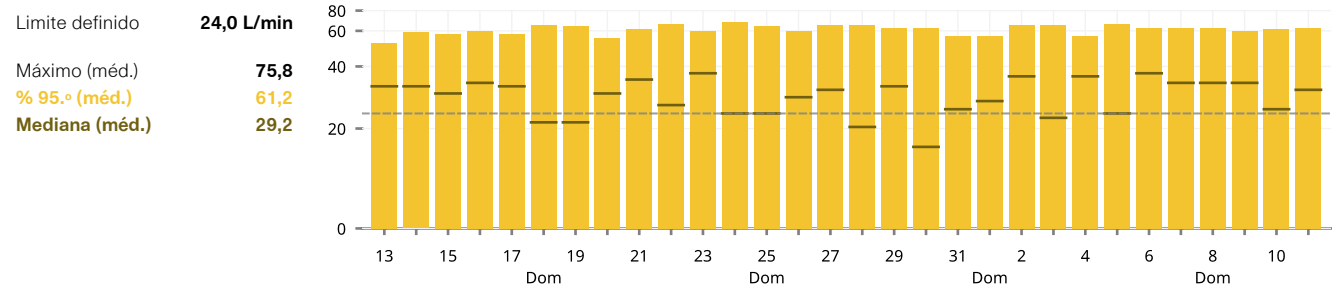

Pressão (cmH2O)

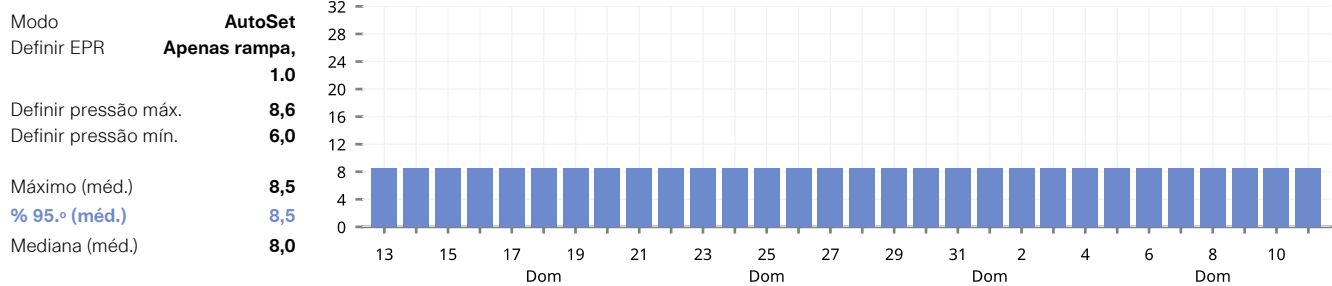

IAH (eventos/hora)

