

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. JOSE DA SILVA ARANHA**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **7 novembro 1945** Idade: **79**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **30/10/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

30/09/2025 - 29/10/2025		Dispositivo: AirSense 10 Elite (S/N: 22201059875)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 10,0 cmH2O	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 2,0 cmH2O	Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	
Activação subida: ON	Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	
Fuga - l/min			
Mediana: 31,8	Percentil 95: 57,0	Máximo/a: 65,4	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 15,1	Índice de hipopneia: 3,9	AHI: 19,0	
Obstrutiva: 0,1	Central: 1,4	Desconhecida: 10,5	
Índice RERA: 2,1	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 30	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 181:21	
Mediana do uso diário: 5:59	Média de uso diário: 6:02		


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


30/09/2025 - 29/10/2025

Dispositivo: AirSense 10 Elite (S/N: 22201059875)


Pressão

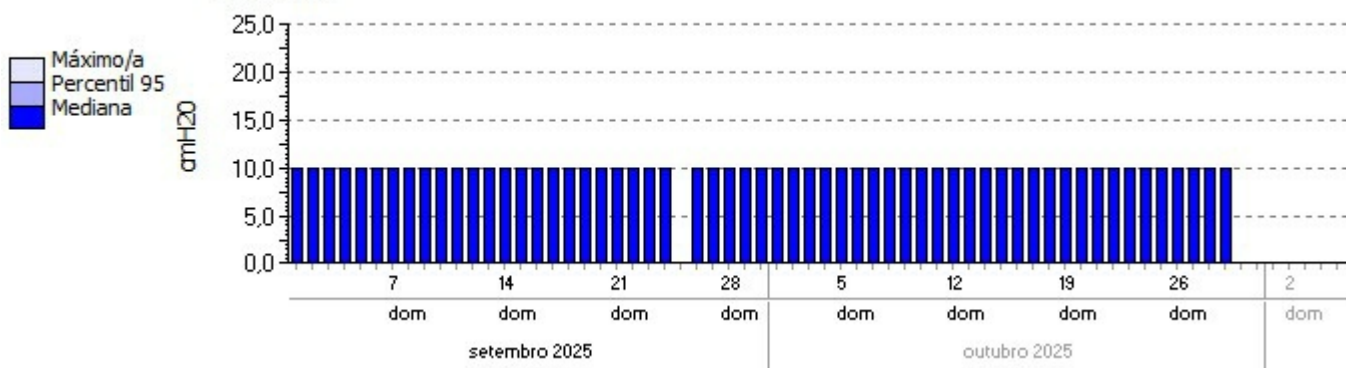


Fuga

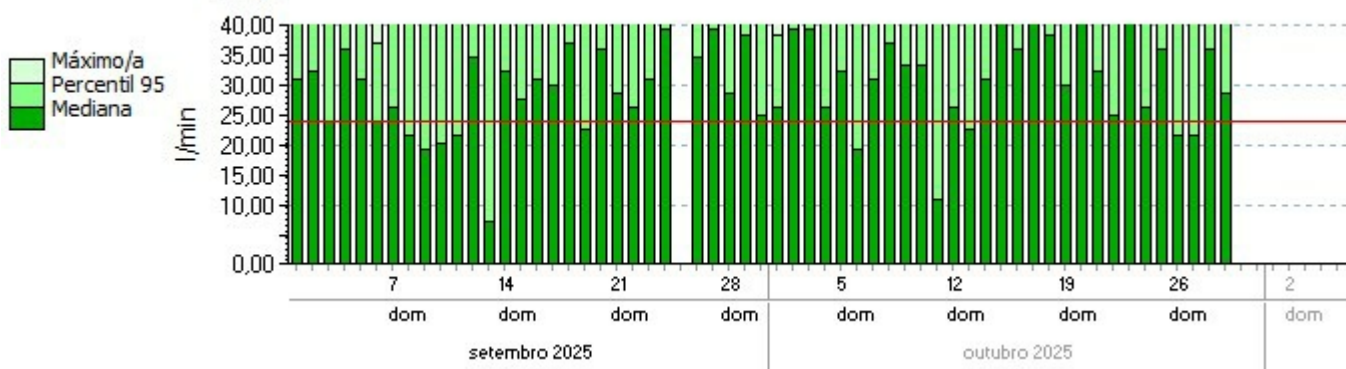

IAH & IA

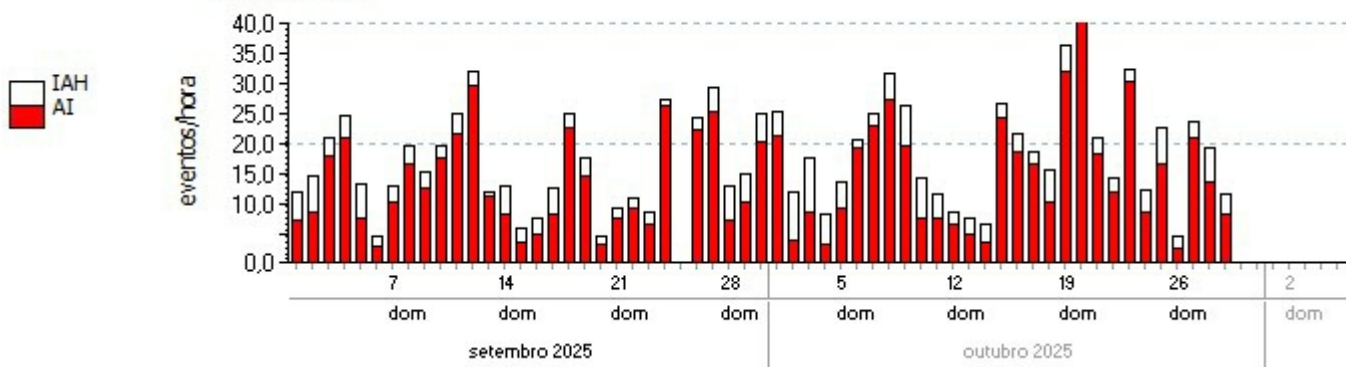

Uso

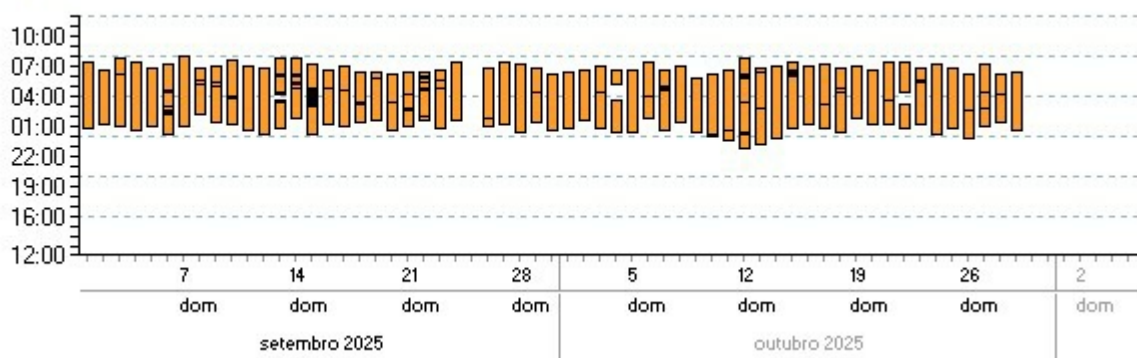

Utilização total e Cheyne-Stokes

