


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/10/2025 - 23/11/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	198 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 5 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/11/2025)	8,974 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211126620
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.6	Percentil 95.º: 19.5	Máximo: 41.8	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.5	IAH: 1.6	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

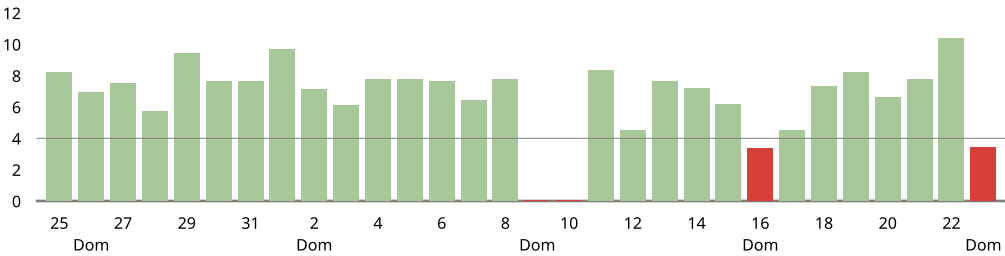


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211126620


Utilização (horas)

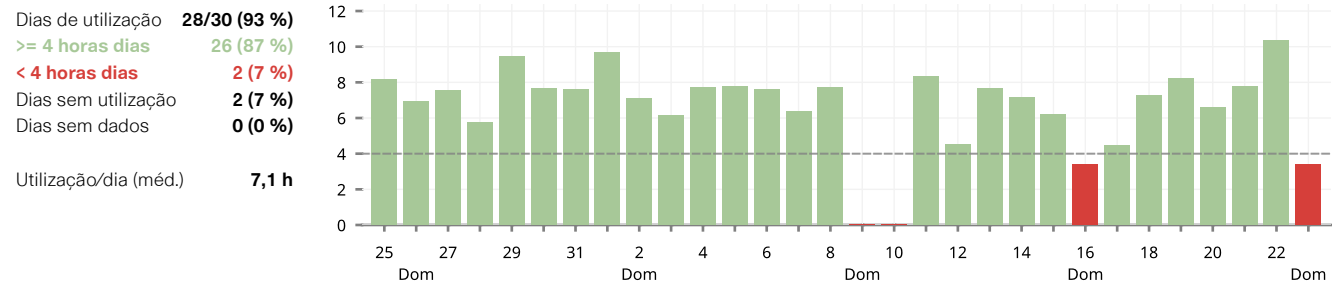

Fuga (l/min)

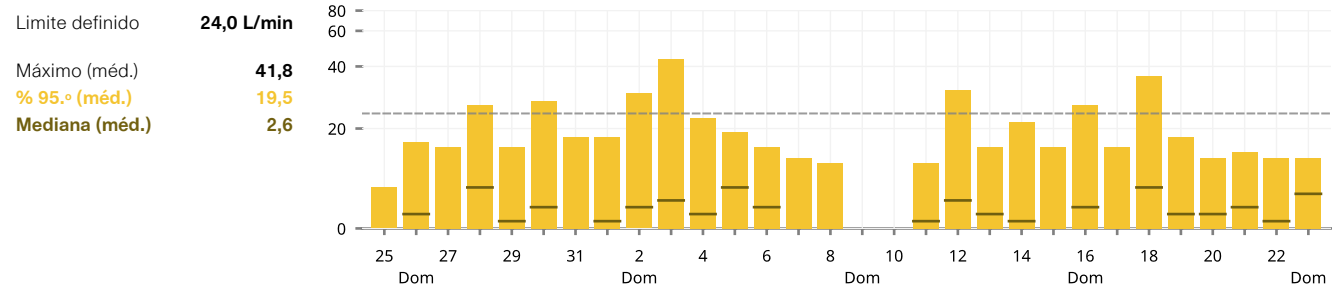

Pressão (cmH2O)

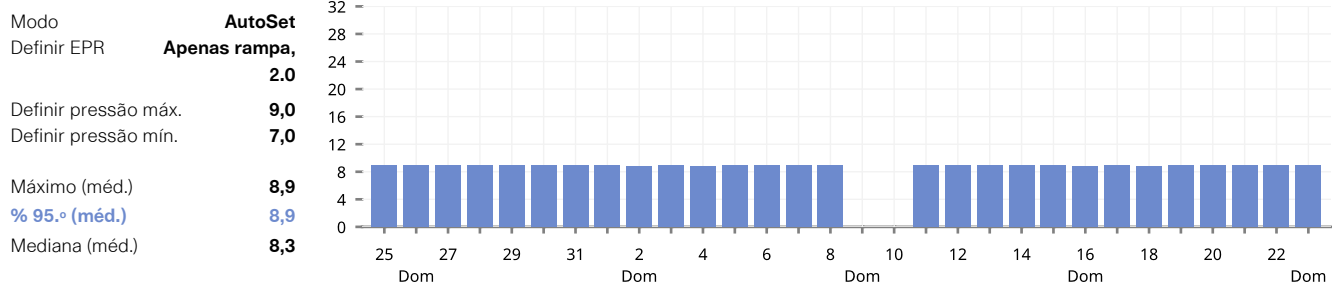

IAH (eventos/hora)

