

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

15/07/2025 - 27/07/2025

Dias de utilização	13/13 dias (100%)
>= 4 horas	12 dias (92%)
< 4 horas	1 dias (8%)
Horas de utilização	77 horas 41 minutos
Utilização média (total de dias)	5 horas 59 minutos
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 59 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 2 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/07/2025)	2,128 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22221597120
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	13 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 11.2	Percentil 95.º: 12.6	Máximo: 12.9
Fugas — l/min	Mediana: 24.7	Percentil 95.º: 48.4	Máximo: 62.2
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 2.6	IAH: 4.7
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid 1.1
Índice RERA	5.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (1%)		

Horas de utilização

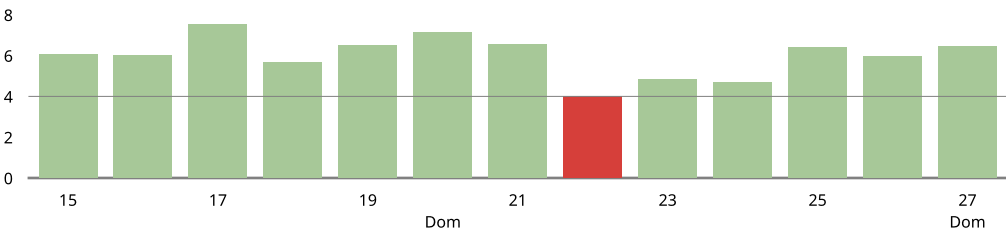


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221597120


Utilização (horas)

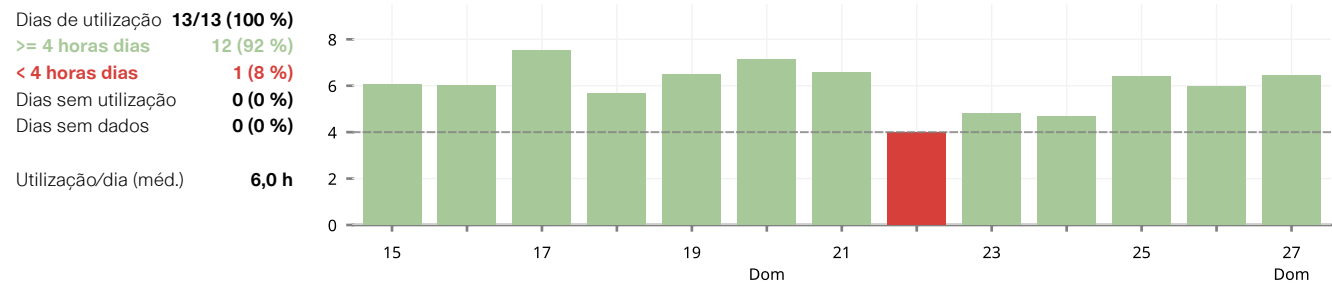

Fuga (l/min)

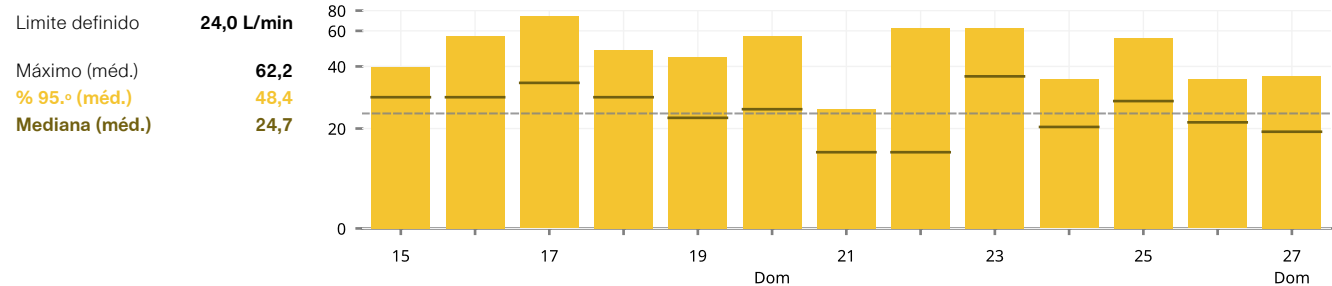

Pressão (cmH2O)

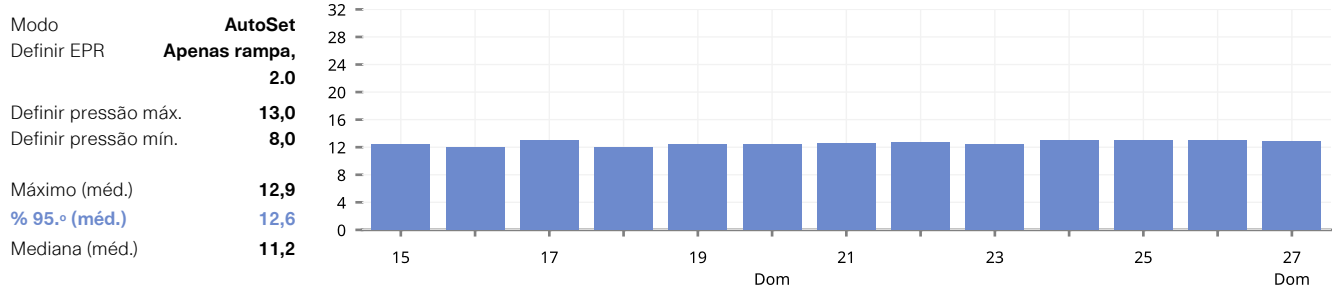

IAH (eventos/hora)

