


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 21/07/2025 - 04/08/2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 14/15 dias (93%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 9 dias (60%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 5 dias (33%)        |                         |
| Horas de utilização                                          | 59 horas 18 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 3 horas 57 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 4 horas 14 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 4 horas 13 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 04/08/2025) | 1,807 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22232882363  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 6.6 cmH2O    |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.5   | Percentil 95.º: 15.6 | Máximo: 31.8 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 3.0        | IH: 0.1              | IAH: 3.1     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.9   | Obstrutiva: 1.5      | Desconhecid  | 0.6 |
| Índice RERA                                        | 0.1            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

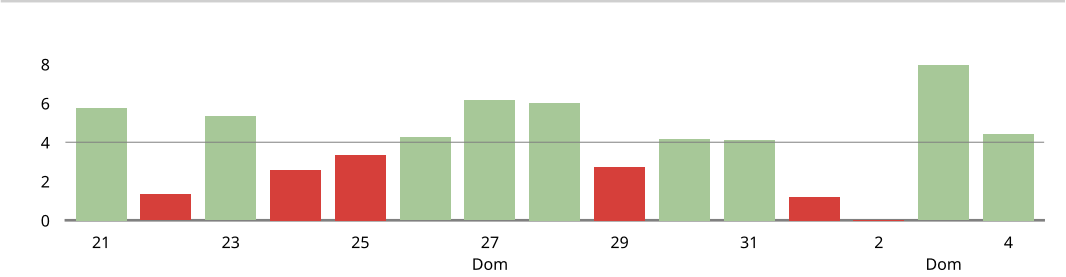


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882363


## Utilização (horas)

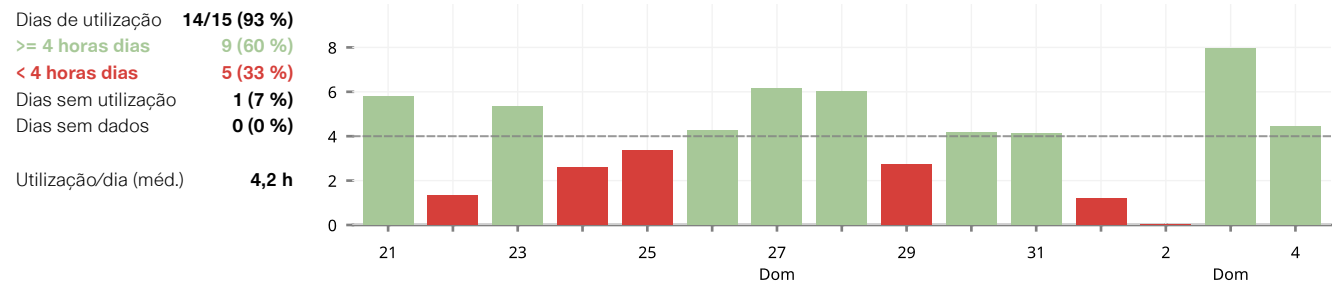

## Fuga (l/min)

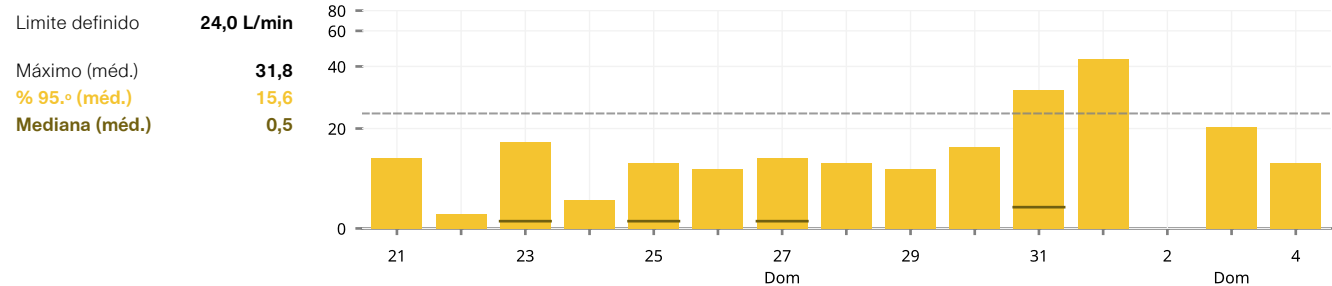

## Pressão (cmH2O)

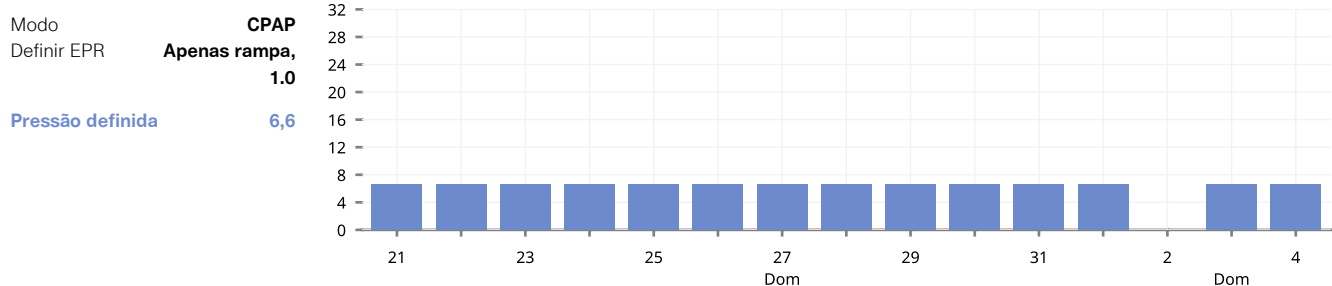

## IAH (eventos/hora)

