


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/09/2025 - 30/09/2025
Dias de utilização	22/28 dias (79%)	
>= 4 horas	18 dias (64%)	
< 4 horas	4 dias (14%)	
Horas de utilização	118 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/09/2025)	118 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260532
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 4.9	Percentil 95.º: 6.3	Máximo: 6.8	
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 10.6	Máximo: 40.9	
Eventos por hora	IA: 3.6	IH: 0.2	IAH: 3.8	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	2.5
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

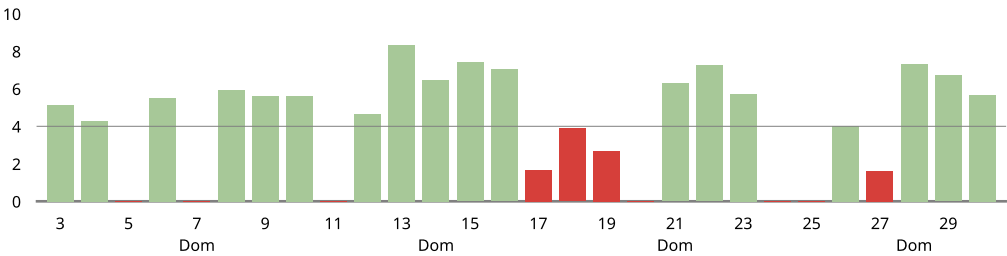


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260532


Utilização (horas)

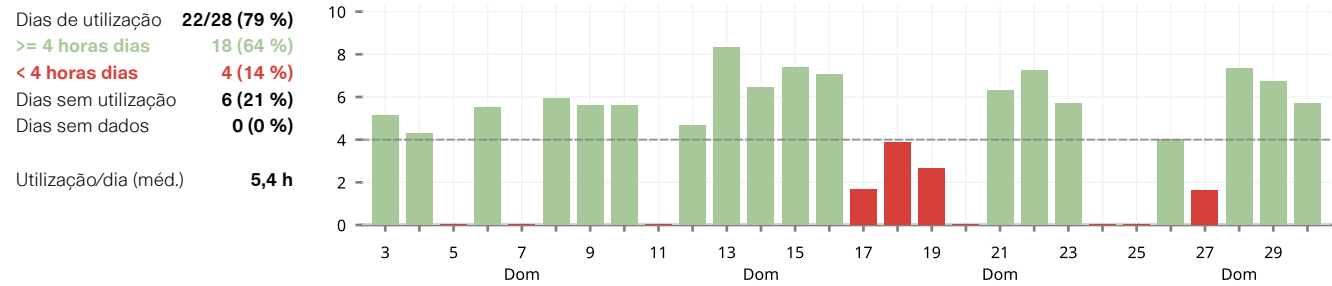

Fuga (l/min)

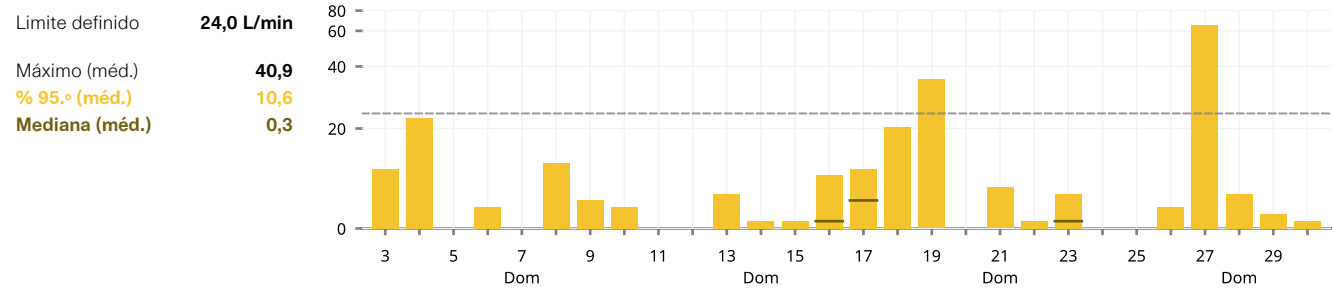

Pressão (cmH2O)

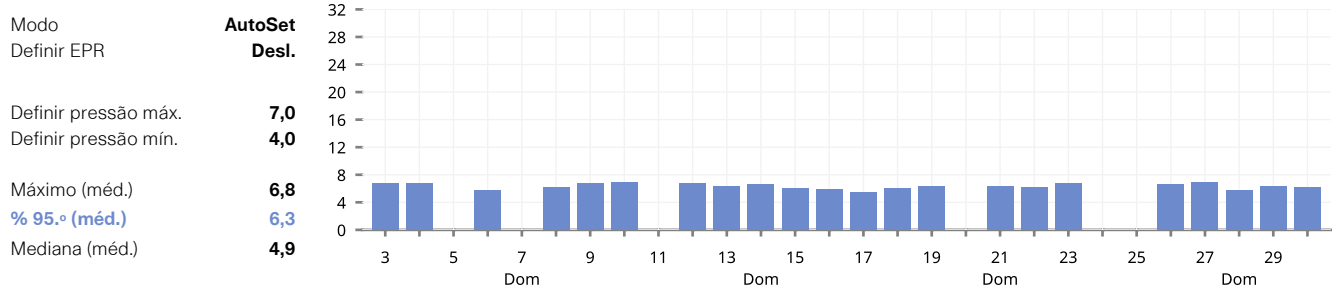

IAH (eventos/hora)

