


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/01/2026 - 09/02/2026
Dias de utilização	21/30 dias (70%)	
>= 4 horas	20 dias (67%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	129 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 15 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/02/2026)	630 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260532
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	4.9	Percentil 95.º:	6.3	Máximo:	6.8
Fugas — l/min	Mediana:	0.7	Percentil 95.º:	8.6	Máximo:	30.1
Eventos por hora	IA:	1.3	IH:	0.2	IAH:	1.5
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	0.4	Desconhecid	0.7
Índice RERA						0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

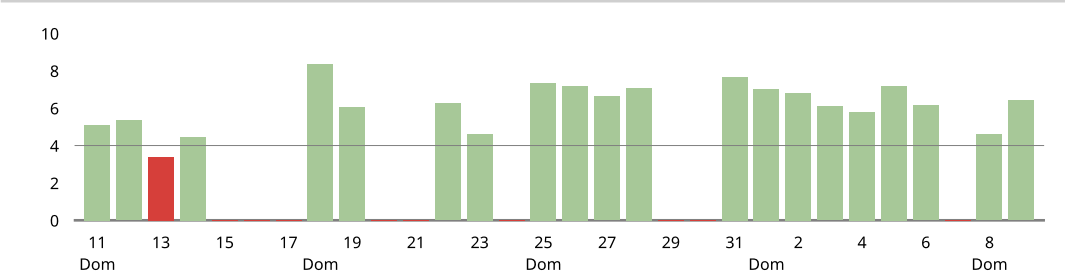


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260532


Utilização (horas)

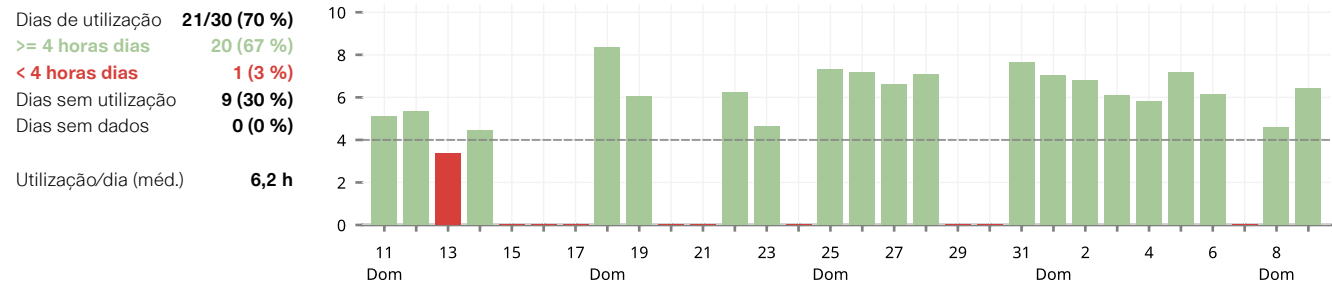

Fuga (l/min)

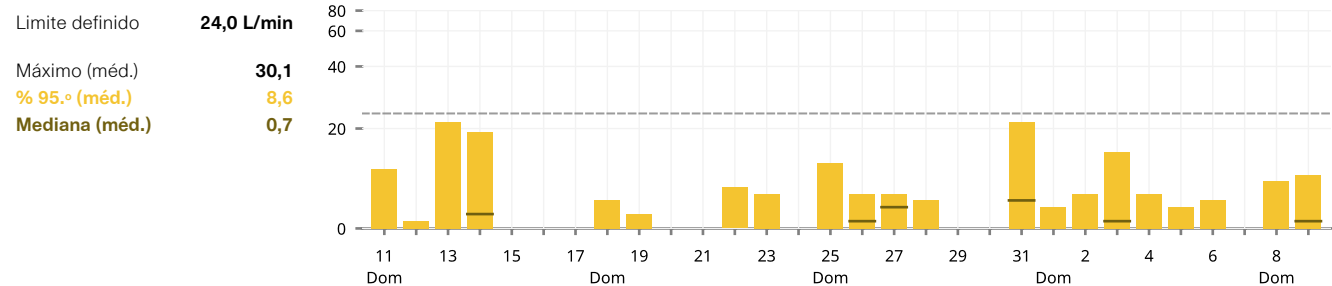

Pressão (cmH2O)

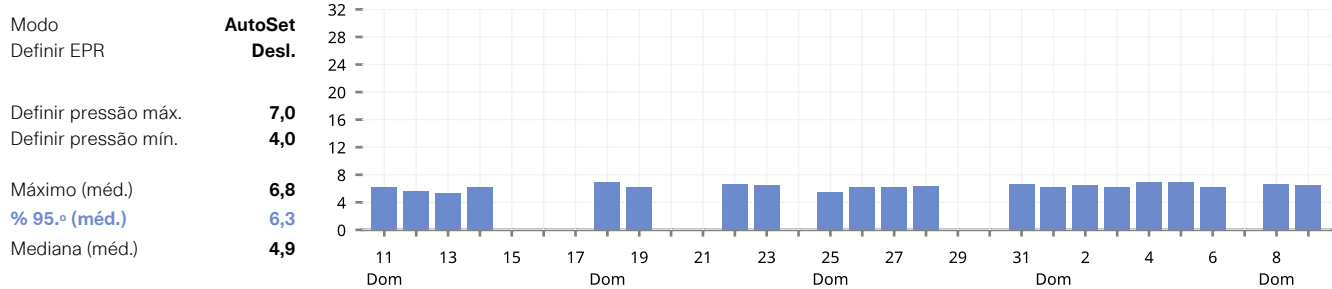

IAH (eventos/hora)

