


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/09/2025 - 21/09/2025
Dias de utilização	14/19 dias (74%)	
>= 4 horas	10 dias (53%)	
< 4 horas	4 dias (21%)	
Horas de utilização	62 horas 21 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 27 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/09/2025)	1,970 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653863
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia					
Fugas — l/min	Mediana:	0.6	Percentil 95.º:	16.0	Máximo: 24.4
Eventos por hora	IA:	0.1	IH:	0.4	IAH: 0.5
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	0.0	Desconhecido: 0.0
Índice RERA	0.1				
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)

Horas de utilização

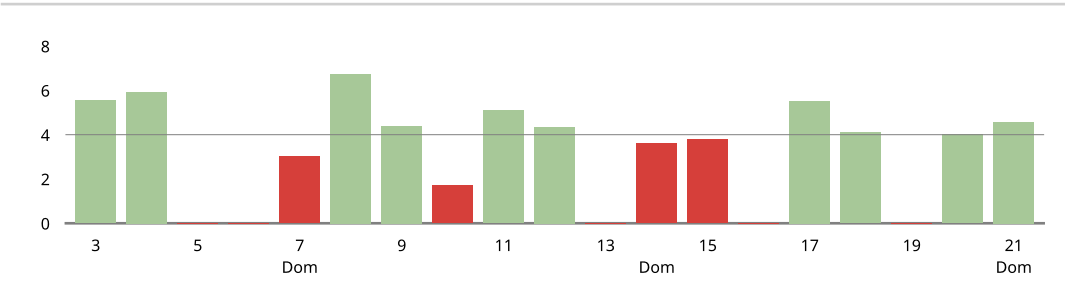


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


Utilização (horas)

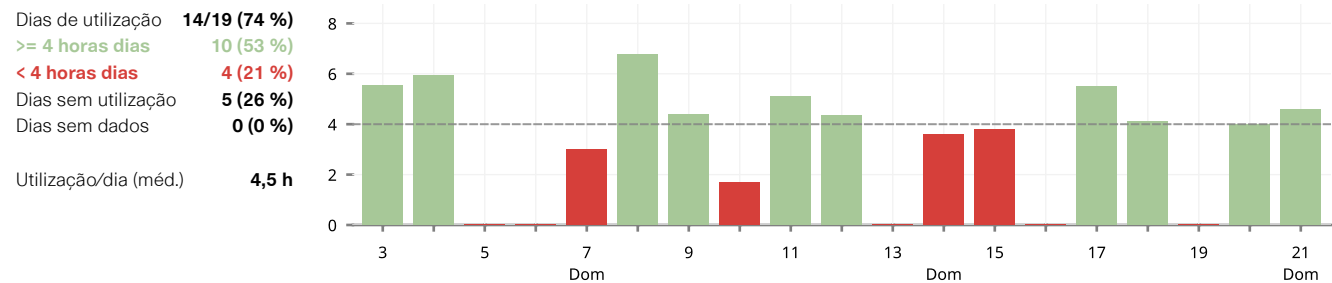

Fuga (l/min)

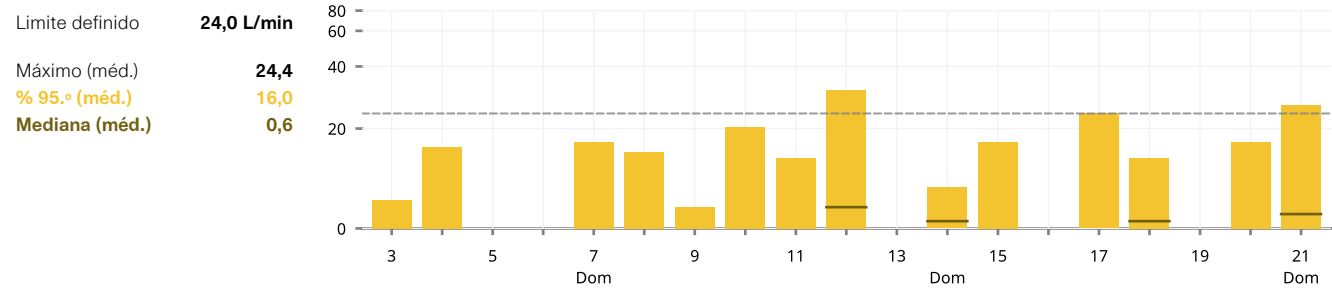

Pressão (cmH2O)

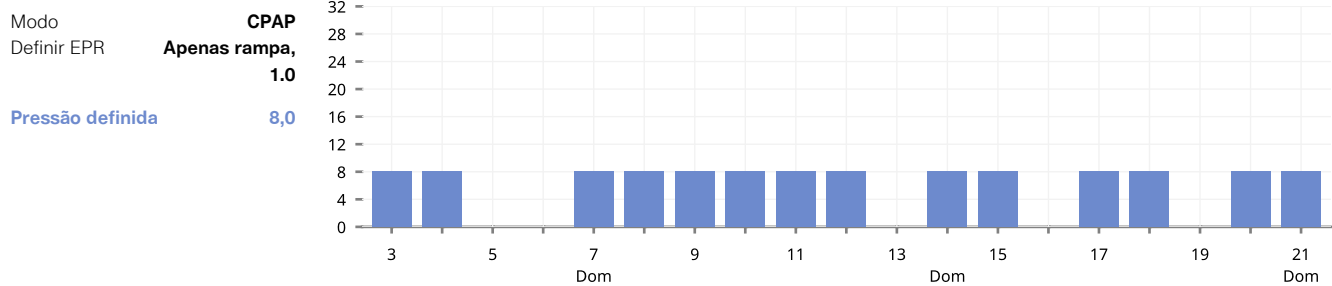

IAH (eventos/hora)

