



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

ADRIANO FERNANDES CHAVES

07/07/2025 a 04/08/2025

Paciente 5989
Idade: 51 anos
Peso: 118Kg
Altura: 1,71
IMC: 40.354

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 04/08/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente

**Dados do Equipamento**

SleepLive: YH480C*227310157

Modo: CPAP

Pressão Inicial: 4 cmH2O

Pressão de terapia: 11.5 cmH2O

Rampa: 5 minutos

Nível de FPS: 1 cmH2O

Umidificação: Nível 4

**Utilização**

Dias de utilização: 29/29 dias (100%)

≥ 4 horas: 26 dias (89%)

< 4 horas: 3 dias (10%)

Horas de utilização: 188h46

Utilização média (por dia): 6h30

**Terapia**

Pressão (cmH2O):
Mediana: 11.5
Percentil 90.º: 11.5
Máximo: 11.47

Fugas (L/min):
Mediana: 10.2
Percentil 90.º: 12.6
Máximo: 15.9

Eventos por hora:
IA 0.00
IH 0.15
IAC 0.00
IAH 0.15



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

ADRIANO FERNANDES CHAVES


07/07/2025 a 04/08/2025

Paciente **5989**
Idade: **51 anos**
Peso: **118Kg**
Altura: **1,71**
IMC: **40.354**


SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 04/08/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Utilização

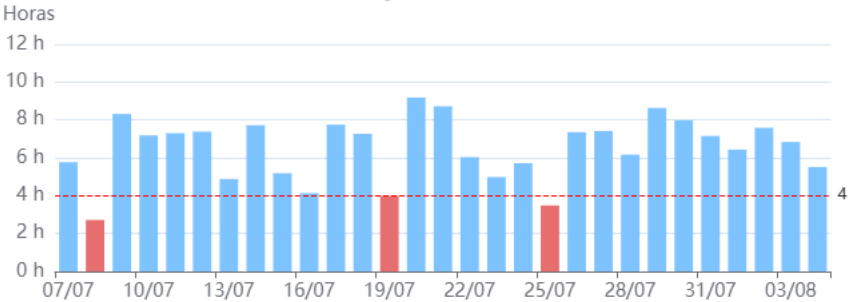


Fuga

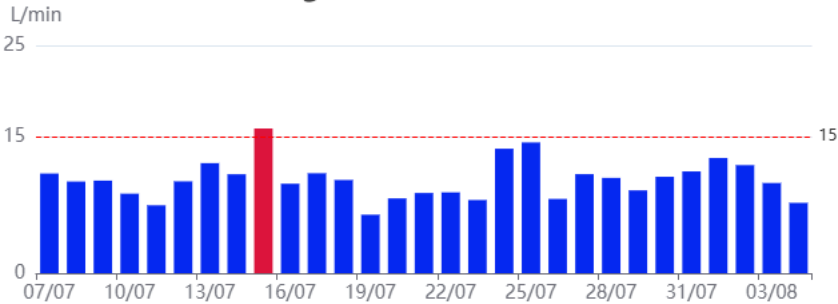

Pressão

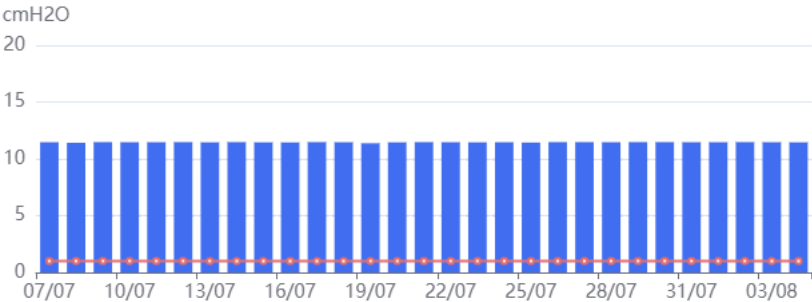

Eventos

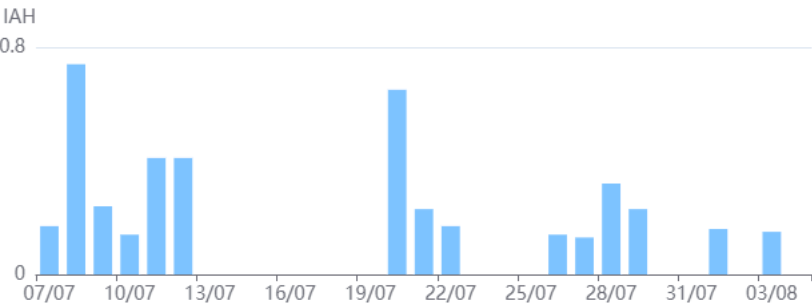



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

ADRIANO FERNANDES CHAVES
07/07/2025 a 04/08/2025

Paciente: **5989**
Idade: **51 anos**
Peso: **118Kg**
Altura: **1,71**
IMC: **40.354**

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 04/08/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco



Valores médios dos indicadores

Ronco 0