



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

ADRIANO FERNANDES CHAVES
10/09/2025 a 09/10/2025

Paciente **5989**
Idade: **51 anos**
Peso: **118Kg**
Altura: **1,71**
IMC: **40.354**

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 09/10/2025 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

SleepLive: YH480C*227310157
Modo: CPAP
Pressão Inicial: 4 cmH2O
Pressão de terapia: 11.5 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Nível 4



Utilização

Dias de utilização: 30/30 dias (100%)
≥ 4 horas: 29 dias (96%)
< 4 horas: 1 dias (3%)
Horas de utilização: 200h10
Utilização média (por dia): 6h40



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 11.5	Mediana: 10.8	IA 0.00
Percentil 90.º: 11.5	Percentil 90.º: 13.3	IH 0.04
Máximo: 11.5	Máximo: 14.3	IAC 0.00
		IAH 0.04



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

ADRIANO FERNANDES CHAVES

10/09/2025 a 09/10/2025

Paciente **5989**
Idade: **51 anos**
Peso: **118Kg**
Altura: **1,71**
IMC: **40.354**


SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 09/10/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Utilização

● **Uso** **6h40**


Valores médios dos indicadores

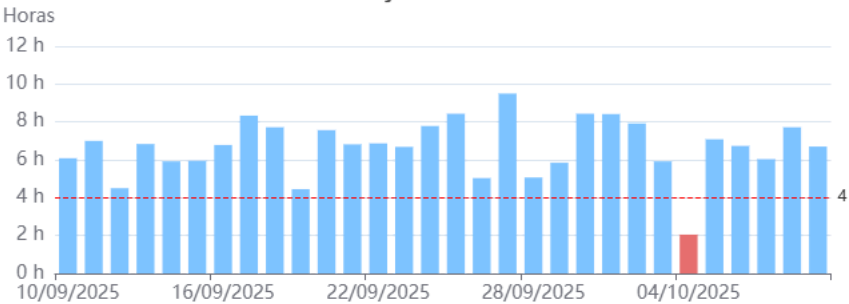

Fuga

● **Fuga** **11.04**

Valores médios dos indicadores

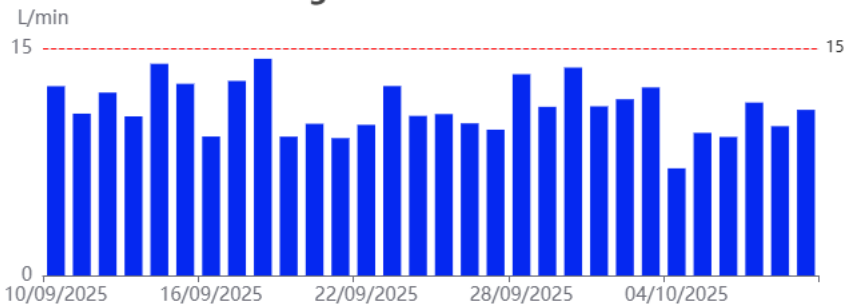

Pressão

● **Pressão APAP** **0.00**
● **Pressão CPAP** **11.48**
● **FPS** **1.00**


Valores médios dos indicadores



Eventos

● **IA** **0**
● **IH** **0.04**
● **IAC** **0**
○ **IAH** **0.04**

Valores médios dos indicadores

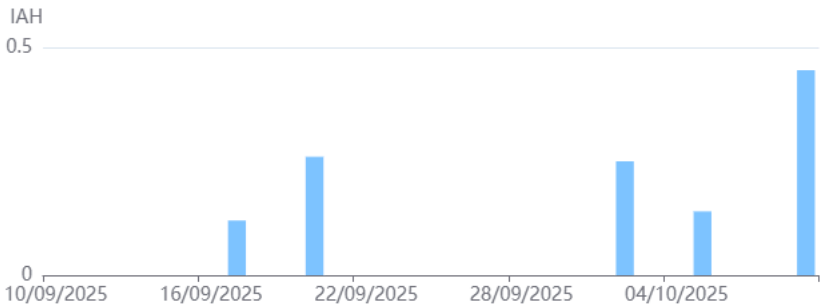



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

ADRIANO FERNANDES CHAVES
10/09/2025 a 09/10/2025

Paciente **5989**
Idade: **51 anos**
Peso: **118Kg**
Altura: **1,71**
IMC: **40.354**

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 09/10/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco

Ronco

0

Valores médios dos indicadores

