


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/08/2025 - 07/09/2025
Dias de utilização	35/35 dias (100%)	
>= 4 horas	35 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	193 horas 3 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/09/2025)	7,404 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211024105
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.9	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 22.4	Máximo: 35.0	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 4.8	IAH: 5.4	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização

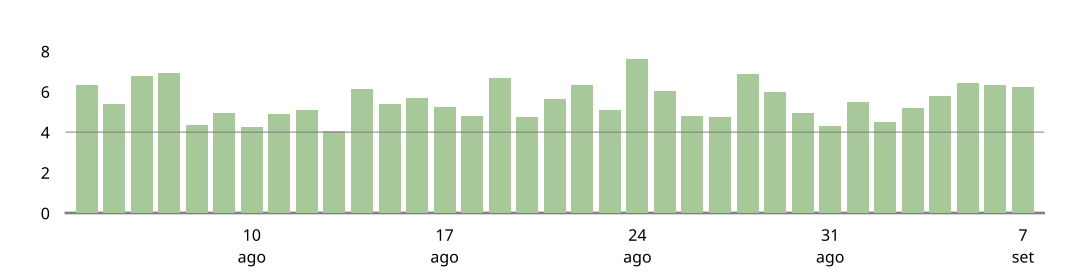


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211024105


Utilização (horas)

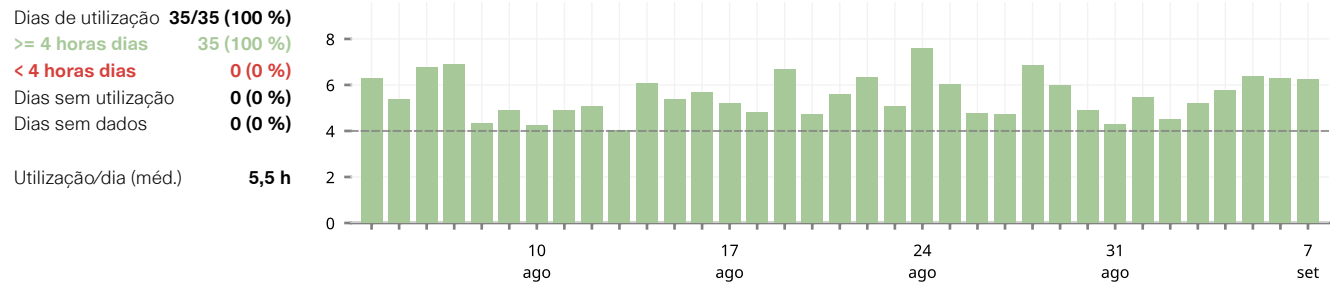

Fuga (l/min)

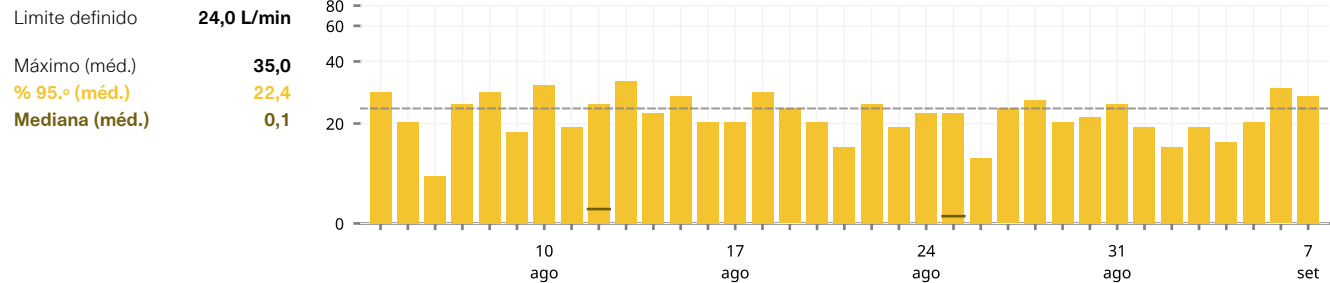

Pressão (cmH2O)

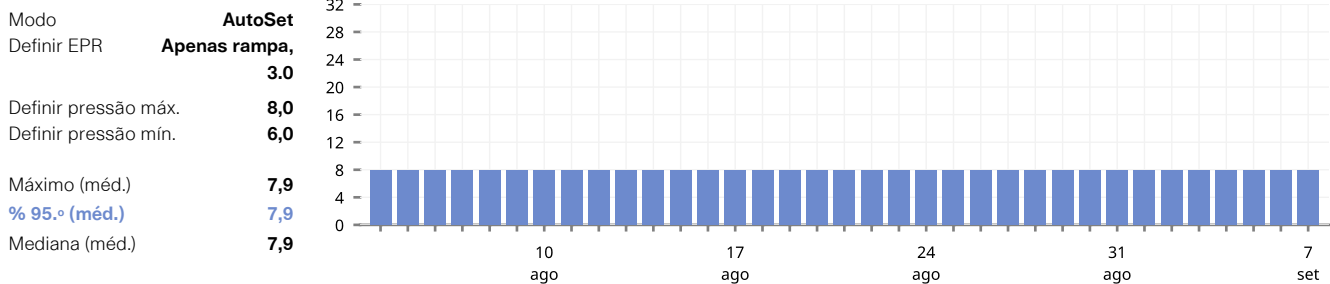

IAH (eventos/hora)

