


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/12/2025 - 11/01/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	179 horas 45 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 0 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 0 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/01/2026)	8,089 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211024105
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.6	Percentil 95.º:	7.7	Máximo:	7.7
Fugas — l/min	Mediana:	1.8	Percentil 95.º:	22.6	Máximo:	30.8
Eventos por hora	IA:	0.3	IH:	2.3	IAH:	2.6
Índice de apneia	Central:	0.2	Obstrutiva:	0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.5
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

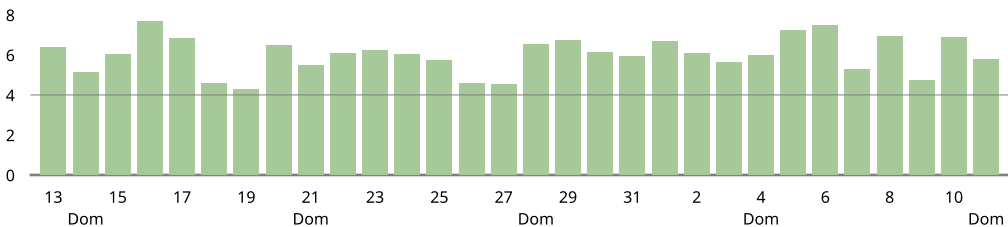


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211024105


Utilização (horas)

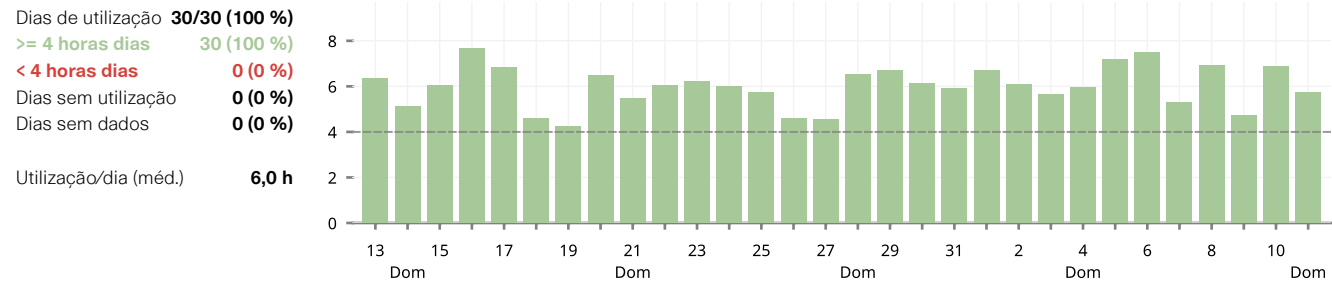

Fuga (l/min)

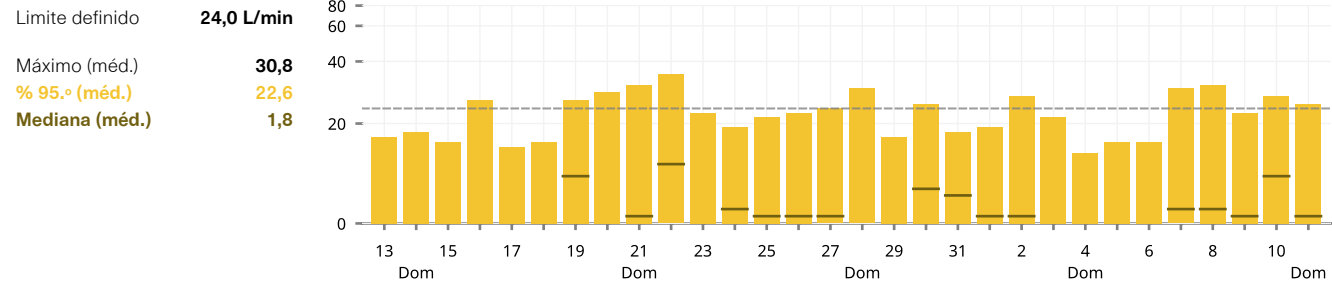

Pressão (cmH2O)

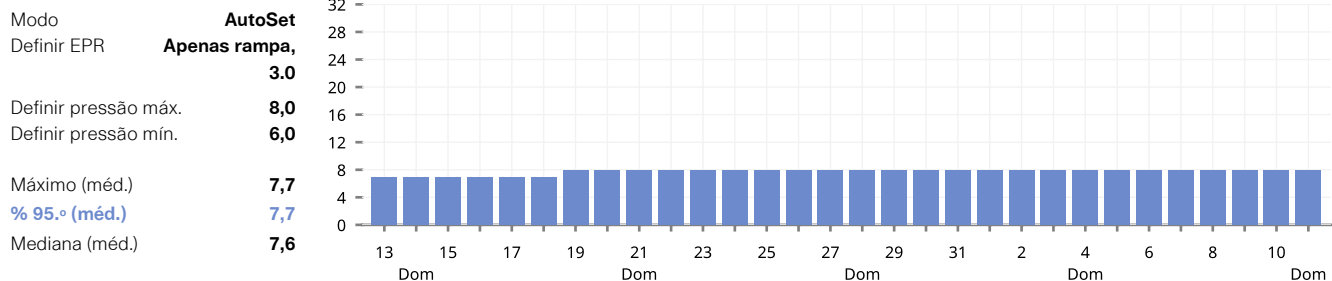

IAH (eventos/hora)

