


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/08/2025 - 23/08/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	31 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/08/2025)	74 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260594
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	11.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 10.8	Máximo: 11.3	
Fugas — l/min	Mediana: 29.6	Percentil 95.º: 48.8	Máximo: 57.6	
Eventos por hora	IA: 5.7	IH: 0.8	IAH: 6.5	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 2.8	Desconhecid	2.1
Índice RERA	3.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

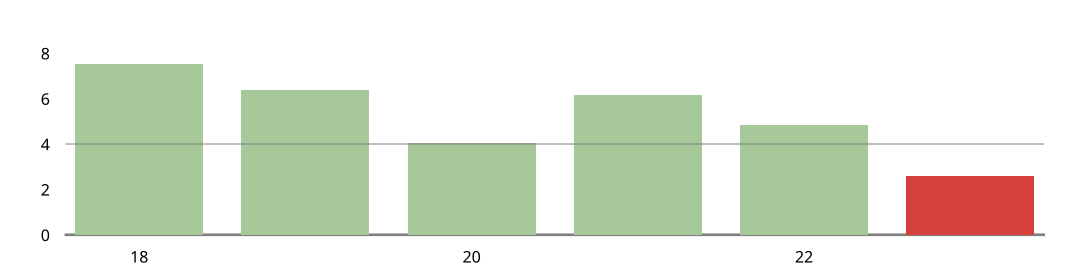


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594


Utilização (horas)

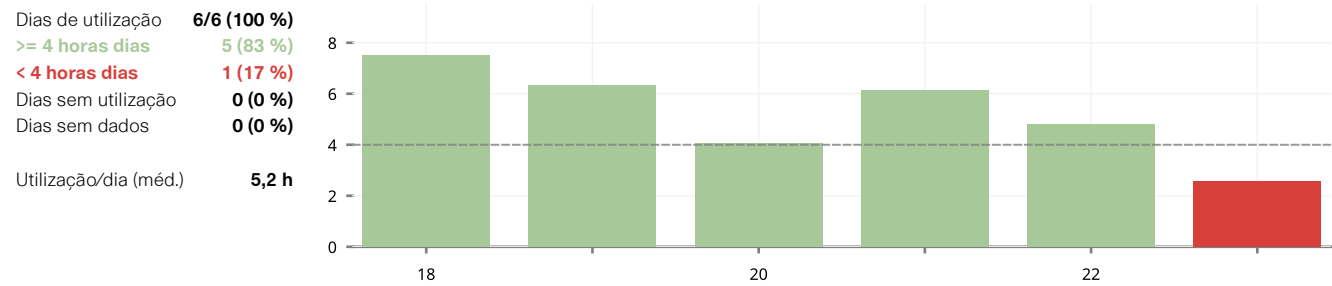

Fuga (l/min)

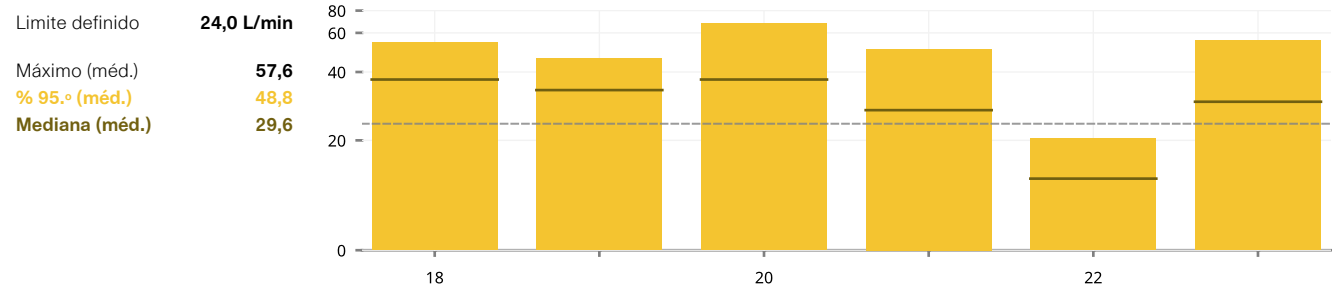

Pressão (cmH2O)

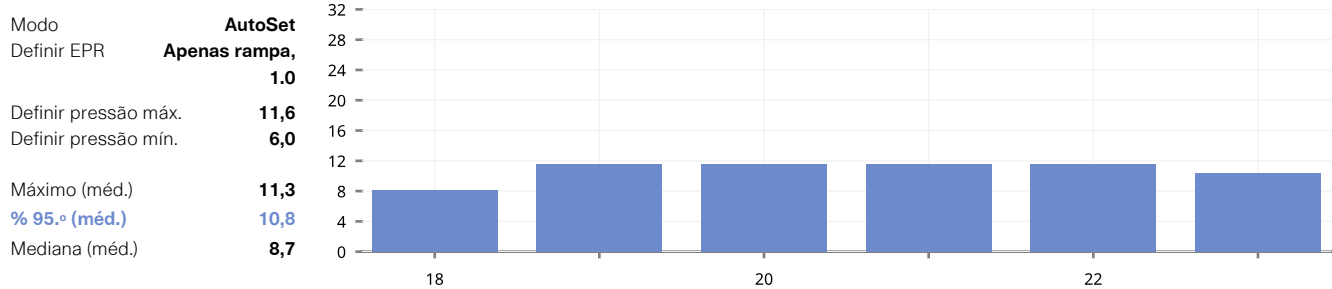

IAH (eventos/hora)

