


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/11/2025 - 04/12/2025
Dias de utilização	24/30 dias (80%)	
>= 4 horas	22 dias (73%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	139 horas 13 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 48 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/12/2025)	5,440 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211189590
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	8.4	Percentil 95.º:	8.9	Máximo:	9.0
Fugas — l/min	Mediana:	1.4	Percentil 95.º:	16.3	Máximo:	24.9
Eventos por hora	IA:	1.2	IH:	0.3	IAH:	1.5
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	1.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

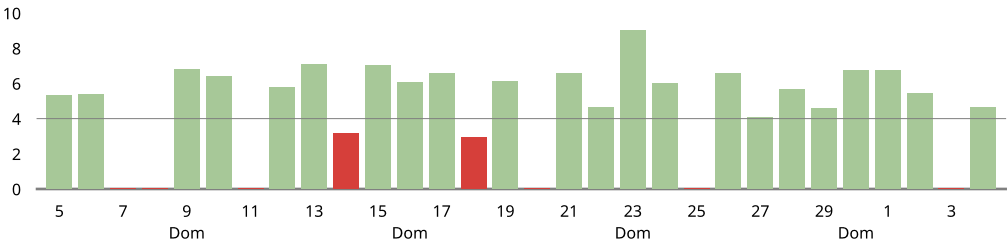


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211189590


Utilização (horas)

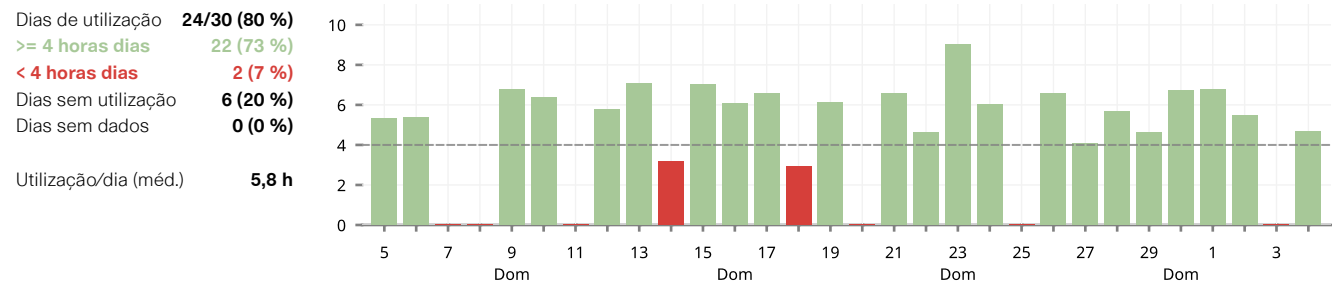

Fuga (l/min)

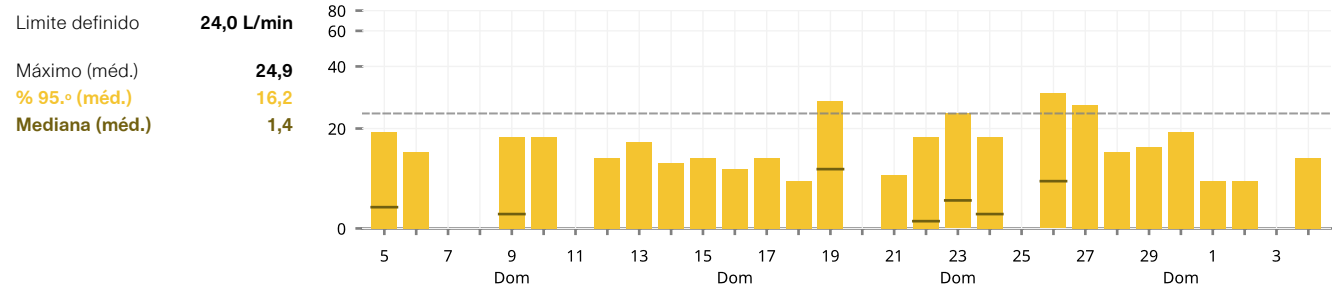

Pressão (cmH2O)

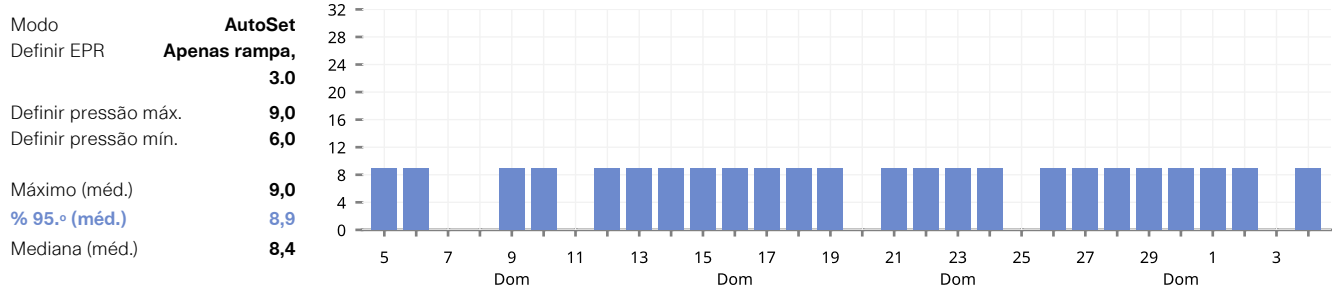

IAH (eventos/hora)

