


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/07/2025 - 12/08/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	175 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/08/2025)	9,478 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22171064337
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 9.0	
Fugas — l/min	Mediana: 19.8	Percentil 95.º: 31.8	Máximo: 38.5	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.4	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	1.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

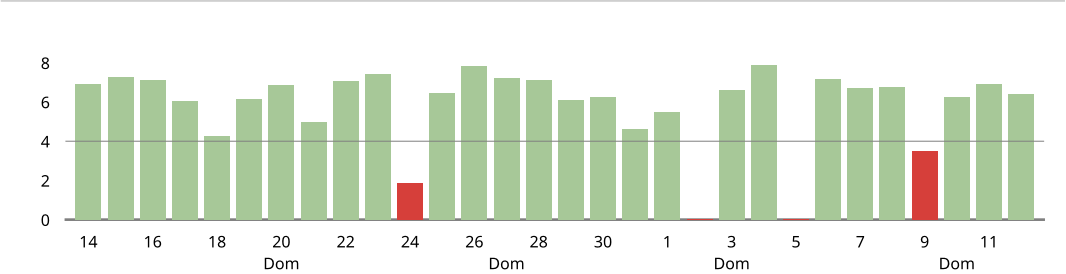


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22171064337


Utilização (horas)

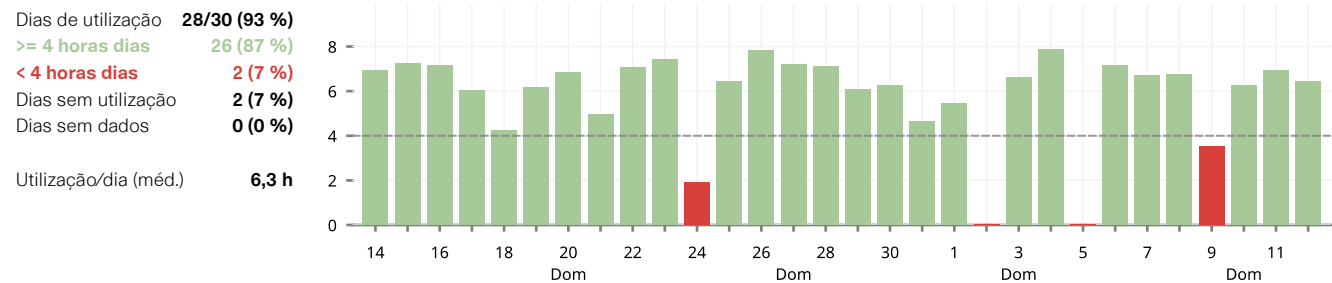

Fuga (l/min)

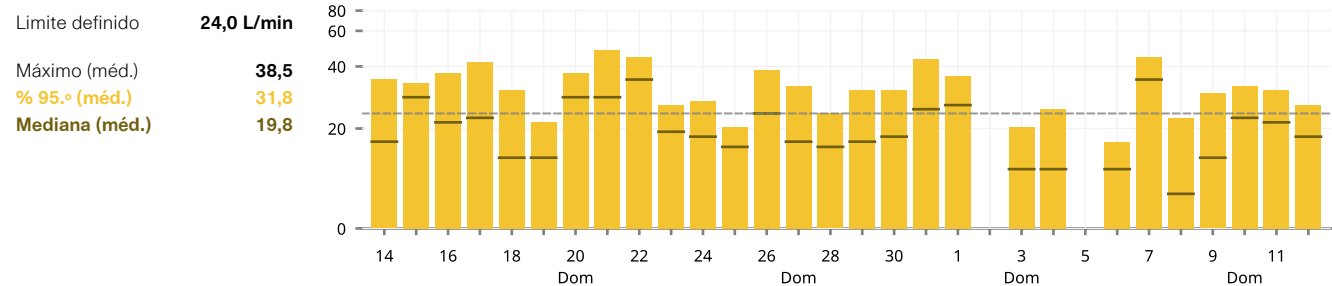

Pressão (cmH2O)

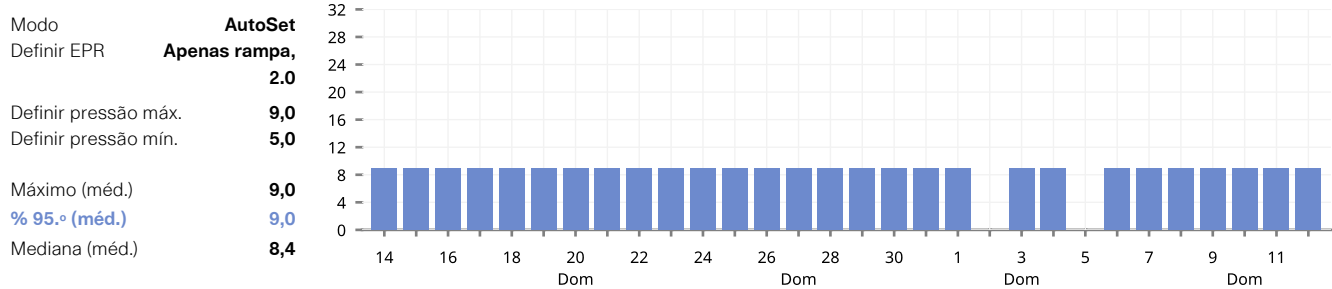

IAH (eventos/hora)

