


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/10/2025 - 11/11/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	21 dias (70%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	144 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 12 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/11/2025)	9,913 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22171064337
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 9.0	
Fugas — l/min	Mediana: 15.9	Percentil 95.º: 28.7	Máximo: 38.0	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.2	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

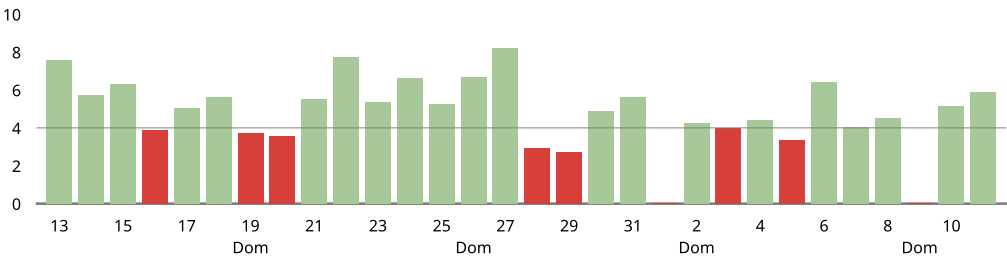


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22171064337


Utilização (horas)

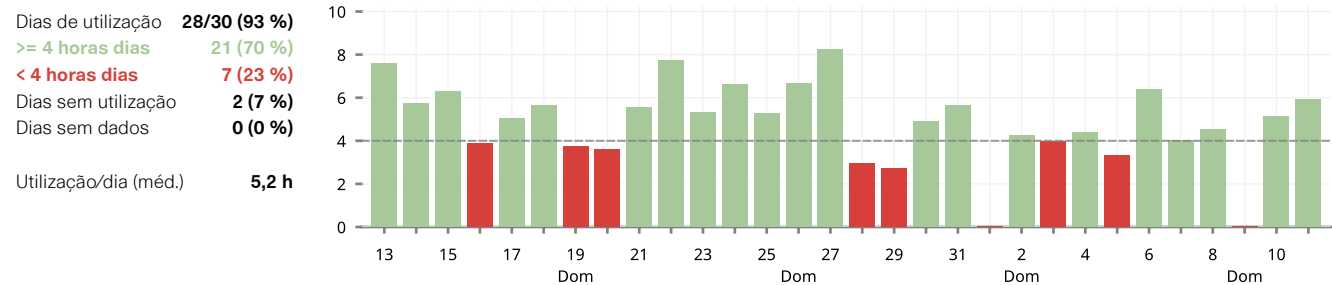

Fuga (l/min)

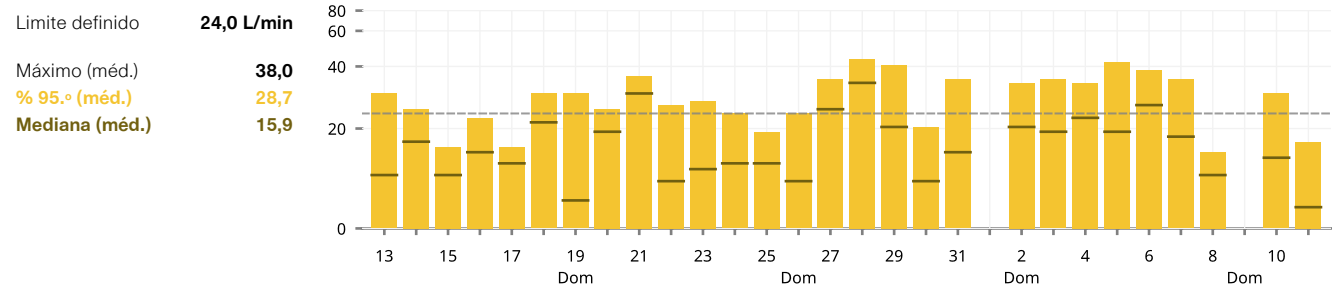

Pressão (cmH2O)

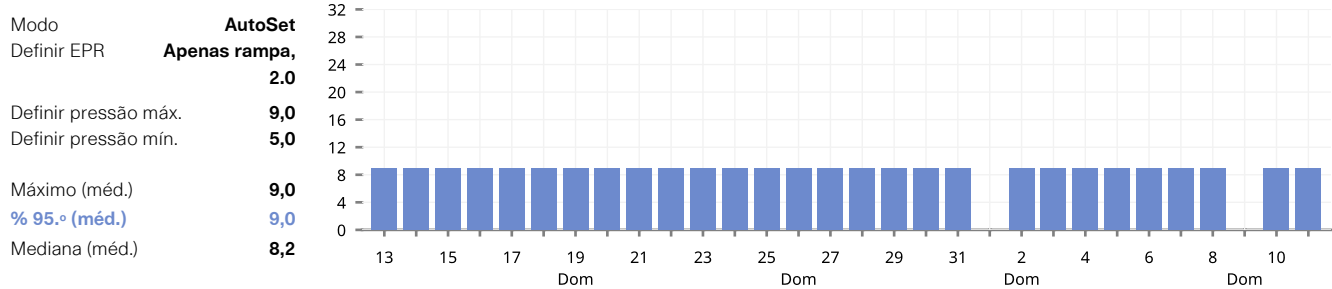

IAH (eventos/hora)

