


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/08/2025 - 27/08/2025
Dias de utilização	13/13 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (85%)	
< 4 horas	2 dias (15%)	
Horas de utilização	74 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 45 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/08/2025)	774 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882307
Modo	CPAP
Pressão definida	11.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 3.8	Máximo: 9.5	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.5	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

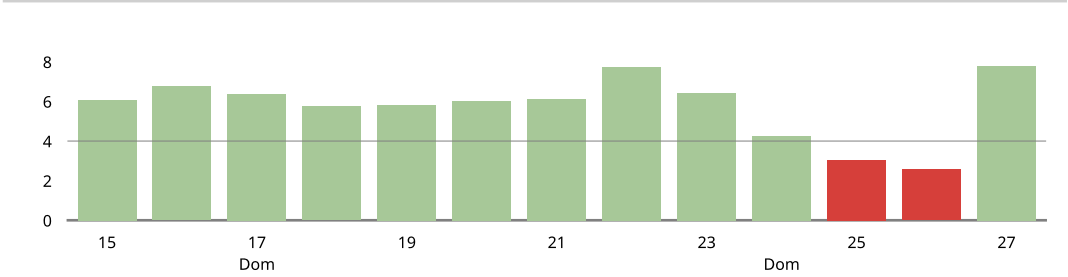

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882307

Utilização (horas)

Dias de utilização **13/13 (100 %)**

>= 4 horas dias

11 (85 %)

< 4 horas dias

2 (15 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

5,7 h

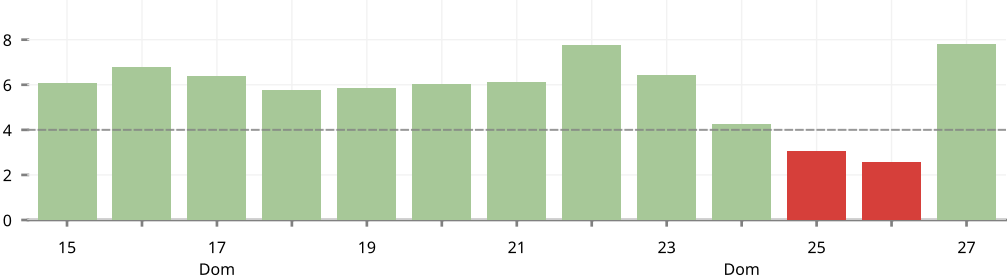

Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


9,5

% 95.º (méd.)

3,8

Mediana (méd.)

0,0

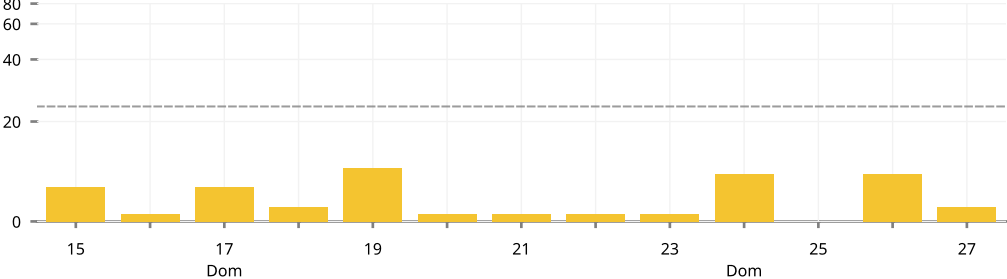

Pressão (cmH2O)

Modo


CPAP

Definir EPR

Apenas rampa, 1.0

Pressão definida

11,2

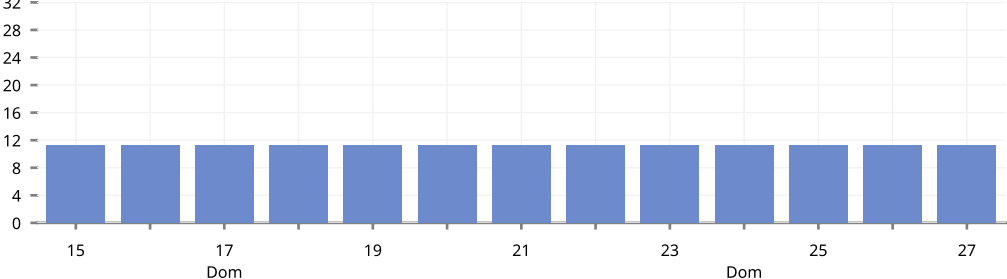

IAH (eventos/hora)

IAH

0.8

IH

0.5

IA

0.3

IAC

0.0

IAO

0.2

IAD

0.0

RERA

0.6

%RCS (méd.)

0.0

