


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/09/2025 - 24/09/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	1 dias (14%)	
< 4 horas	6 dias (86%)	
Horas de utilização	14 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	1 horas 58 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/09/2025)	1,814 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 12.9	Percentil 95.º: 13.8	Máximo: 13.9	
Fugas — l/min	Mediana: 14.1	Percentil 95.º: 39.6	Máximo: 53.7	
Eventos por hora	IA: 18.7	IH: 12.4	IAH: 31.1	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 15.3	Desconhecid	3.1
Índice RERA	3.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

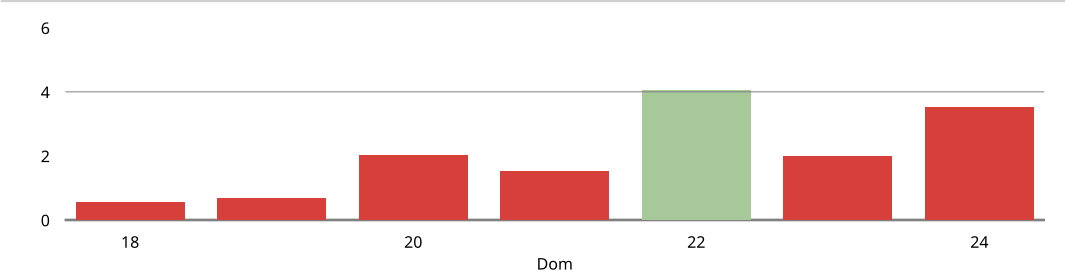


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)

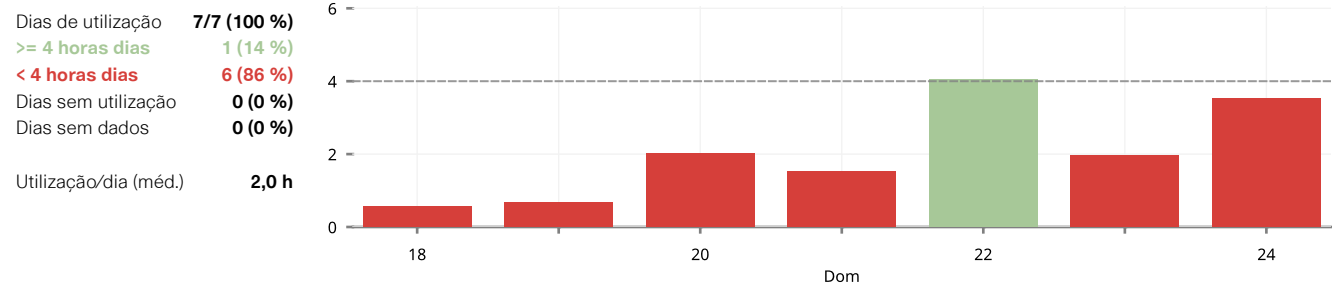

Fuga (l/min)

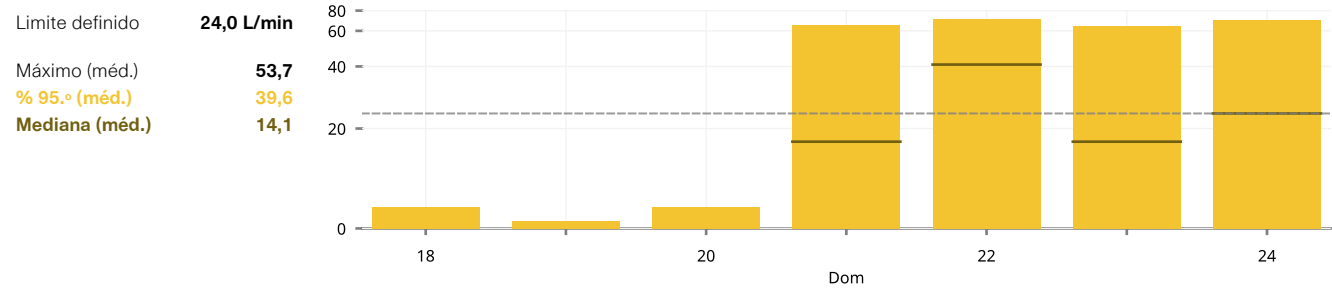

Pressão (cmH2O)

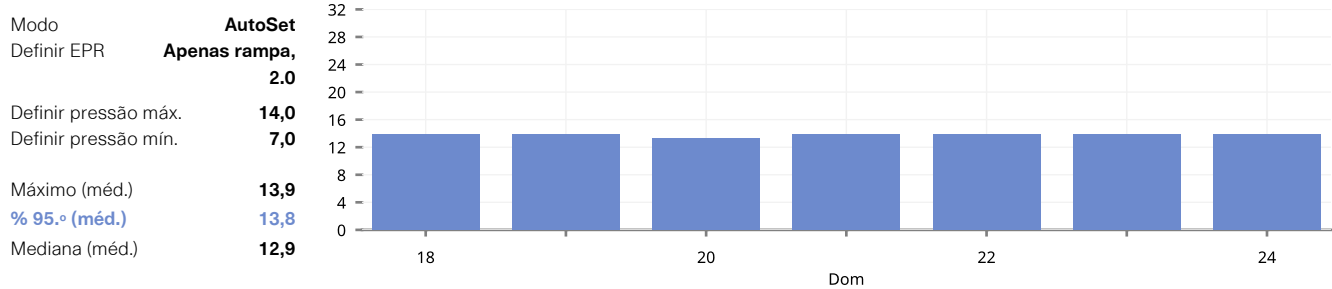

IAH (eventos/hora)

