

# Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

12/08/2025 - 17/08/2025

Dias de utilização

6/6 dias (100%)

>= 4 horas

6 dias (100%)

< 4 horas

0 dias (0%)

Horas de utilização

52 horas 54 minutos

Utilização média (total de dias)

8 horas 49 minutos

Utilização média (dias de utilização)

8 horas 49 minutos

Utilização mediana (dias de utilização)

8 horas 31 minutos

Total de horas de uso (último reset de valores - 17/08/2025)

3,772 horas

AirSense 10 AutoSet

Número de série

22222291901

Modo

AutoSet

Pressão mín.

7 cmH2O

Pressão máx.

10 cmH2O

EPR

Apenas rampa

Nível de EPR

1

Resposta

Suave

Terapia

Pressão — cmH2O

Mediana: 7.8

Percentil 95.º: 9.9

Máximo: 10.0

Fugas — l/min

Mediana: 0.0

Percentil 95.º: 7.0

Máximo: 17.2

Eventos por hora

IA: 1.1

IH: 0.1

IAH: 1.2

Índice de apneia

Central: 0.4

Obstrutiva: 0.6

Desconhecid 0.0


Índice RERA

0.7

Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)

0 minutos (0%)

## Horas de utilização

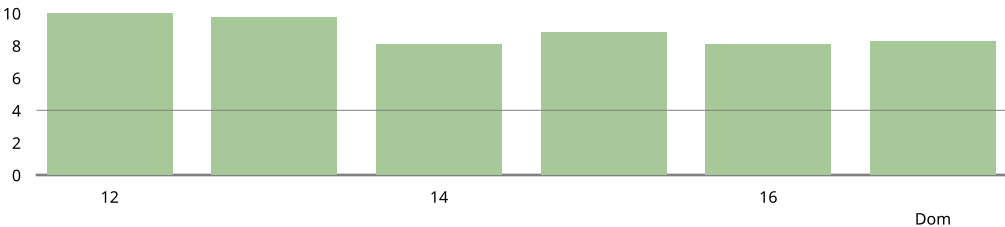


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291901


## Utilização (horas)

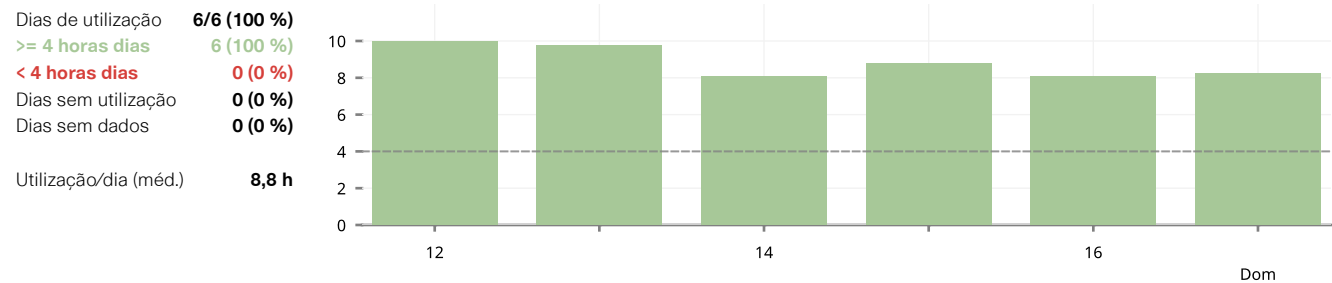

## Fuga (l/min)

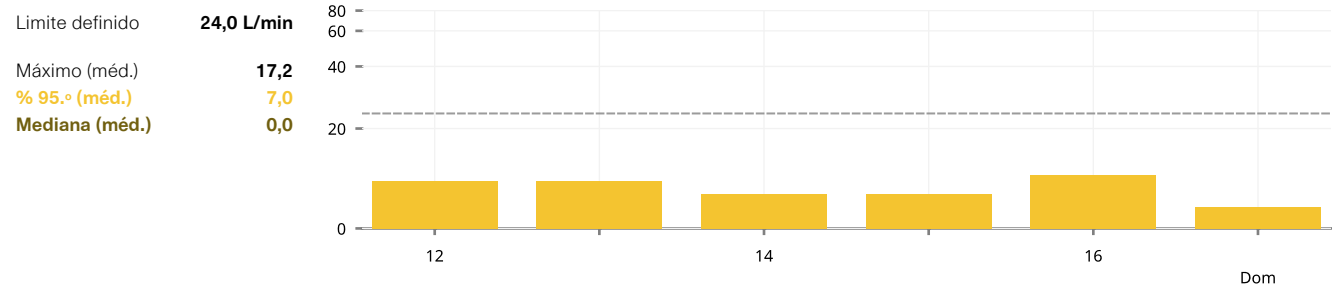

## Pressão (cmH2O)

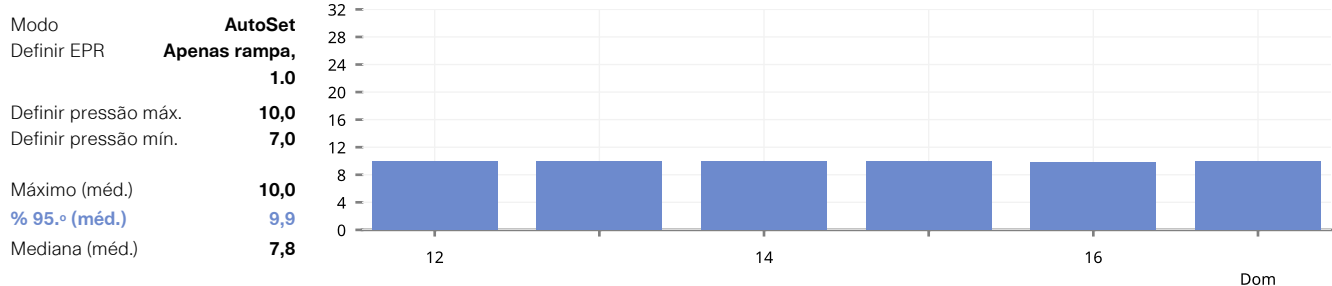

## IAH (eventos/hora)

