


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/09/2025 - 17/09/2025
Dias de utilização	17/17 dias (100%)	
>= 4 horas	17 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	132 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 48 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/09/2025)	862 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881622
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.0	Máximo: 9.1	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 1.3	IAH: 2.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

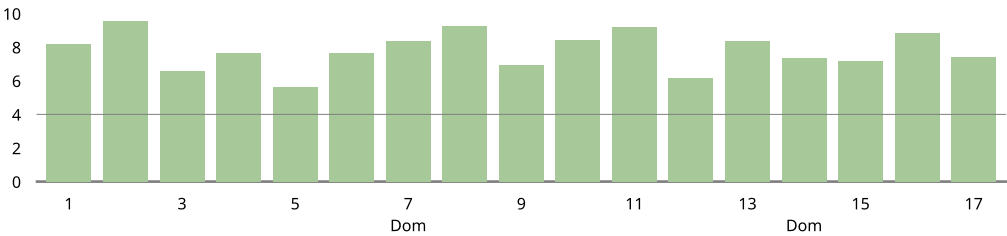

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881622

Utilização (horas)


Dias de utilização **17/17 (100 %)**
>= 4 horas dias **17 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,8 h**

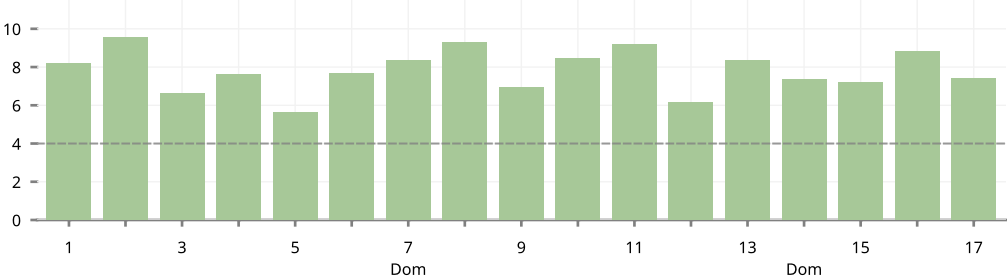

Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **9,1**
% 95.º (méd.) **0,0**
Mediana (méd.) **0,0**

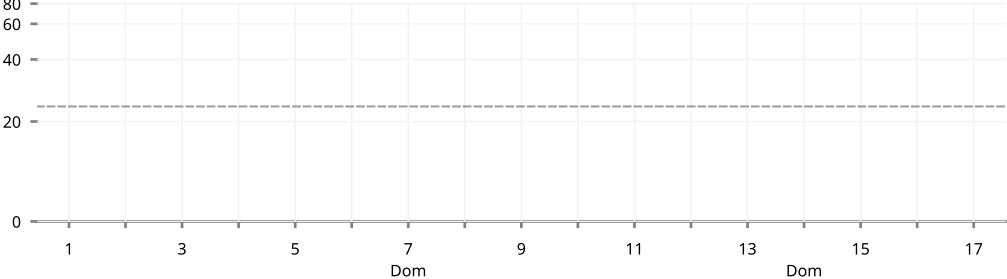

Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Desl.**

Pressão definida **6,6**

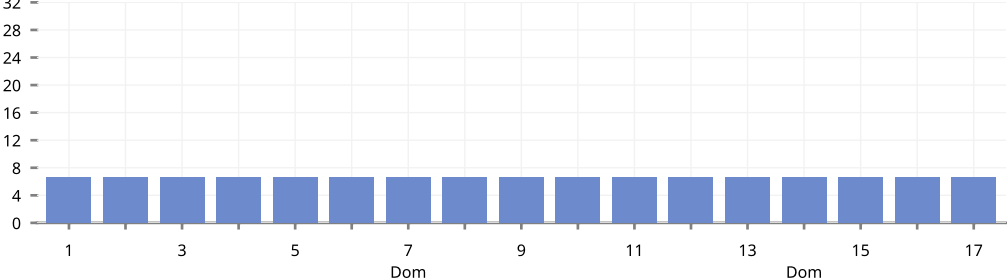

IAH (eventos/hora)

IAH **2.4**
IH **1.3**
IA **1.1**
IAC **0,1**
IAO **1,0**
IAD **0,0**
RERA **1,7**
%RCS (méd.) **0.0**

