

DADOS DO PACIENTE

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAH: **11,5** Média de Utilização (h:min): **1:45** Adesão Tto.*: **0 %** * Últimos 2 Dias
 % noites de utilização CPAP ≥4 horas

EQUIPAMENTOS

EM 23 ago 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 6,0
 Nº de Série: 19042GP4C Alívio Expiratório: 3 cmH₂O
 Modo: Auto SensAwake: Ligado
 Pressão Mín. Ajustada: 7,0 cmH₂O Pressão do SensAwake: 6,0 cmH₂O
 Pressão Máx. Ajustada: 8,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 2 DIAS

22 ago 2025 - 23 ago 2025

INÍCIO DA TERAPIA

12 ago 2025 - 23 ago 2025

Total de Dias:
 Utilização: 2 (100 %) 12 (100 %)
 Utilização >= 4 horas: 0 (0 %) 7 (58 %)
 Não Utilizado: 0 (0 %) 0 (0 %)
 Média de Utilização (Dias em Terapia): 1:45 4:29
 Média de Utilização (Todos os Dias): 1:45 4:29
 Total Func.: 3:30 56:18

EFICÁCIA**

IAH: 11,5 Duração das Apneias: 16 s IAC: 6,9
 Pressão: 6 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 7,5 cmH₂O À Pressão Máxima: 9 %
 Vazamento do Sistema: 28 L/min Vazamento no 90º Percentil: 37 L/min Vazamento Alto: 0 %
 Nº de Ativações do SensAwake: 10 por noite SensAwake Ligado: 100 %

AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 26 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 1:45
 Dias de Utilização: 100 %

■ Total Func.
 ■ Total de Utilização
 ■ Utilização <4 h
 Umidif.



DADOS DO PACIENTE

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 11,5
 IAC: 6,9
 IAO: 1,8
 IH: 2,9

IAH Total

IAH = 5



PRESSÃO

cmH₂O


Média: 6,0
 90º Percentil: 7,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx



VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 28
 90º Percentil: 37

Média

90º Percentil

Vazamento Alto



UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 1:45
 Dias de Utilização: 100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h


Umidif.



RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome:	REINALDO KRUGNER	Telefone:	—
Identificação Paciente:	—	E-mail:	—
Data de Nascimento:	08 set 1966	Sexo:	—

Histórico de Prescrições

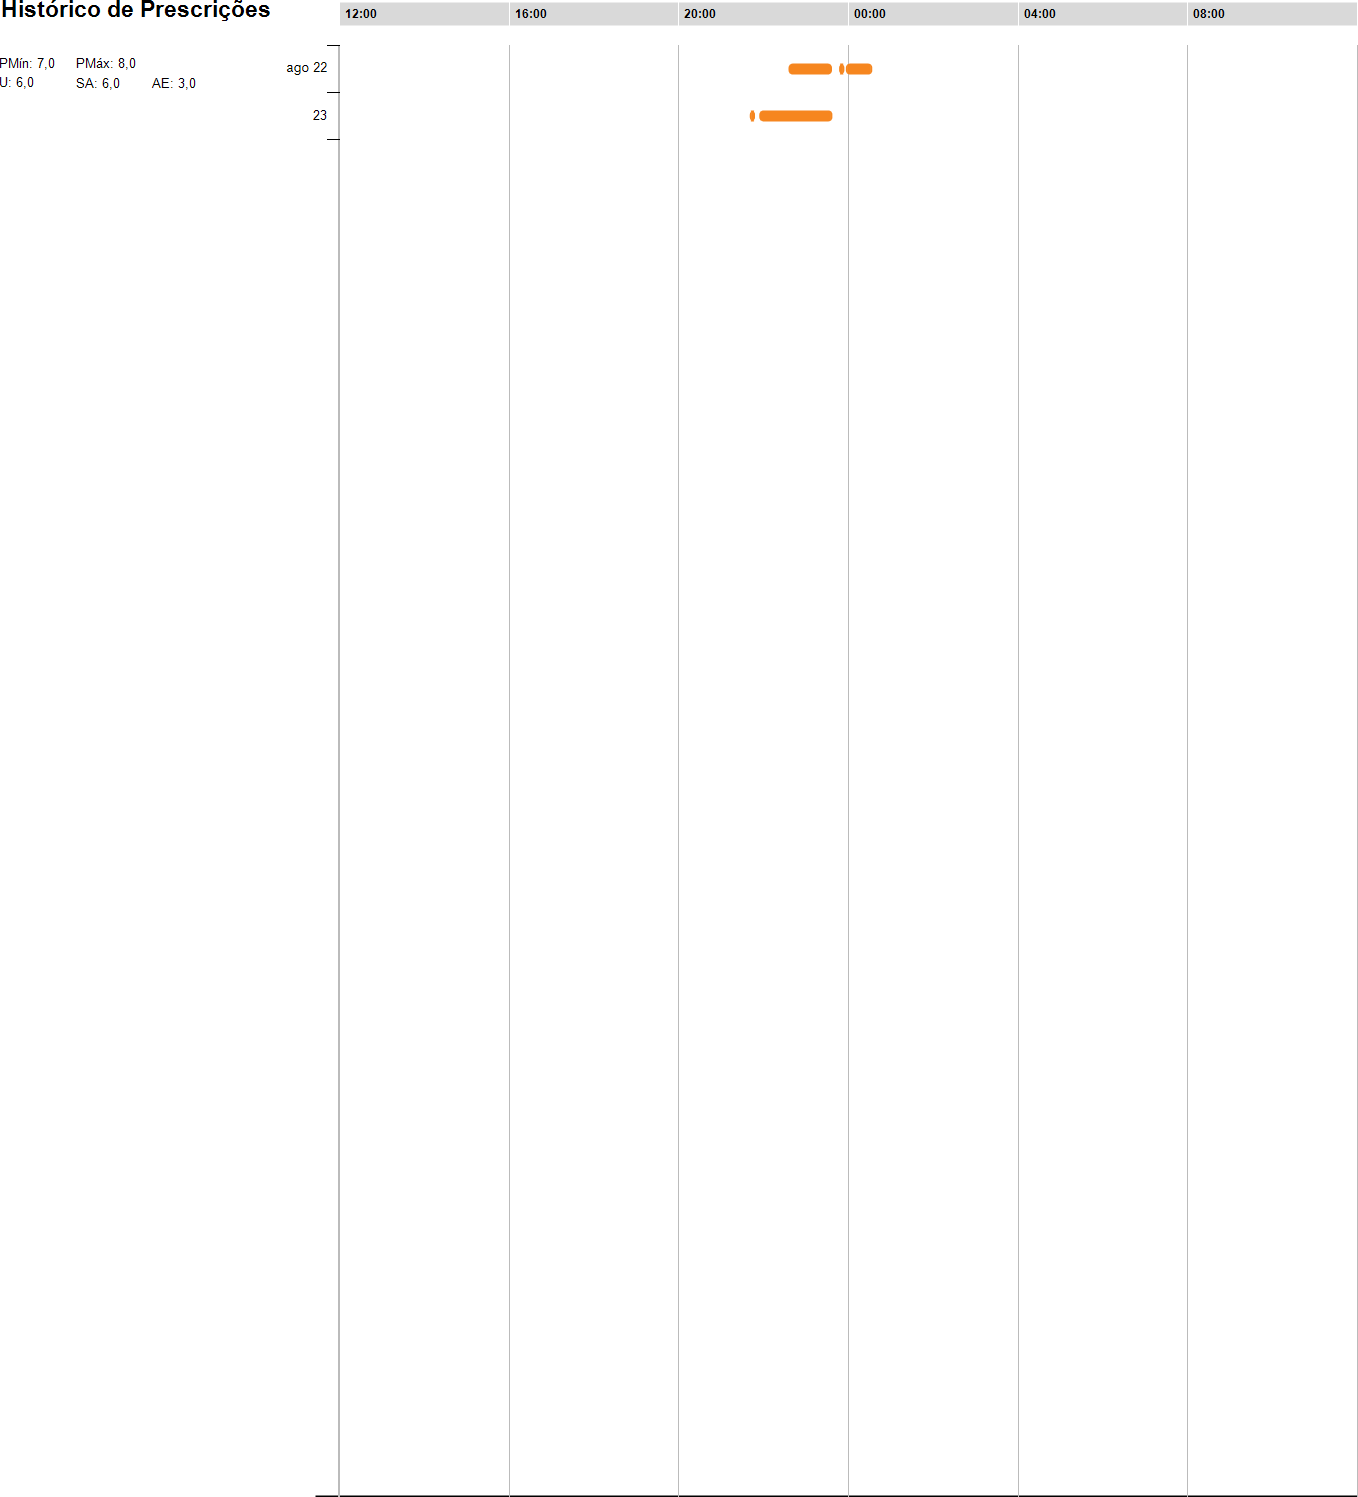

Adesão <4 horas 82% Adesão <4 horas e utilização <100% Utilização 100% 82% Utilização <100%

PMín: Pressão Mínima PMáx: Pressão Máxima U: Umidif. SA: SensAwake AE: Alívio Expiratório

..... Alteração de prescrição

22 ago 2025


sex 22 ago 2025 22:35 -
sáb 23 ago 2025 00:32

Nome: REINALDO KRUGNER
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 08 set 1966

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 1:42
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 12,9
Apneia obstrutiva: 5
IAO: 3,0
Hipopneias: 4
IH: 2,3
Apneias centrais: 13
IAC: 7,6
Limitações de Fluxo: 5
Limitações de Fluxo (/h): 2,9
SensAwake-Total: 12
SensAwake (/h): 7,1

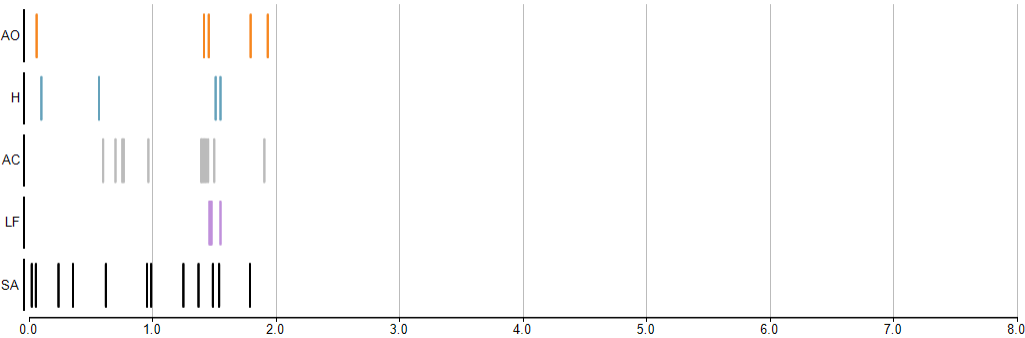


PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 7,5
Tempo de Rampa
Min / Máx

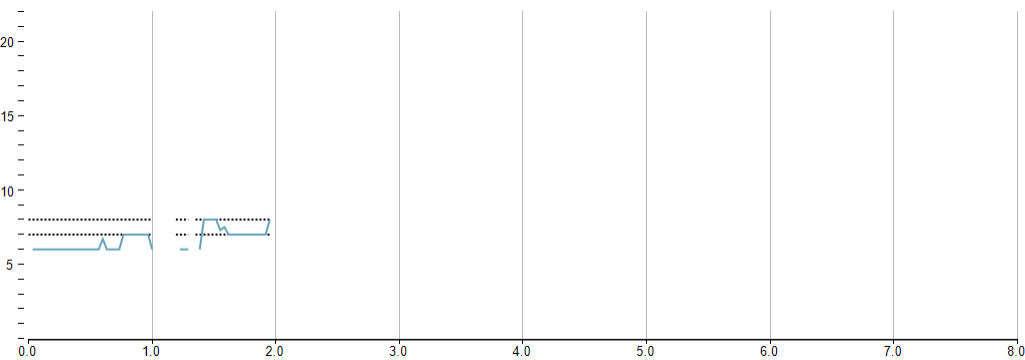

VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 25
90º Percentil: 35
Vazamento Alto*: 0 %

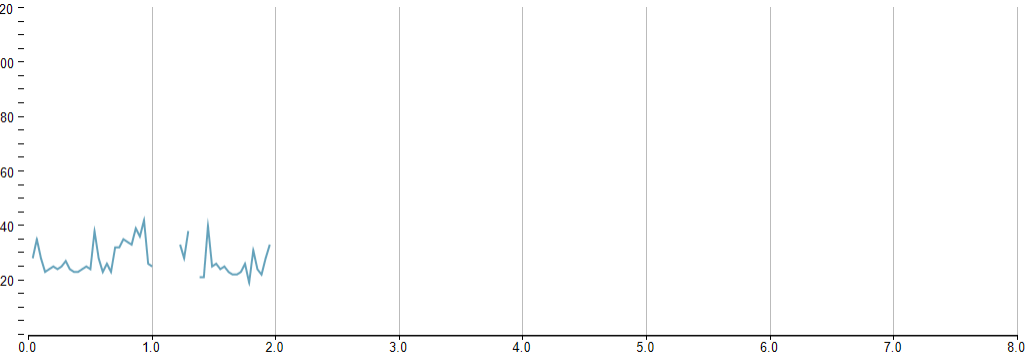

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	52	38	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23 ago 2025

sáb 23 ago 2025 21:40 -
sáb 23 ago 2025 23:36


Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 10,1
Apneia obstrutiva: 1
IAO: 0,6
Hipopneias: 6
IH: 3,4
Apneias centrais: 11
IAC: 6,1
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 8
SensAwake (/h): 4,4

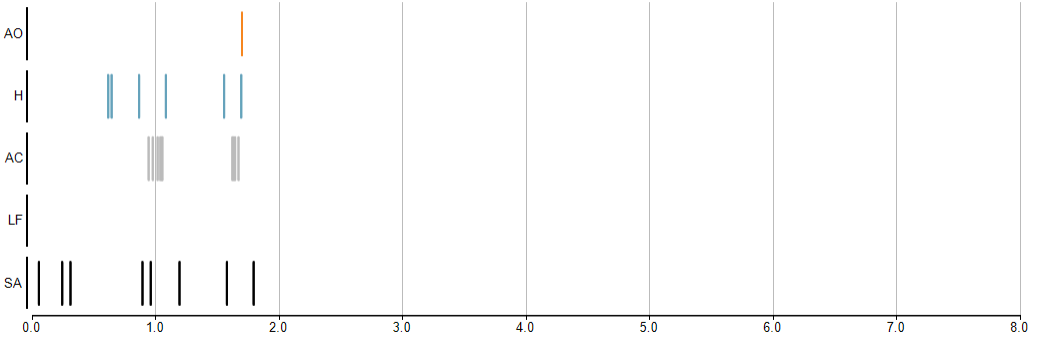


PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 7,5
Tempo de Rampa
Min / Máx

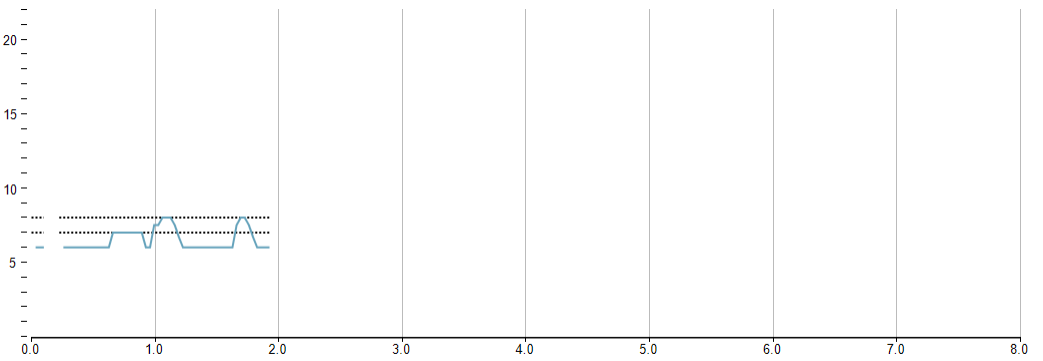

VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 31
90º Percentil: 40
Vazamento Alto*: 0 %

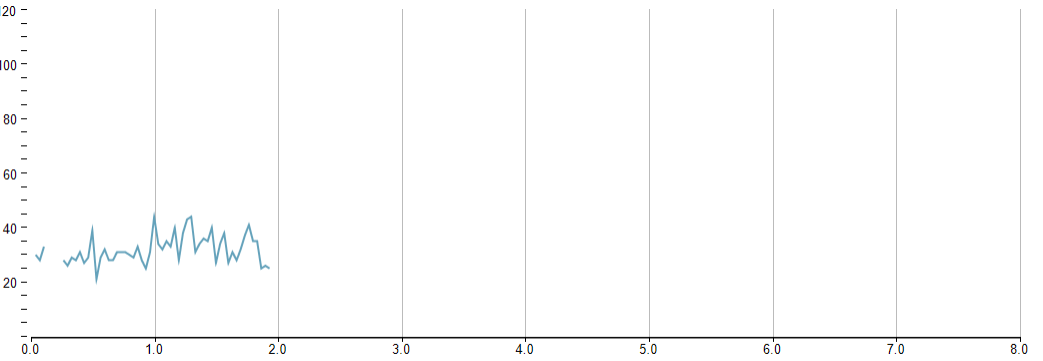

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	68	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 2 DIAS

Nome:

REINALDO KRUGNER

Telefone:

—

Identificação Paciente:

—

E-mail:

—

Data de Nascimento:

08 set 1966

Sexo:

—

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
22 ago 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 8,0	6,0	0	1:42	1:42	12,9	7,6	12	6,0	3	7,5	8,0	35
23 ago 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 8,0	6,0	0	1:48	1:48	10,1	6,1	8	6,0	3	7,5	8,0	40