


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/12/2025 - 13/01/2026
Dias de utilização	11/30 dias (37%)	
>= 4 horas	9 dias (30%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	59 horas 8 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 58 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 23 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 26 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/01/2026)	4,369 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039626
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 7.1	Máximo: 7.7	
Fugas — l/min	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 24.7	Máximo: 32.1	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

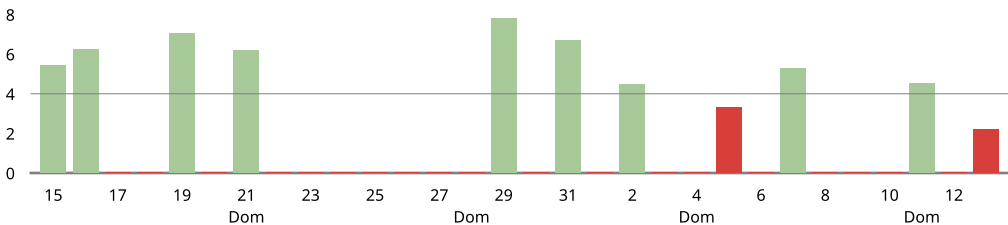


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039626


Utilização (horas)

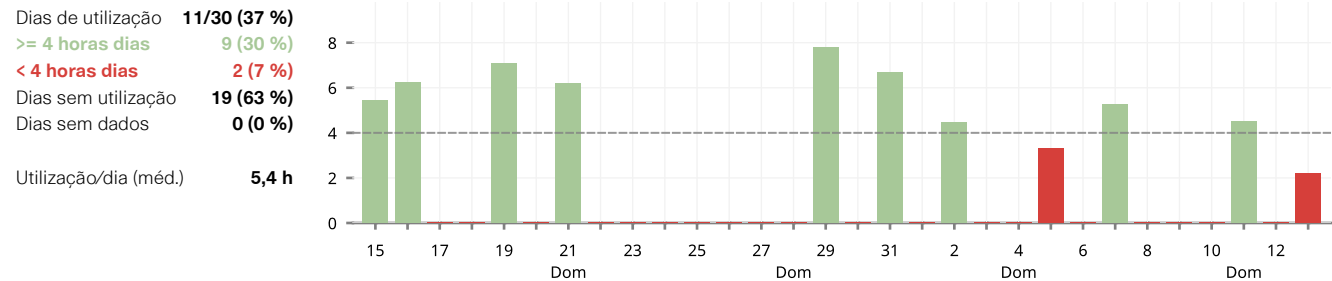

Fuga (l/min)

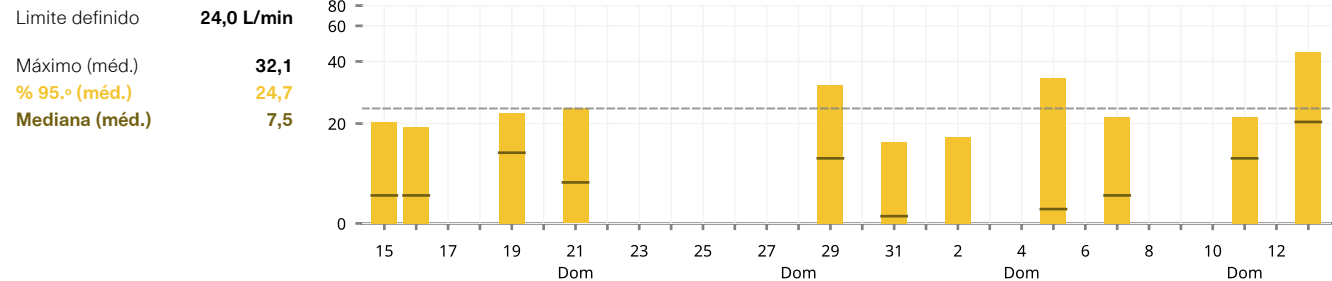

Pressão (cmH2O)

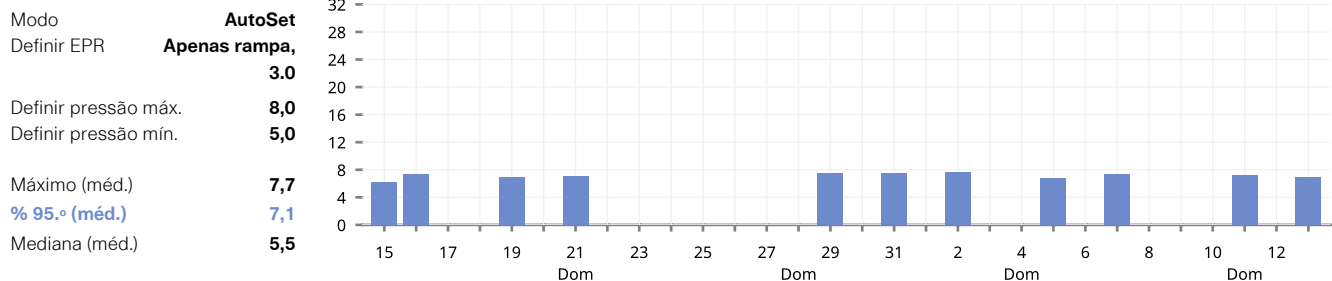

IAH (eventos/hora)

