


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	218 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 18 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 19 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)	10,286 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211044087
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 8.4	
Fugas — l/min	Mediana: 16.6	Percentil 95.º: 29.7	Máximo: 35.8	
Eventos por hora	IA: 5.9	IH: 5.7	IAH: 11.6	
Índice de apneia	Central: 4.6	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.8
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	41 minutos (9%)			

Horas de utilização

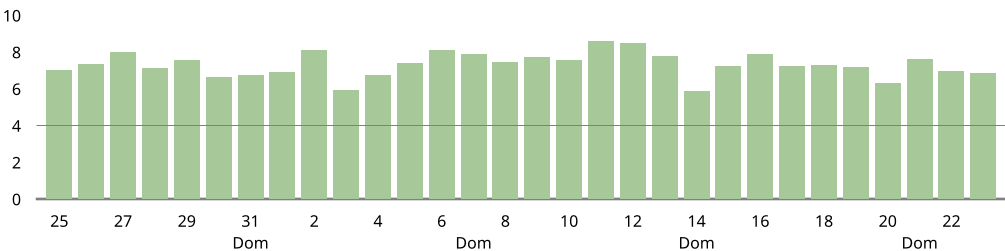


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211044087


Utilização (horas)

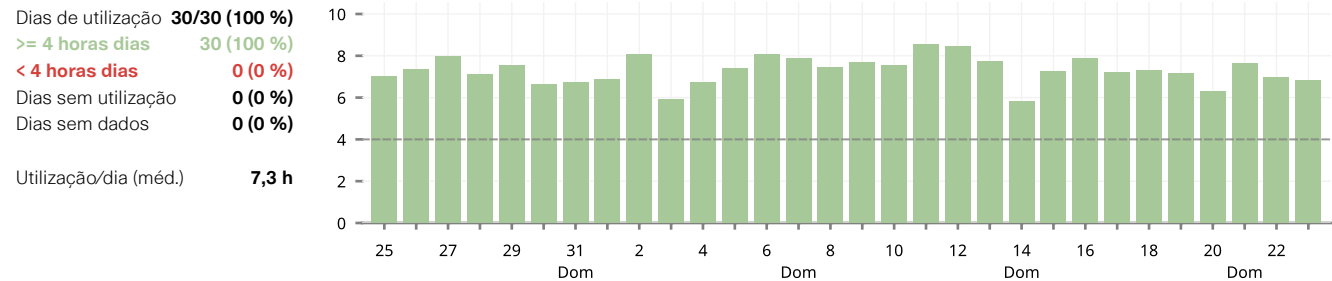

Fuga (l/min)

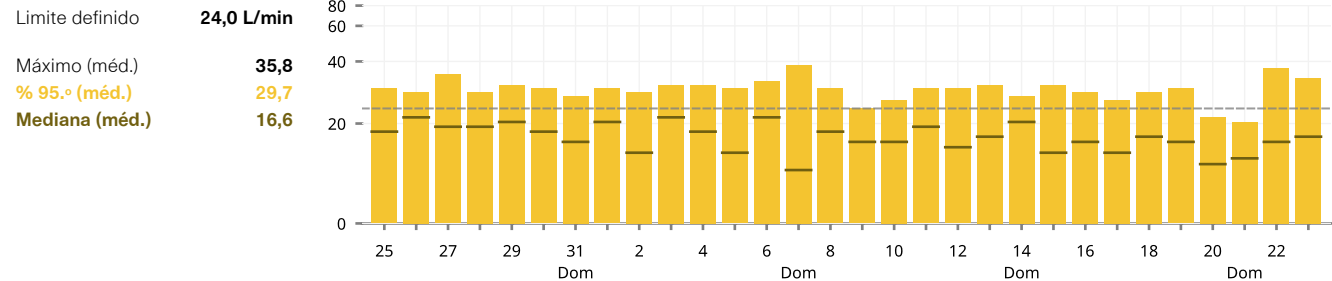

Pressão (cmH2O)

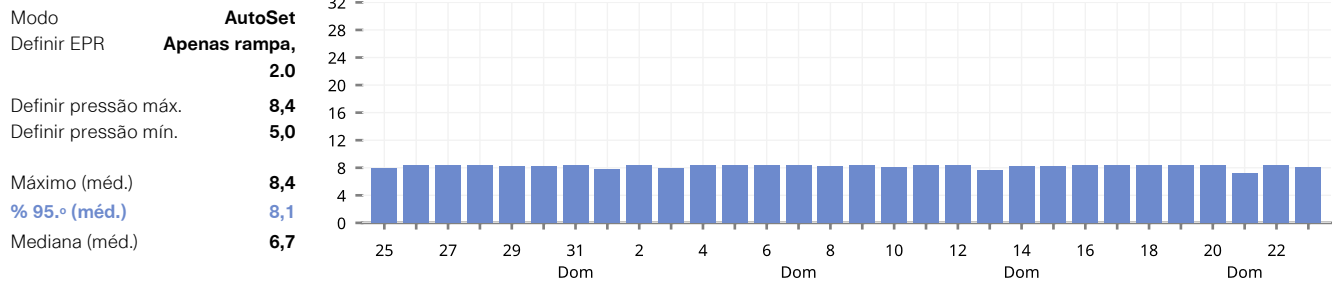

IAH (eventos/hora)

