



Nome do Paciente: FREDERICO BRIGATTE

ID do Paciente:

Relatório preparado por:

Relatório gerado em: 2026/03/10

RELATÓRIO DE TRATAMENTO

Perfil do Paciente

Informação Básica

Nome: FREDERICO BRIGATTE

Gênero: Masculino Idade: 53 Data de Nascimento: 1972/01/31

Altura: 0.0cm Peso: 0.0kg ID do Paciente: IMC: 0.0

Informações de Contato

Endereço:

Número de telefone:

E-mail:

Informação do Médico

Clínica / Hospital:

Nome do Médico:

Departamento:

Seguro

Seguradora:

Número de Membro:

Membro desde: 2025/08/26

Informação do Dispositivo

Tipo de Dispositivo: Auto CPAP Modelo do Dispositivo: G2S A20

NS do Dispositivo: ES422441072 Versão do Firmware: G2.1-

ID de Configuração:

Tipo de Módulo de Dados: Outro tipo Modelo de Módulo de Dados:

NS do Módulo de Dados: Versão do Firmware:

Modelo do Humidificador: NS do Humidificador:

Tipo de Máscara: Máscara Nasal Modelo de Máscara:

Tamanho da Máscara: Data de Substituição:

Tipo de Tubo : 22 mm normal Data de Substituição:

Configurações Atuais

Terapia

Modo: AutoCPAP

P Inicial : 4.0 cmH2O

APAP Mín: 6.0 cmH2O Sensibilidade: 3


APAP Máx: 8.5 cmH2O Alerta de Fuga: Desligado

Conforto

Tempo de Rampa: 5 min Auto On: Ligado Humidificador: 2
Reslex: Desligado Auto Off: Ligado Tipo de Máscara: Máscara Nasal
Tipo de Tubo do Ar: 22 mm normal

Lista Diária

Pressão (cmH2O) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

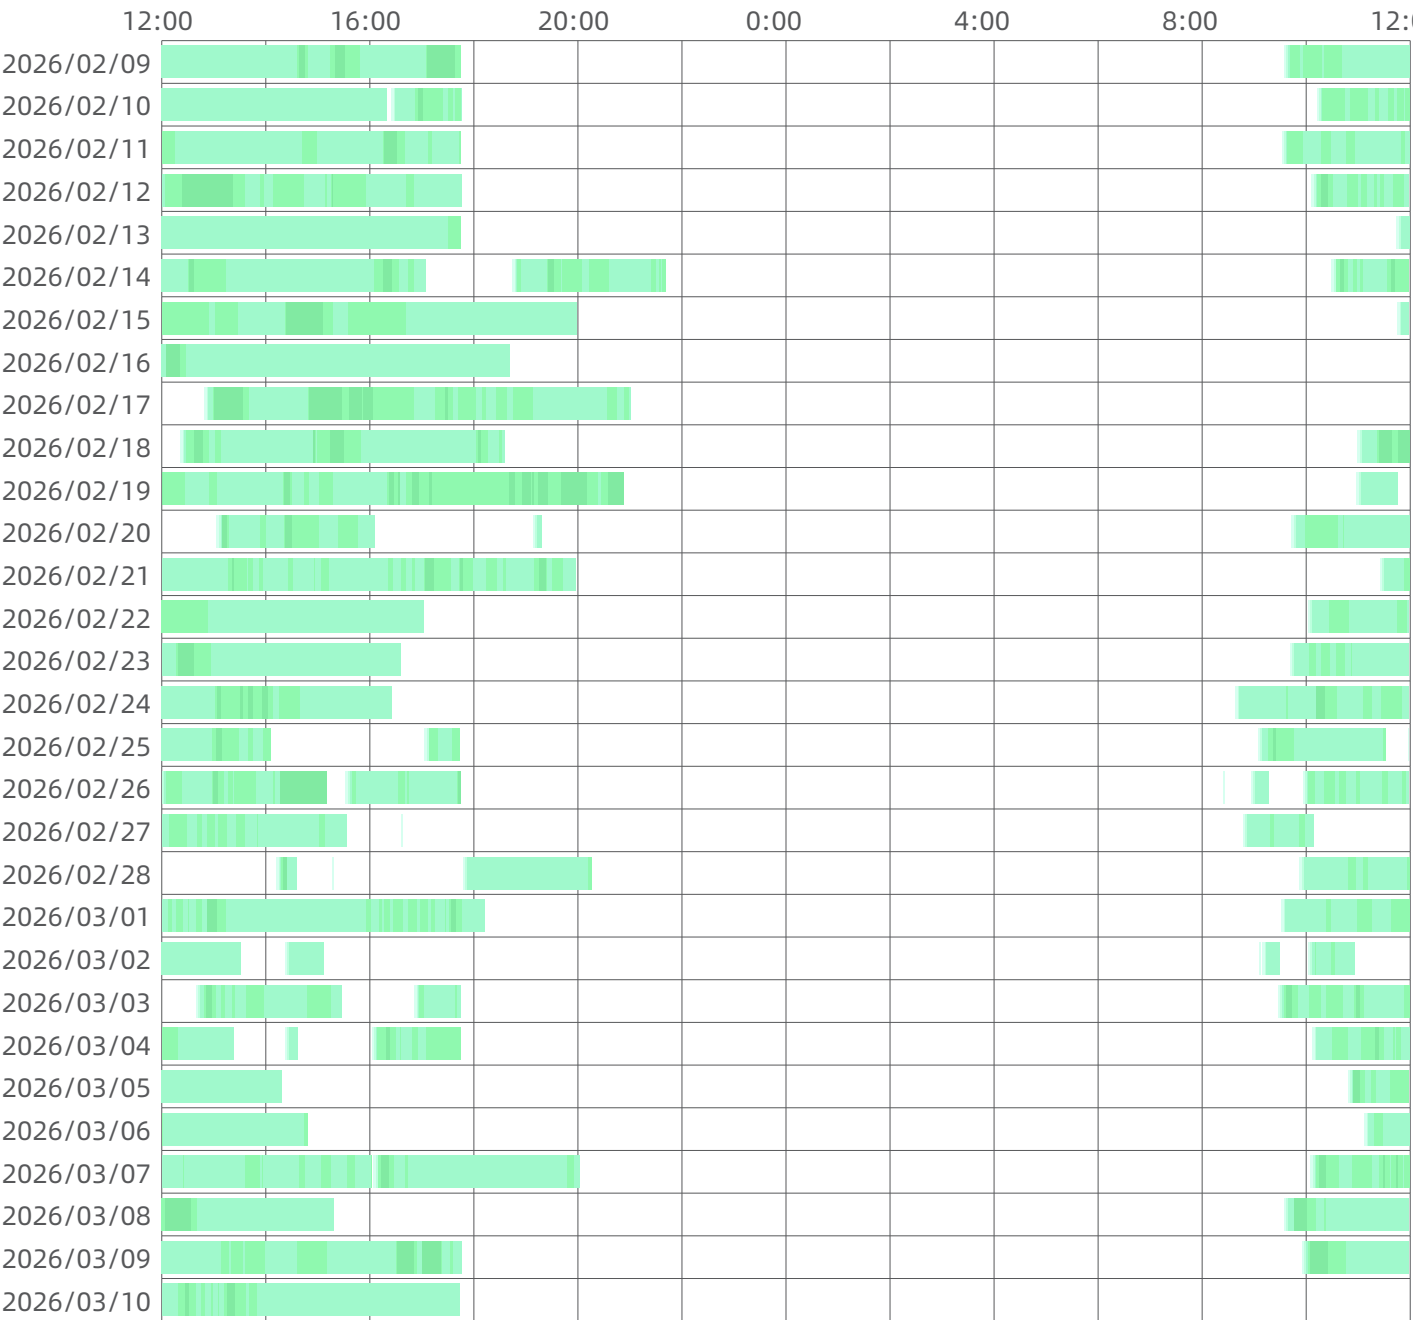

	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-02-09	08:10	6.5	8.5	0.4	0.9
2026-02-10	07:27	6.5	7.5	0.1	1.6

	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-02-11	08:12	6.5	7.5	1.0	0.1
2026-02-12	07:38	7.0	8.0	0.8	0.4
2026-02-13	06:00	6.0	6.0	0.3	0.0
2026-02-14	09:32	6.5	8.0	0.5	0.1
2026-02-15	08:13	6.5	8.5	1.7	0.2
2026-02-16	06:41	6.0	7.0	0.6	0.3
2026-02-17	08:12	7.0	8.0	1.2	0.4
2026-02-18	07:15	6.5	8.0	0.8	1.8
2026-02-19	09:40	7.0	8.0	1.9	1.2
2026-02-20	05:29	6.5	7.5	0.0	0.0
2026-02-21	08:32	6.5	7.5	1.2	1.2
2026-02-22	06:59	6.5	7.5	0.3	0.5
2026-02-23	06:54	6.5	7.5	0.3	0.3
2026-02-24	07:46	6.5	8.0	0.5	0.4
2026-02-25	05:16	6.5	7.5	1.1	0.1
2026-02-26	07:48	6.5	8.5	0.8	1.1
2026-02-27	04:56	6.5	7.5	0.8	0.2
2026-02-28	05:02	6.0	7.0	0.4	2.1
2026-03-01	08:40	6.5	7.5	0.2	0.6
2026-03-02	03:32	6.0	6.5	0.0	0.0
2026-03-03	06:14	6.5	7.5	0.3	0.0
2026-03-04	05:13	6.5	7.5	0.0	0.0
2026-03-05	03:29	6.5	7.5	0.3	0.0
2026-03-06	03:41	6.0	7.0	0.5	0.5
2026-03-07	09:54	6.5	7.5	0.4	0.5
2026-03-08	05:43	6.5	8.0	0.2	0.2
2026-03-09	07:50	6.5	8.5	1.5	1.5
2026-03-10	05:44	6.5	7.5	0.5	4.1

Estatísticas

Total de Uso

Data de Início	2026-02-09	Data de Fim	2026-03-10
Total de Dias	30		
Total de dias com uso	30	% Total de dias com uso	100%
Dias com uso >= 4.0 horas	27	% De dias com uso >= 4.0 horas	90%
Dias com uso < 4.0 horas	3	% De dias com uso < 4.0 horas	10%
Dias sem uso	0	% Dias sem uso	0%
Tempo total de uso (hh:mm)	205:42	Média de tempo de uso diário	1.7
Média de tempo de uso diário (apenas dias com uso)	06:51	Média de tempo de uso diário (total de dias)	06:51

Pressão

Média: 6.5 cmH2O Mediana: 6.3 cmH2O Percentil 95: 7.7 cmH2O Máxima: 8.1 cmH2O


Índices Respiratórios

Índice de Apnéia (IA): 0.5 Índice de Hipopneia (IH): 0.2
Índice de Apneia e Hipopneia (IAH): 0.7 Índice de Apneia Obstrutiva (IAO): 0.4
Índice de Apneia Central (IAC): 0.1


Fuga(L/min)

Média: 0.7 LPM Mediana: 0.0 LPM Percentil 95: 3.6 LPM Máxima: 22.0 LPM
Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min) (hh:mm): 00:00
% Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min): 0%

Gráficos Resumidos

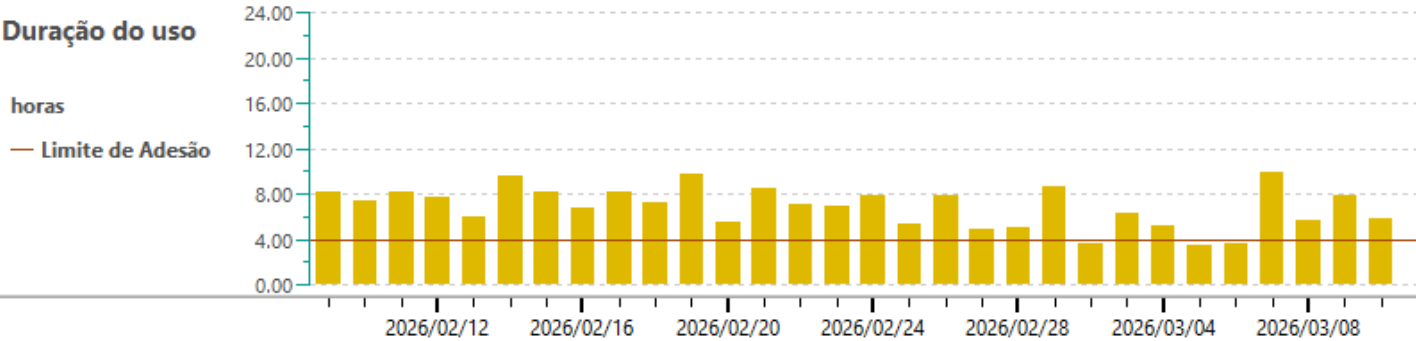


Período de uso

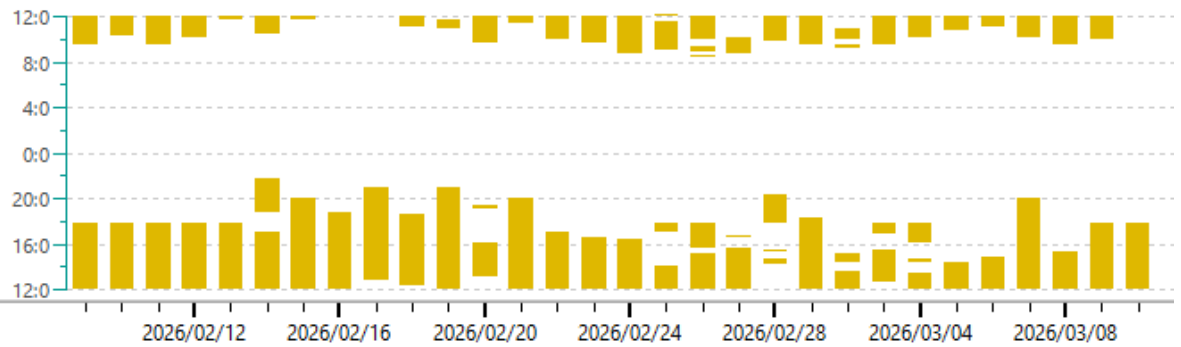

Pressão


cmH2O

Máxima
Percentil 95
Mediana
Média

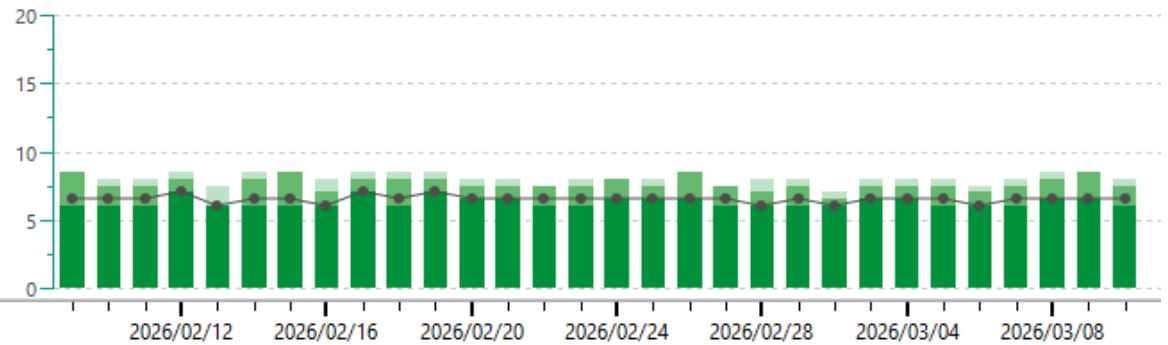

IAH&IA


IAH
IA

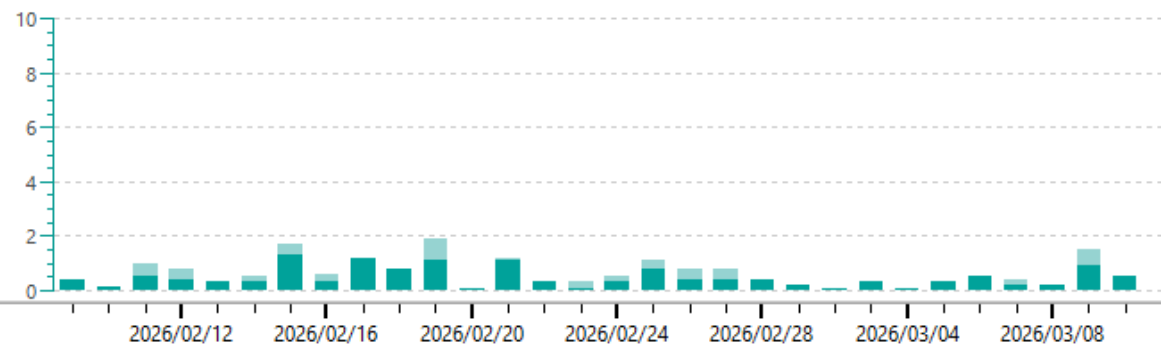

Fuga

LPM

Máxima
Percentil 95
Mediana
Média

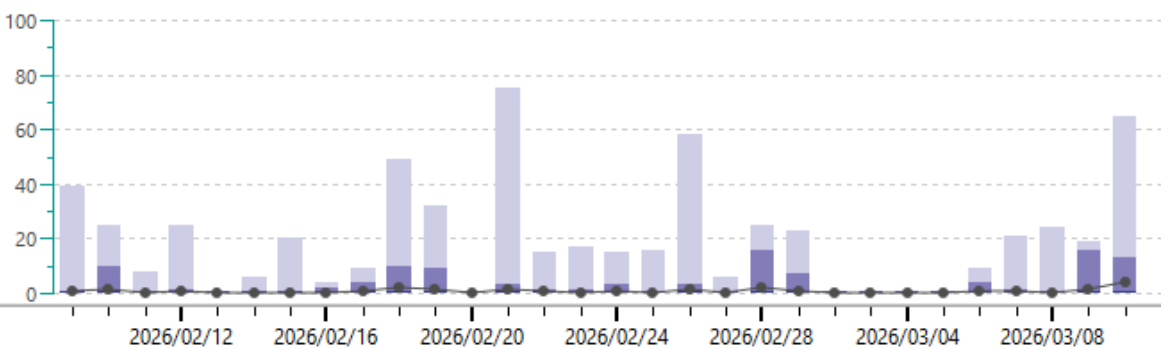


Gráficos Detalhados

2026/03/10

Tendência da Pressão

cmH2O

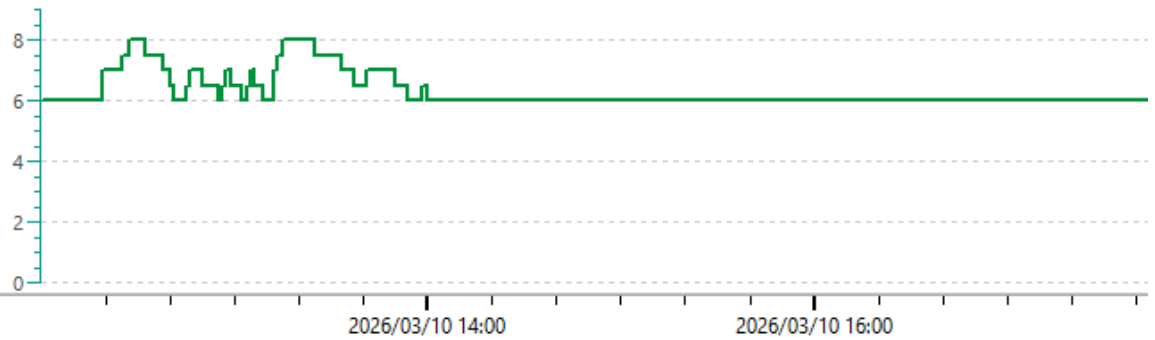

Eventos Respiratórios

AOS

ACS


H

2026/03/10 14:00

2026/03/10 16:00

Fluxo

LPM

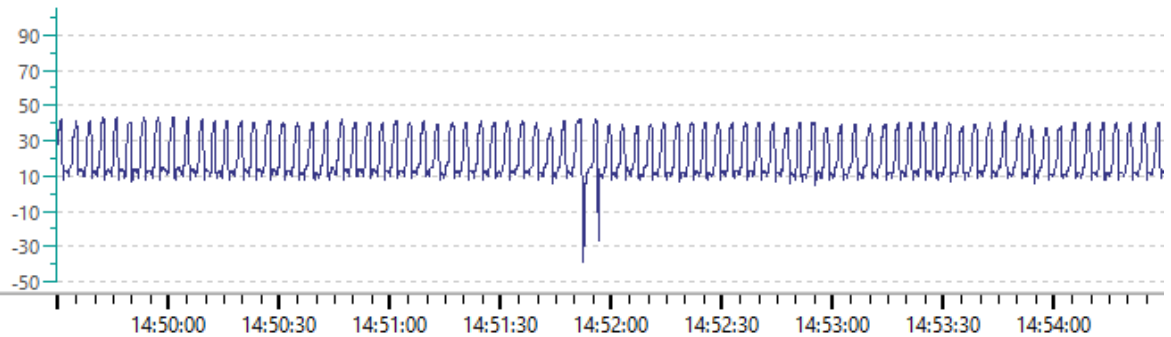

Fuga

LPM



Comentário