


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/08/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	222 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)	2,560 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 17.1	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.9	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	4 minutos (1%)			

Horas de utilização

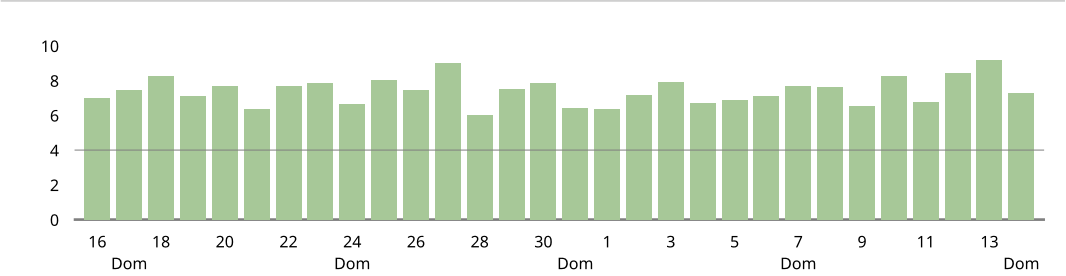

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **30 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,4 h**

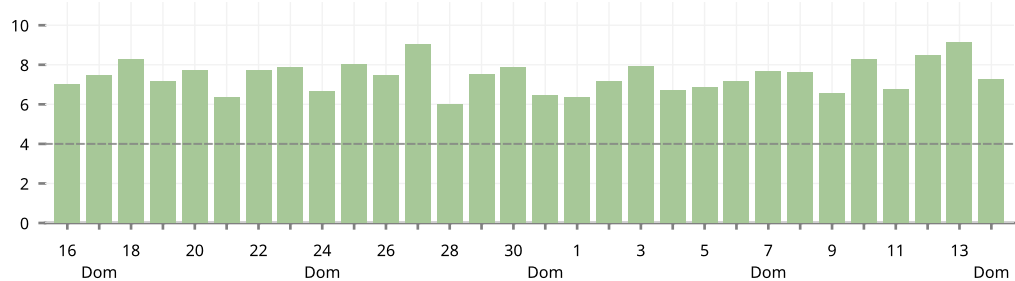

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **17,1**
% 95.º (méd.) **9,8**
Mediana (méd.) **0,1**

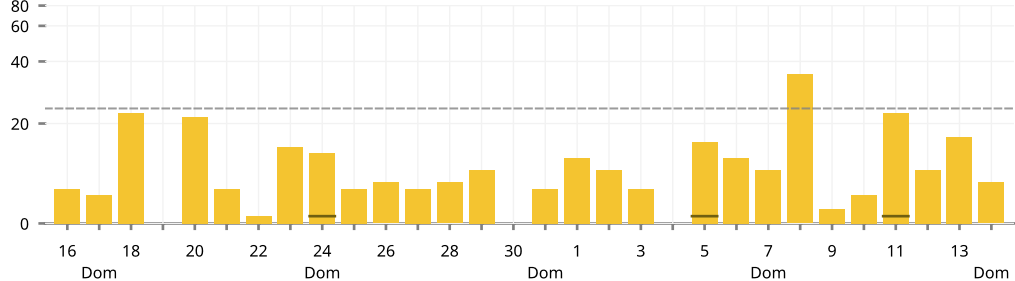

Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Desl.**

Pressão definida **7,0**

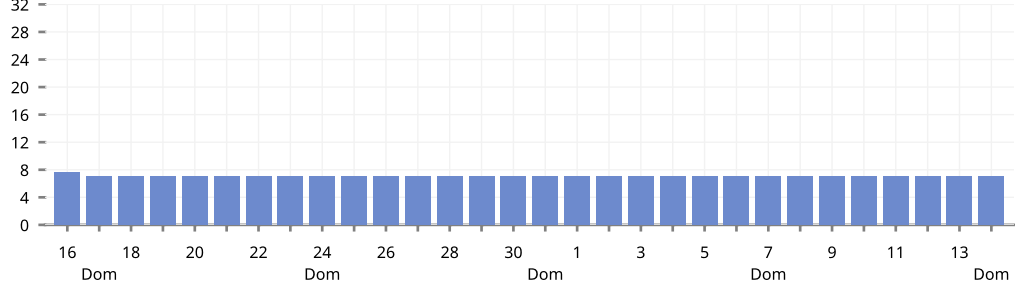

IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC ☐

IAO ☐

IAD ☐

RERA ☐

%RCS (méd.) **1.0**

1.4

0.9

0.5

0.4

0.1

0.0

0.2

