


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/11/2025 - 15/12/2025
Dias de utilização	2/30 dias (7%)	
>= 4 horas	2 dias (7%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	12 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	25 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 15 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/12/2025)	3,132 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222040093
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 10.2	Percentil 95.º: 31.8	Máximo: 36.6	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 1.6	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

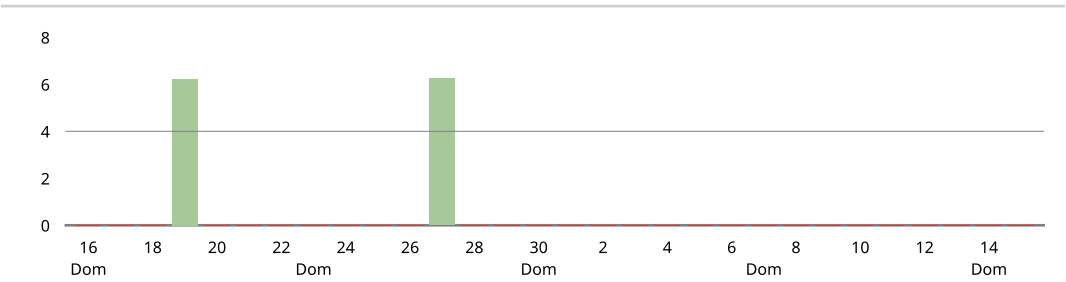


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040093


Utilização (horas)

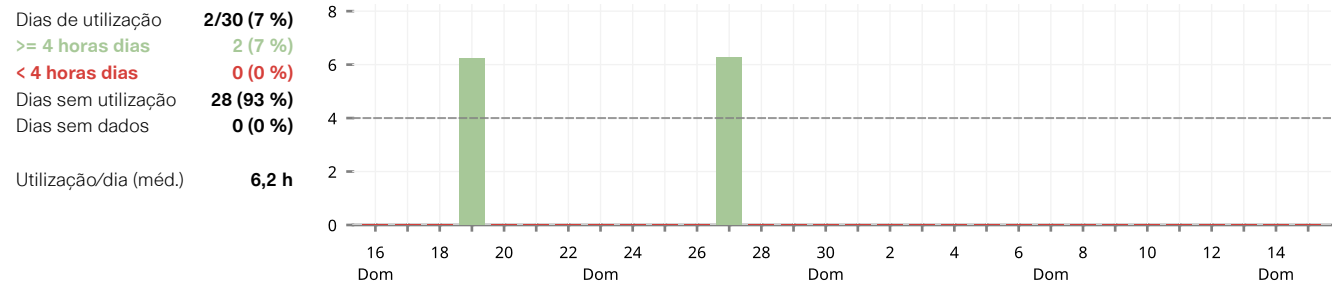

Fuga (l/min)

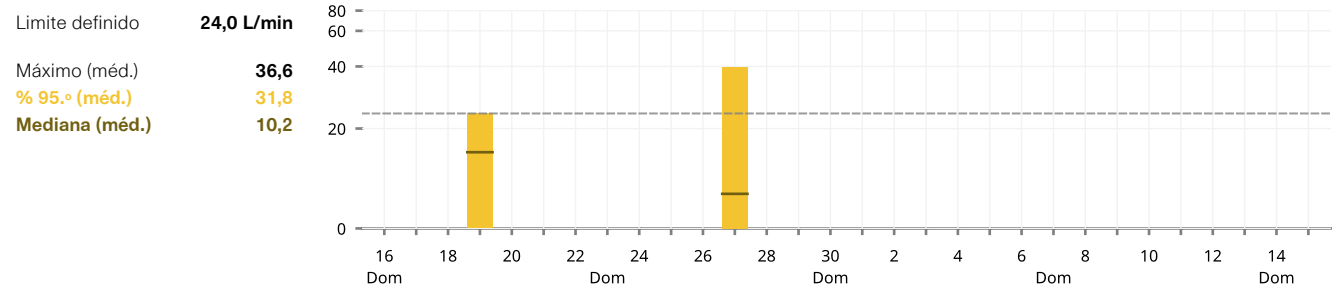

Pressão (cmH2O)

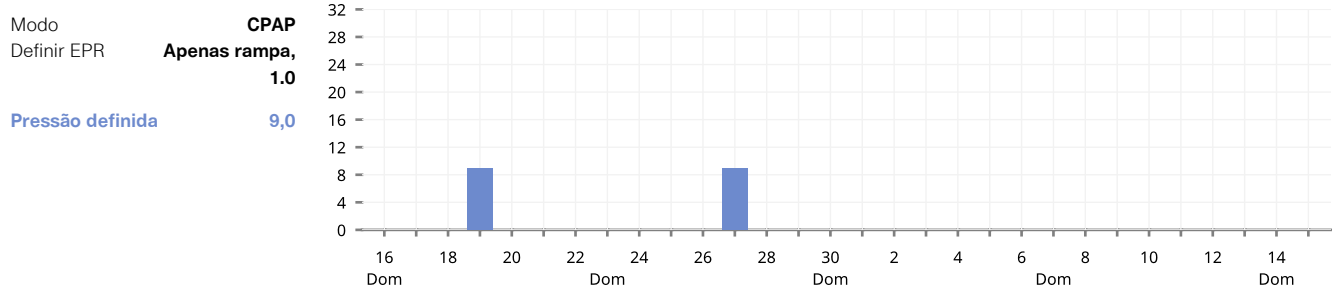

IAH (eventos/hora)

