


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 09/09/2025 - 06/10/2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 15/28 dias (54%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 10 dias (36%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 5 dias (18%)        |                         |
| Horas de utilização                                          | 64 horas 36 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 2 horas 18 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 4 horas 18 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 4 horas 10 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 06/10/2025) | 2,491 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22222292555 |
| Modo                | AutoSet     |
| Pressão mín.        | 5.8 cmH2O   |
| Pressão máx.        | 9 cmH2O     |
| EPR                 | Desl.       |
| Resposta            | Suave       |

| Terapia                                            |          |     |                 |      |                |      |
|----------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|------|----------------|------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: | 7.4 | Percentil 95.º: | 8.7  | Máximo:        | 8.9  |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: | 8.3 | Percentil 95.º: | 27.5 | Máximo:        | 36.6 |
| Eventos por hora                                   | IA:      | 3.4 | IH:             | 0.8  | IAH:           | 4.2  |
| Índice de apneia                                   | Central: | 2.2 | Obstrutiva:     | 0.5  | Desconhecid    | 0.5  |
| Índice RERA                                        |          |     |                 |      |                | 0.5  |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |          |     |                 |      | 0 minutos (0%) |      |

## Horas de utilização

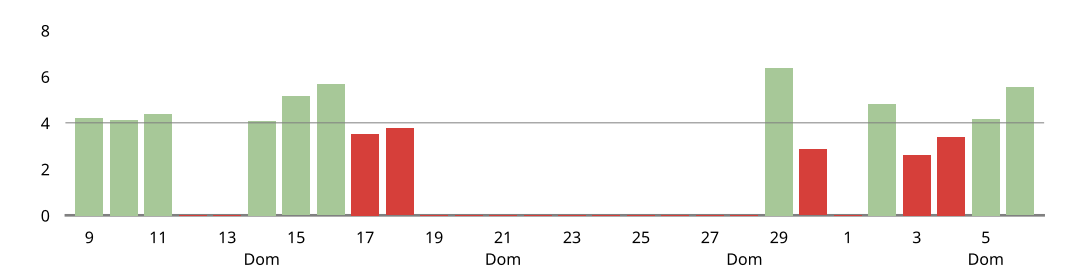


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292555


## Utilização (horas)

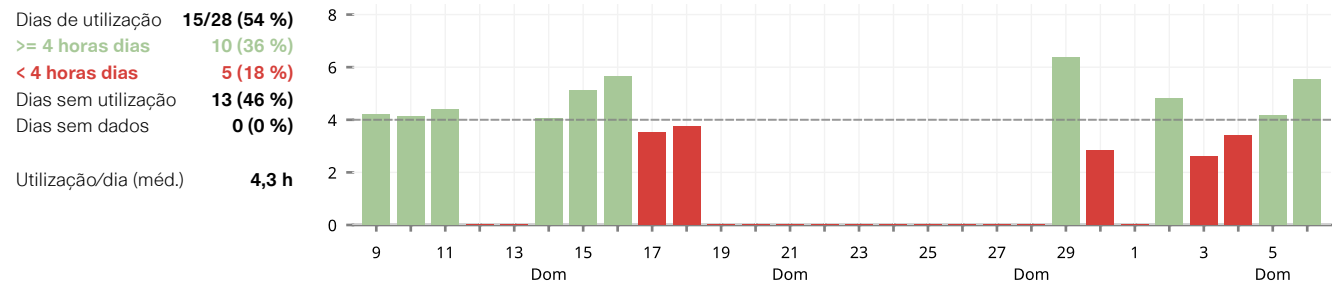

## Fuga (l/min)

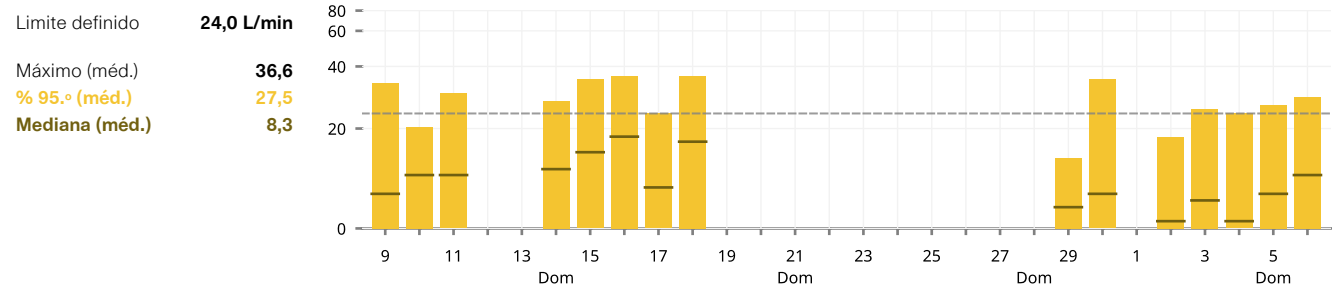

## Pressão (cmH2O)

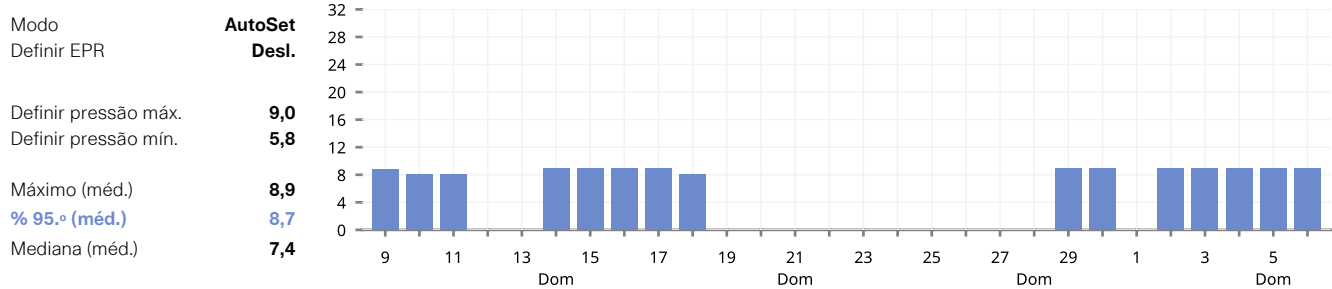

## IAH (eventos/hora)

