


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/09/2025 - 08/10/2025
Dias de utilização	9/10 dias (90%)	
>= 4 horas	9 dias (90%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	52 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 12 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/10/2025)	6,222 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549764
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.1	Percentil 95.º: 14.9	Máximo: 27.6	
Eventos por hora	IA: 3.0	IH: 2.1	IAH: 5.1	
Índice de apneia	Central: 1.5	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

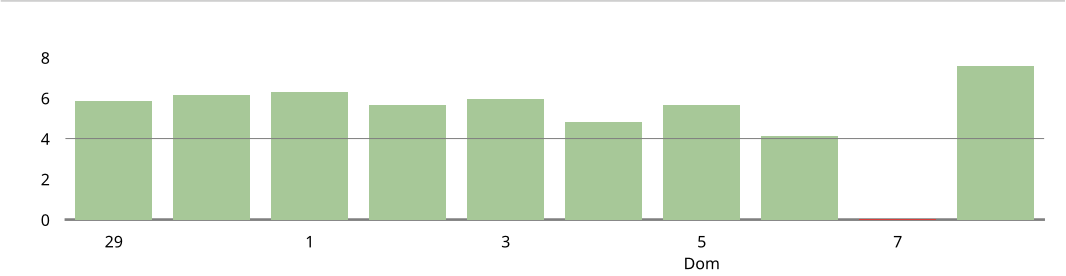


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549764


Utilização (horas)

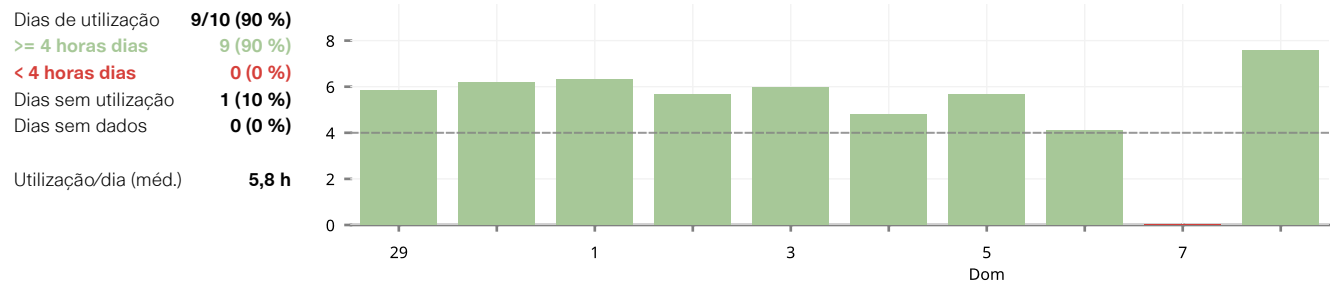

Fuga (l/min)

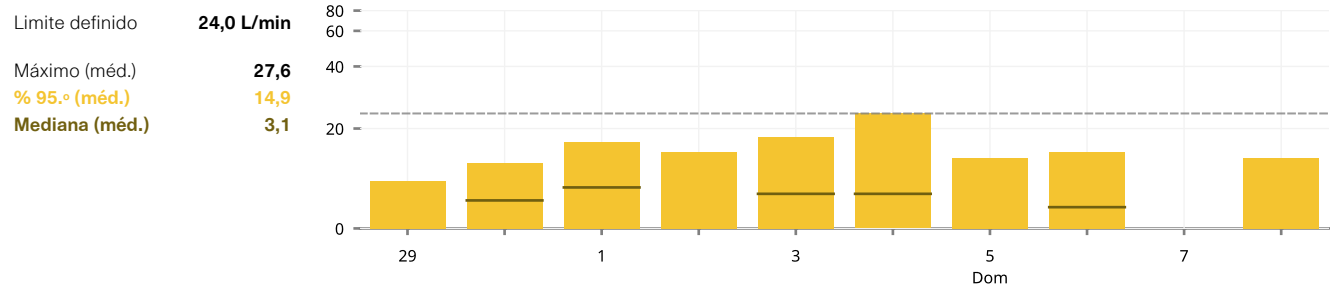

Pressão (cmH2O)

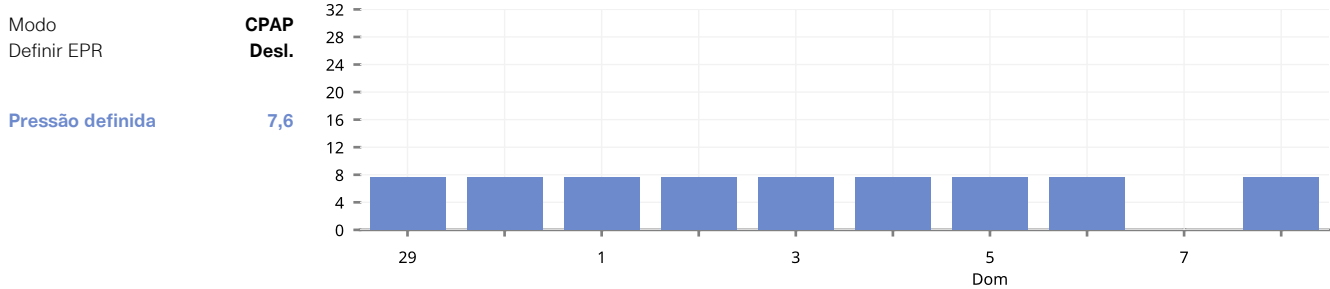

IAH (eventos/hora)

