



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
22/08/2025 a 05/09/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:
SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/09/2025 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010027
Modo: CPAP
Pressão Inicial: 4 cmH2O
Pressão de terapia: 5 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Automático



Utilização

Dias de utilização: 14/15 dias (93%)
≥ 4 horas: 14 dias (93%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 140h24
Utilização média (por dia): 10h1



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 5.0	Mediana: 0.1	IA 0.18
Percentil 90.º: 5.0	Percentil 90.º: 0.0	IH 0.79
Máximo: 5	Máximo: 0.4	IAC 0.01
		IAH 0.97




SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
22/08/2025 a 05/09/2025

Paciente: 9473
Idade: 68 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:
SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/09/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Utilização

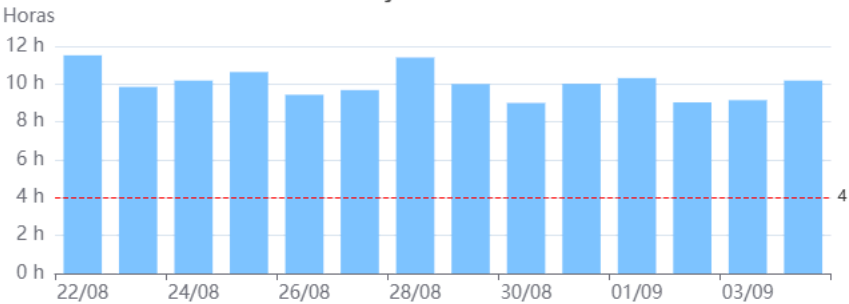

Uso 10h2

Valores médios dos indicadores


Fuga

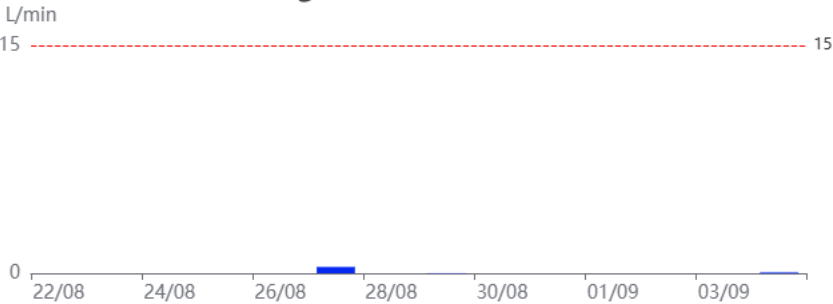

Fuga 0.16

Valores médios dos indicadores


Pressão

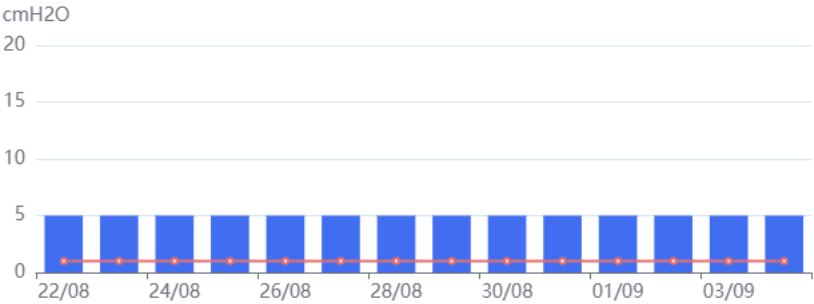

Pressão APAP 0.00
Pressão CPAP 5.00
FPS 1.00

Valores médios dos indicadores

Eventos

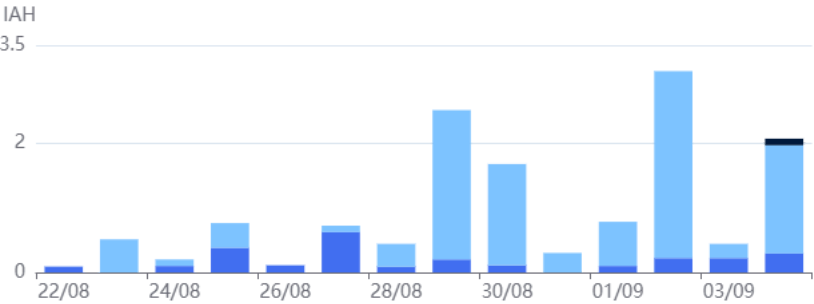

IA 0.18
IH 0.79
IAC 0.01
IAH 0.97

Valores médios dos indicadores




SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
22/08/2025 a 05/09/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:
SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/09/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco

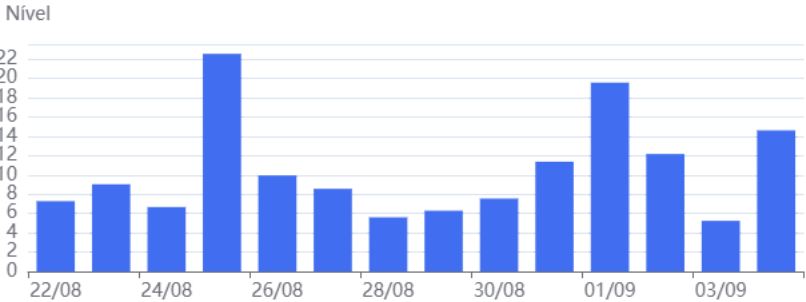

Valores médios dos indicadores

Ronco 10.47