



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
14/10/2025 a 21/10/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 21/10/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente

**Dados do Equipamento**

Máquina: YH690B-246010027

Modo: APAP

Pressão Inicial: 5 cmH2O

Pressão de terapia: 5 cmH2O

Rampa: 165 minutos

Nível de FPS: 1 cmH2O

Umidificação: Nível 165

**Utilização**

Dias de utilização: 4/8 dias (50%)

≥ 4 horas: 4 dias (50%)

< 4 horas: 0 dias (0%)

Horas de utilização: 39h48

Utilização média (por dia): 9h57

**Terapia**

Pressão (cmH2O):
Mediana: 6.3
Percentil 90.º: 6.3
Máximo: 6.55

Fugas (L/min):
Mediana: 0.3
Percentil 90.º: 0.3
Máximo: 0.3

Eventos por hora:
IA 0.10
IH 0.21
IAC 0.00
IAH 0.32



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
14/10/2025 a 21/10/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 21/10/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Utilização

●

Uso

9h57

Valores médios dos indicadores

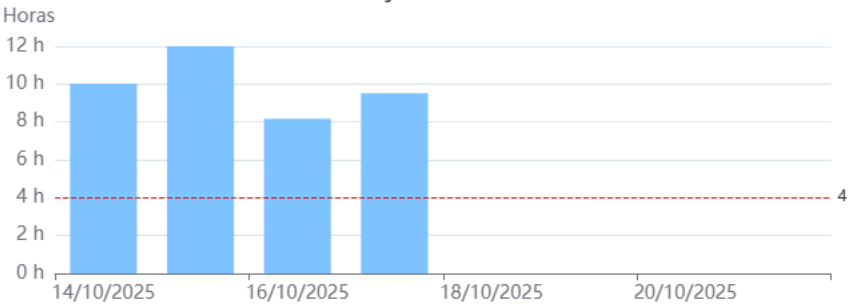

Fuga

●

Fuga

0.25

Valores médios dos indicadores



Pressão

●

Pressão APAP

6.29

●

Pressão CPAP


0.00

●

FPS

1.00

Valores médios dos indicadores

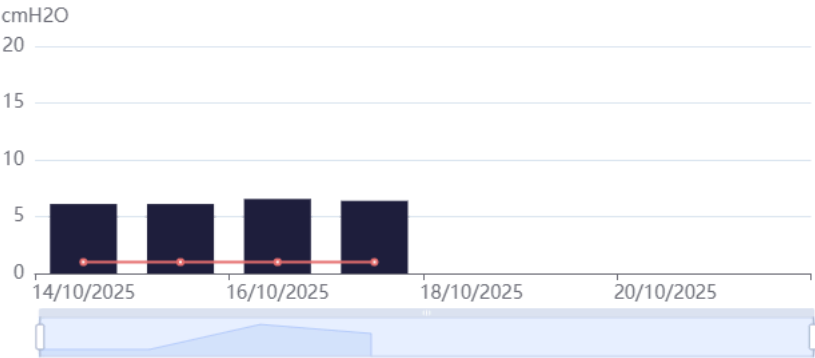

Eventos

●

IA

0.1

●

IH

0.21

●

IAC


0

○

IAH

0.32

Valores médios dos indicadores

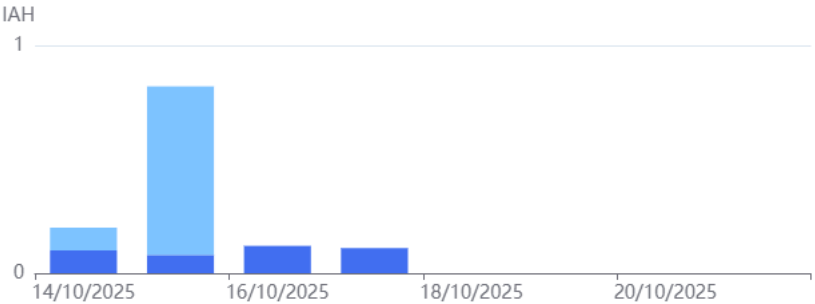



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
14/10/2025 a 21/10/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 21/10/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco

Ronco 43.70

Valores médios dos indicadores

