



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
16/08/2025 a 22/08/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:
SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 22/08/2025 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Relatório do Paciente

 Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010027
Modo: APAP
Pressão Inicial: 4 cmH2O
Pressão de terapia: 4 cmH2O
Pressão mín: 4 cmH2O
Pressão máx: 10 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Automático

 Utilização

Dias de utilização: 6/7 dias (85%)
≥ 4 horas: 6 dias (85%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 61h46
Utilização média (por dia): 10h17

 Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 4.8	Mediana: 0.1	IA 0.09
Percentil 90.º: 4.9	Percentil 90.º: 0.2	IH 0.33
Máximo: 5.02	Máximo: 0.8	IAC 0.02
		IAH 0.42



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
16/08/2025 a 22/08/2025

Paciente: 9473
Idade: 68 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:
SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 22/08/2025 - Pág. 2/2


Gerado por
sac@gaslive.com.br

Utilização

Uso

10h18

Valores médios dos indicadores

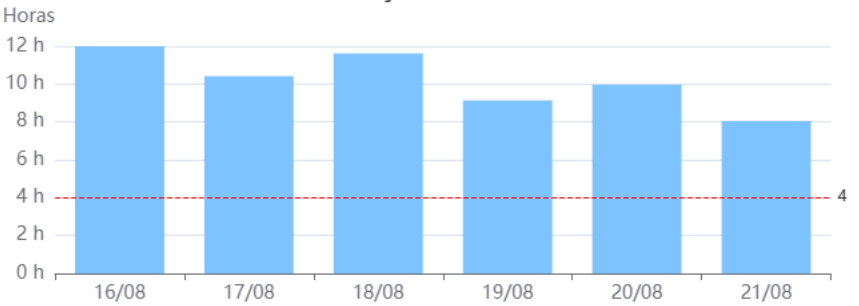


Fuga

Fuga

0.25

Valores médios dos indicadores

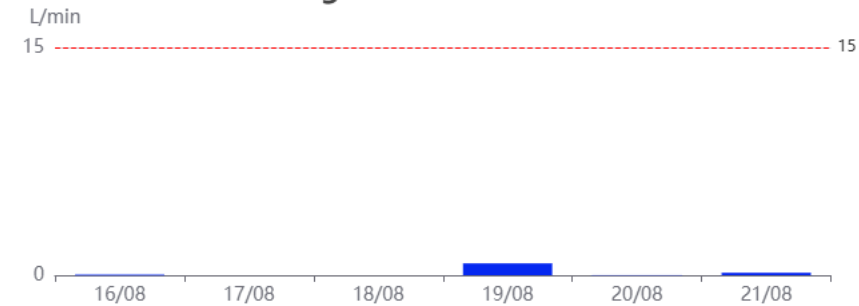

Pressão

Pressão APAP

4.78


Pressão CPAP

0.00

FPS

1.00

Valores médios dos indicadores

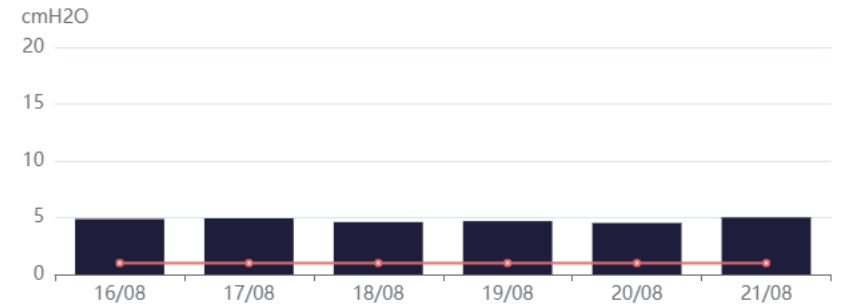

Eventos

IA

0.09

IH

0.33


IAC

0.02

IAH

0.42

Valores médios dos indicadores

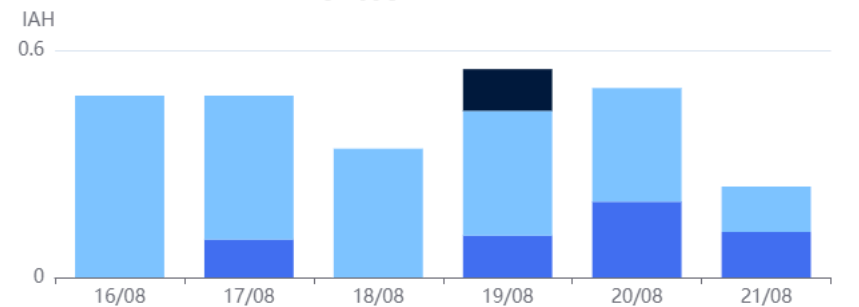



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
16/08/2025 a 22/08/2025

Paciente	9473	SONOFISIO
Idade:	68 anos	sonofisio.mf@gmail.com
Peso:	Kg	
Altura:	NaN	Relatório gerado em: 22/08/2025 - Pág. 2/2
IMC:		

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco

Ronco 8.12

Valores médios dos indicadores

