


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/08/2025 - 27/08/2025
Dias de utilização	9/10 dias (90%)	
>= 4 horas	7 dias (70%)	
< 4 horas	2 dias (20%)	
Horas de utilização	59 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 35 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 58 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/08/2025)	1,544 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882359
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 12.1	Percentil 95.º: 31.5	Máximo: 52.9	
Eventos por hora	IA: 6.5	IH: 0.1	IAH: 6.6	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 4.2	Desconhecid	2.2
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

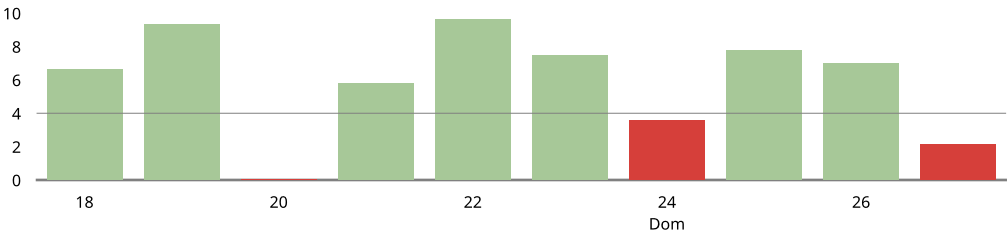


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882359


Utilização (horas)

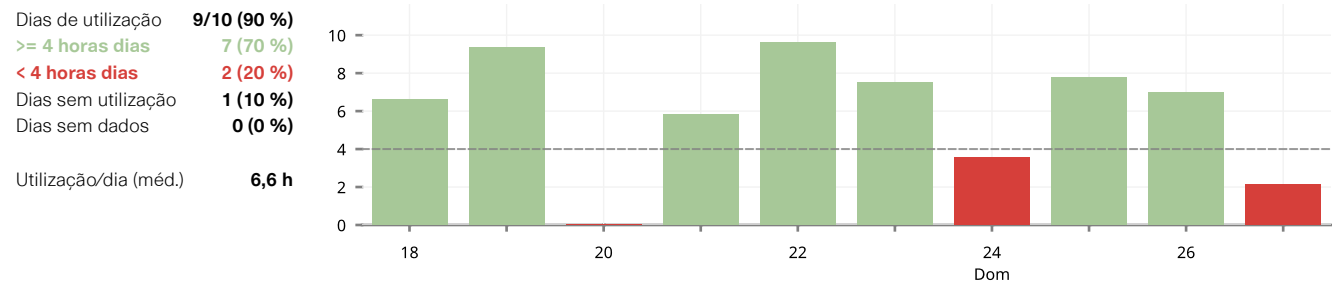

Fuga (l/min)

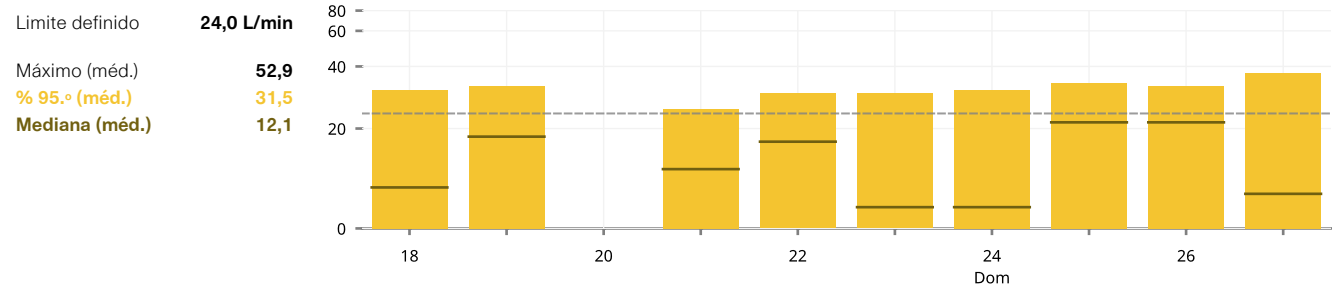

Pressão (cmH2O)

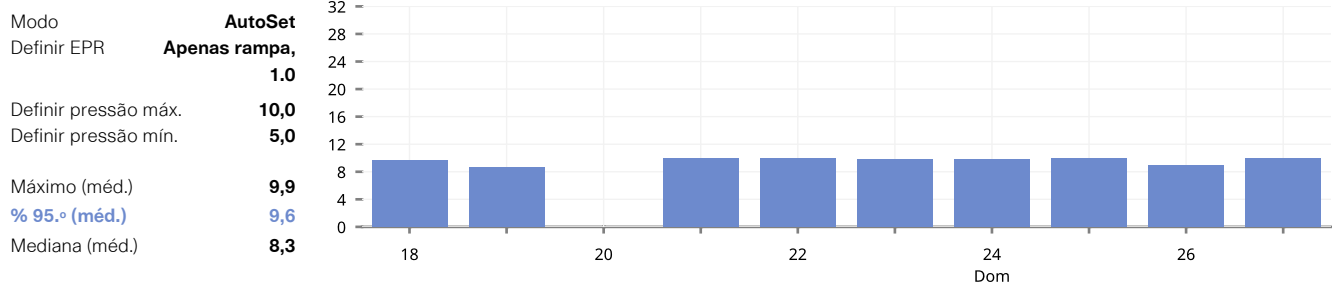

IAH (eventos/hora)

