


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |              | 22/08/2025 - 20/09/2025 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Dias de utilização                                           |              | 27/30 dias (90%)        |                 |
| >= 4 horas                                                   |              | 27 dias (90%)           |                 |
| < 4 horas                                                    |              | 0 dias (0%)             |                 |
| Horas de utilização                                          |              | 207 horas 24 minutos    |                 |
| Utilização média (total de dias)                             |              | 6 horas 55 minutos      |                 |
| Utilização média (dias de utilização)                        |              | 7 horas 41 minutos      |                 |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |              | 7 horas 40 minutos      |                 |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 20/09/2025) |              | 3,054 horas             |                 |
| AirSense 10 Elite                                            |              |                         |                 |
| Número de série                                              |              | 22222363606             |                 |
| Modo                                                         |              | CPAP                    |                 |
| Pressão definida                                             |              | 7 cmH2O                 |                 |
| EPR                                                          |              | Tempo total             |                 |
| Nível de EPR                                                 |              | 3                       |                 |
| Terapia                                                      |              |                         |                 |
| Fugas — l/min                                                | Mediana: 1.1 | Percentil 95.º: 15.6    | Máximo: 44.8    |
| Eventos por hora                                             | IA: 3.3      | IH: 0.2                 | IAH: 3.5        |
| Índice de apneia                                             | Central: 0.9 | Obstrutiva: 2.2         | Desconhecid 0.1 |
| Índice RERA                                                  |              | 0.2                     |                 |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)           |              | 2 minutos (1%)          |                 |

## Horas de utilização

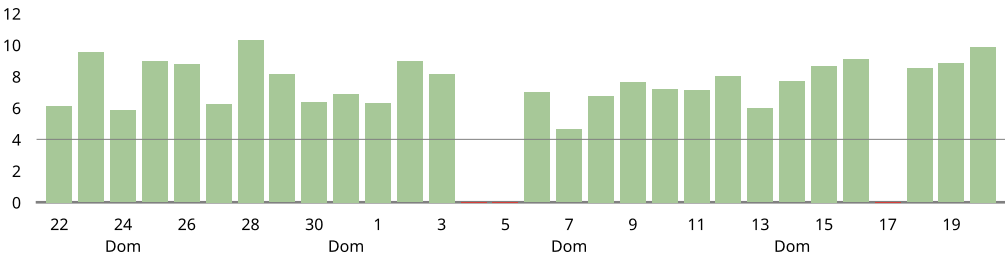


# Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22222363606


## Utilização (horas)

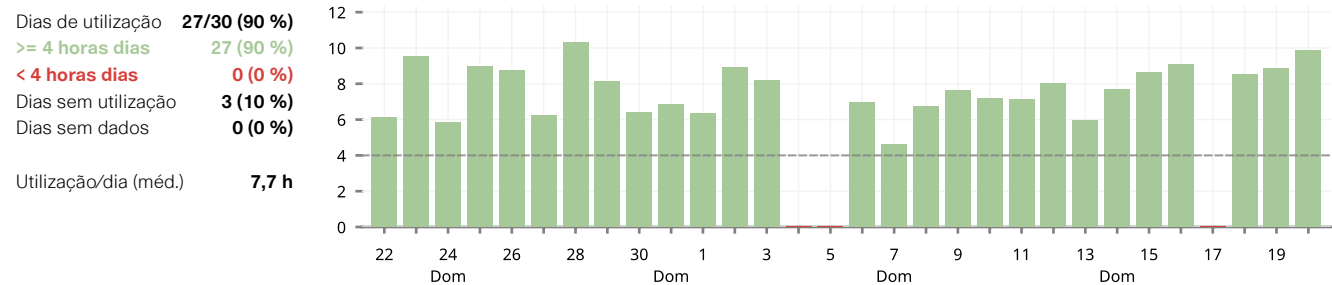

## Fuga (l/min)

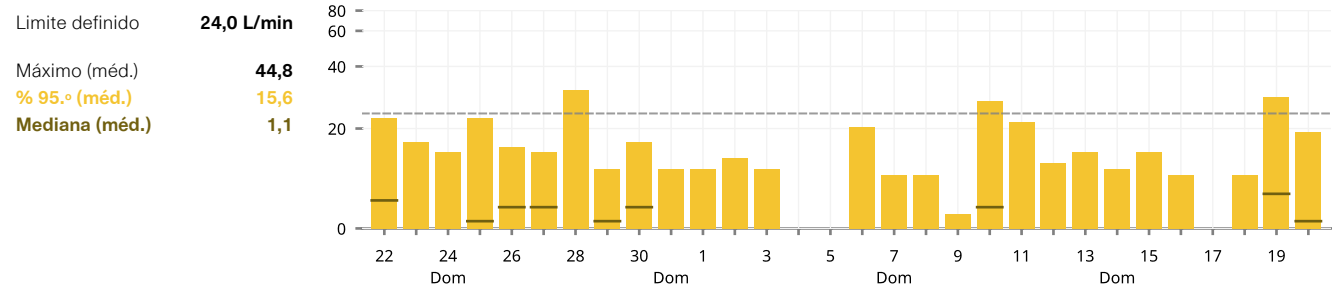

## Pressão (cmH2O)

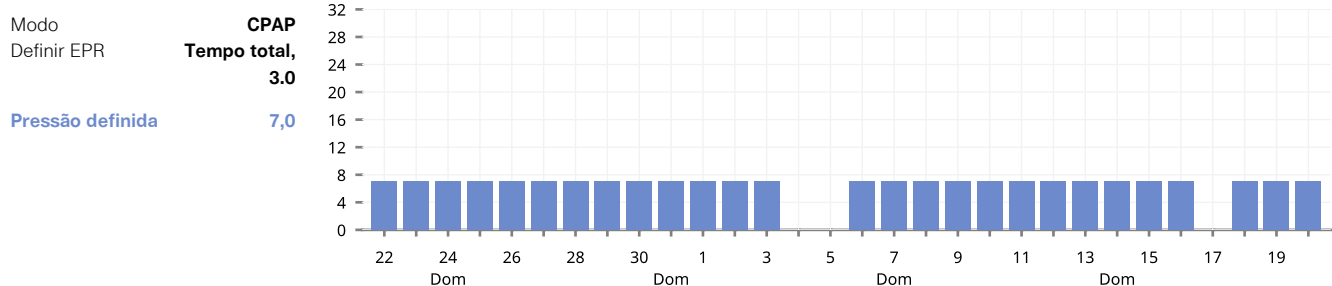

## IAH (eventos/hora)

