


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/02/2026 - 11/03/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	192 horas 8 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/03/2026)	7,662 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221799892
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	5.5	Percentil 95.º:	6.5	Máximo:	6.8
Fugas — l/min	Mediana:	0.0	Percentil 95.º:	9.6	Máximo:	22.4
Eventos por hora	IA:	0.4	IH:	0.0	IAH:	0.4
Índice de apneia	Central:	0.3	Obstrutiva:	0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

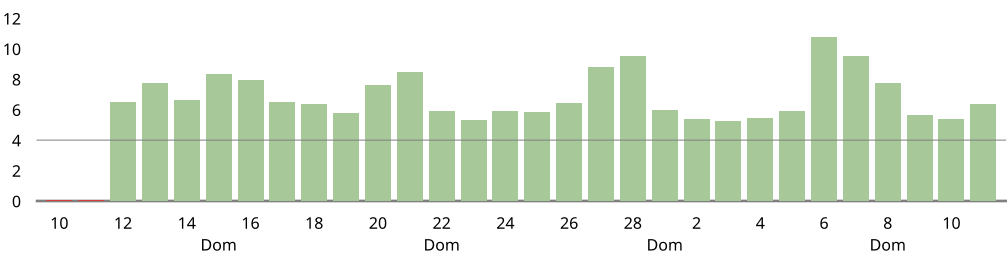


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221799892


Utilização (horas)

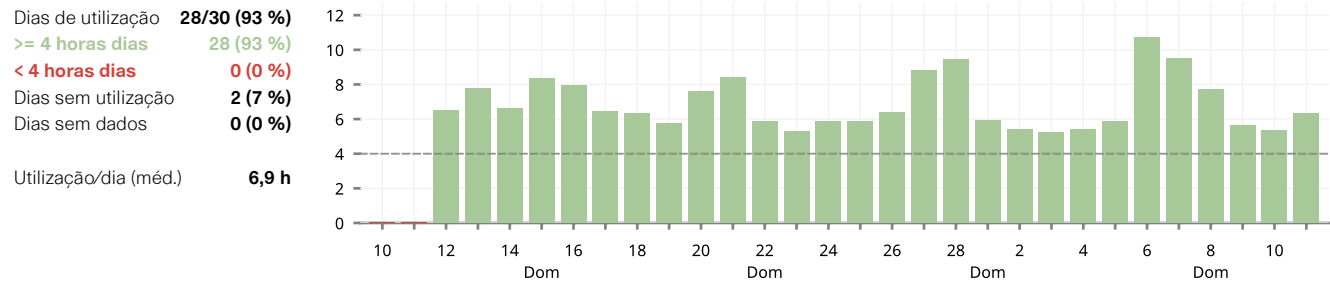

Fuga (l/min)

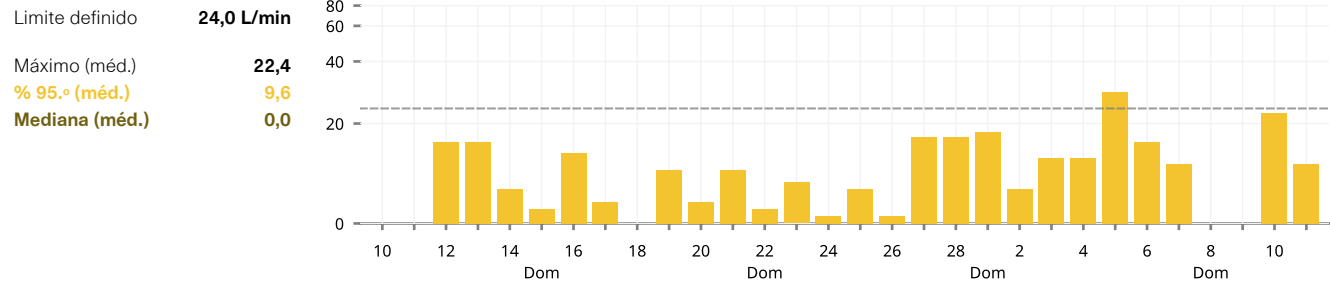

Pressão (cmH2O)

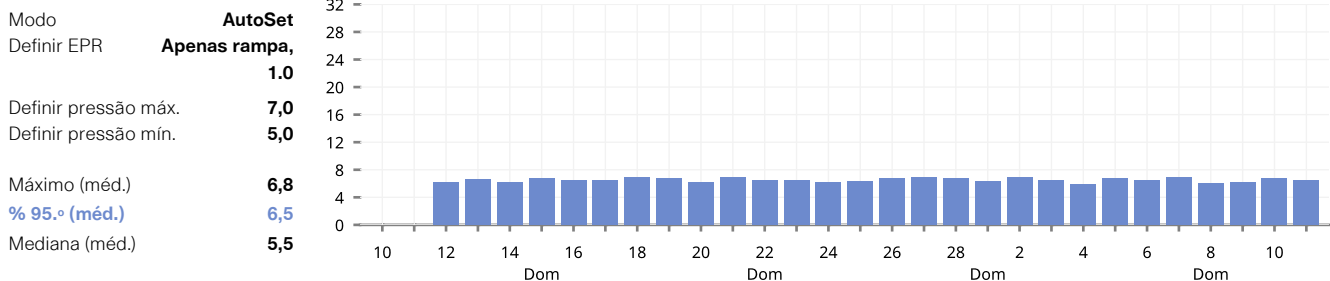

IAH (eventos/hora)

