


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/10/2025 - 25/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	194 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 29 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/11/2025)	7,111 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221799892
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 6.5	Máximo: 6.8	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 13.7	Máximo: 23.0	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.0	IAH: 0.3	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

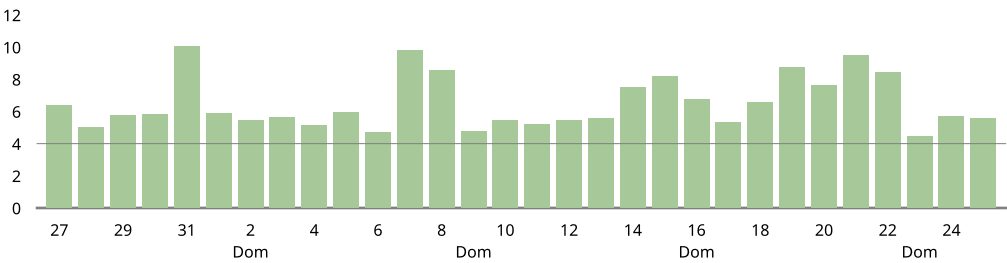


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221799892


Utilização (horas)

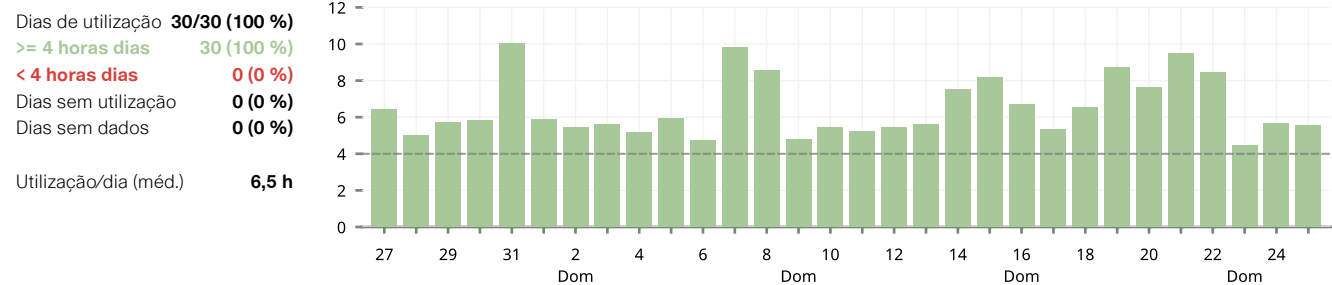

Fuga (l/min)

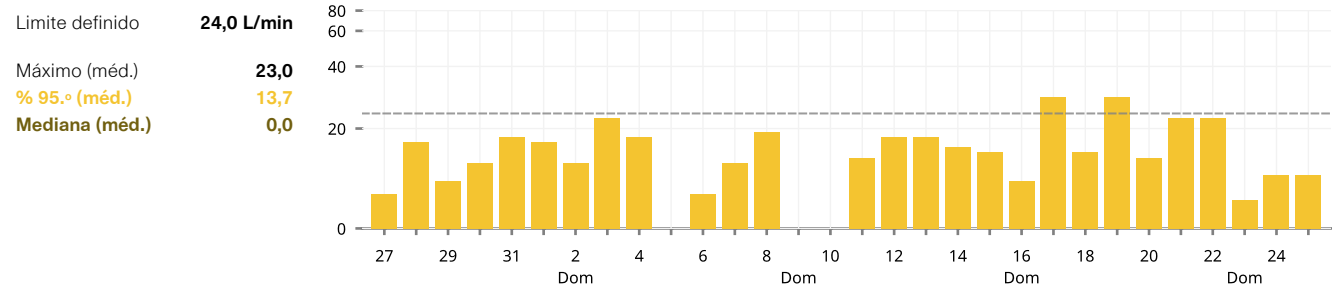

Pressão (cmH2O)

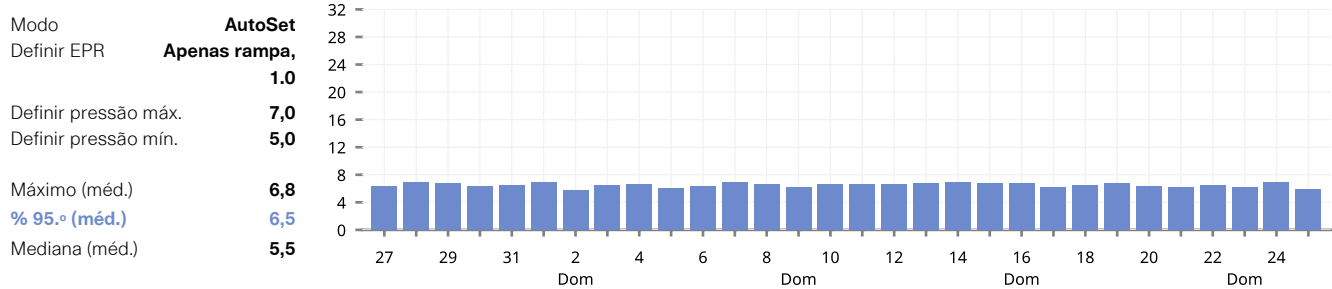

IAH (eventos/hora)

