


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/08/2025 - 24/08/2025
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	48 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	9 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	10 horas 0 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/08/2025)	4,373 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291899
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.2	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 19.2	Máximo: 46.3	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.2	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

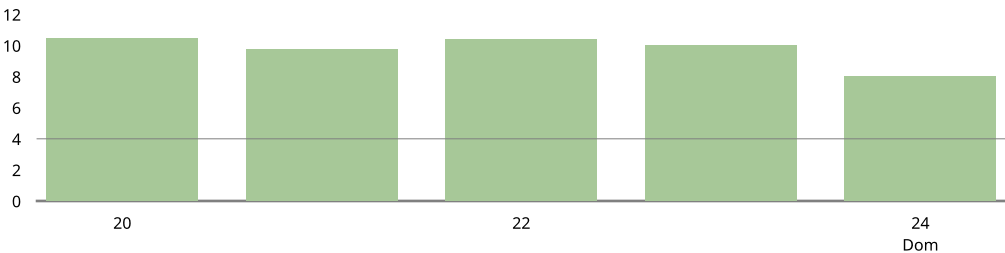


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291899


Utilização (horas)

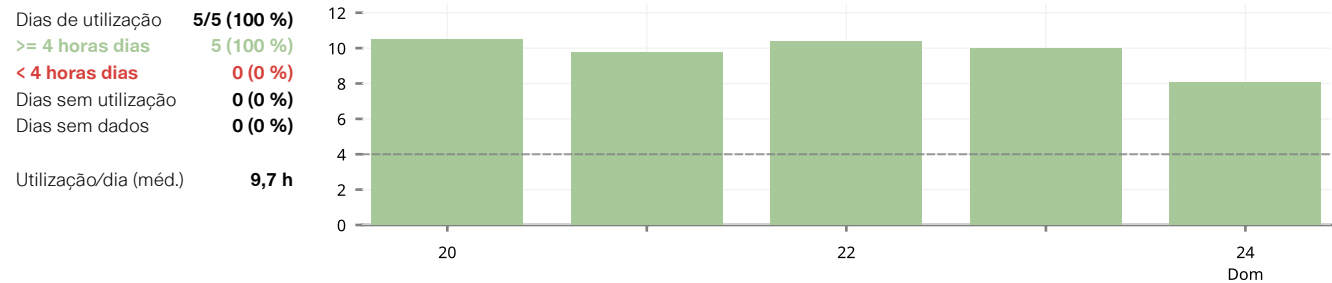

Fuga (l/min)

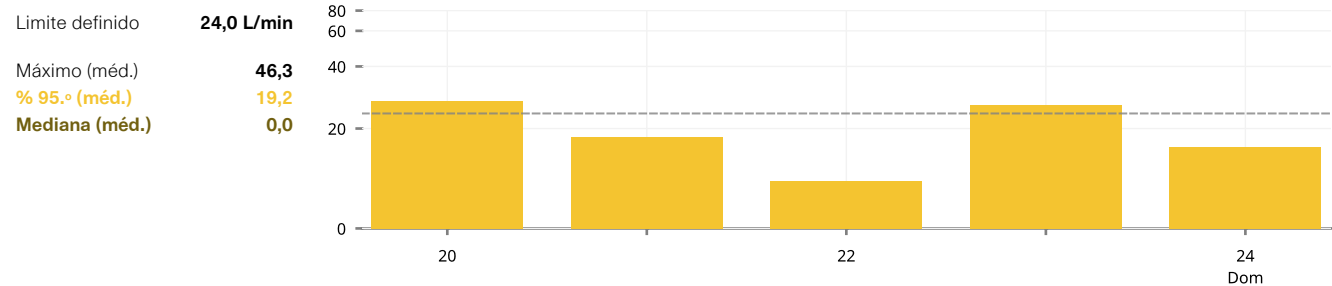

Pressão (cmH2O)

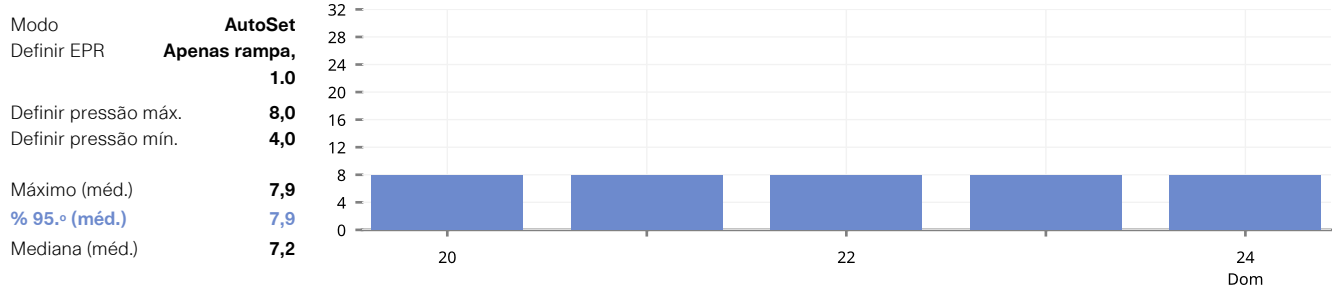

IAH (eventos/hora)

