


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/08/2025 - 28/08/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	4 dias (57%)	
< 4 horas	3 dias (43%)	
Horas de utilização	33 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/08/2025)	323 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222041444
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.2	Percentil 95.º: 11.4	Máximo: 11.7	
Fugas — l/min	Mediana: 12.7	Percentil 95.º: 31.4	Máximo: 43.7	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 2.9	IAH: 3.6	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

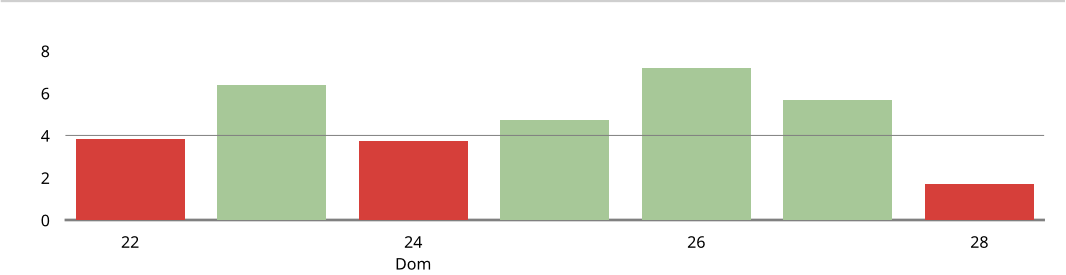


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222041444


Utilização (horas)

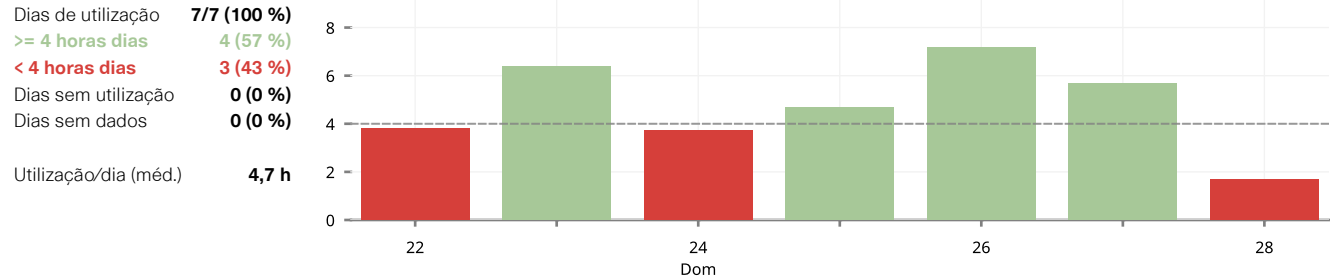

Fuga (l/min)

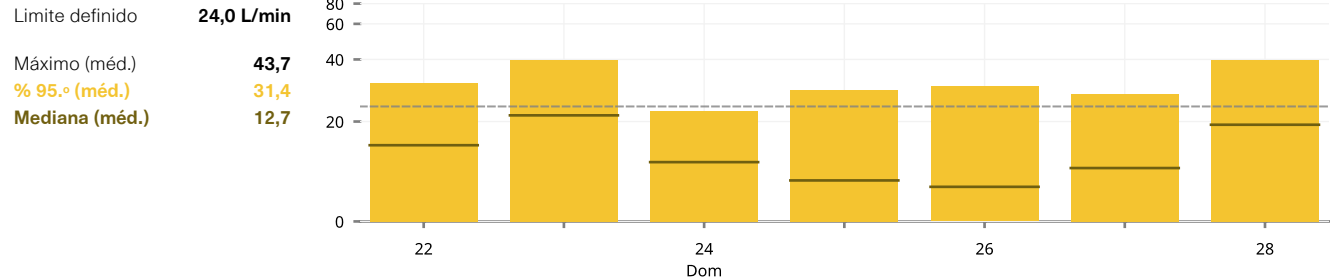

Pressão (cmH2O)

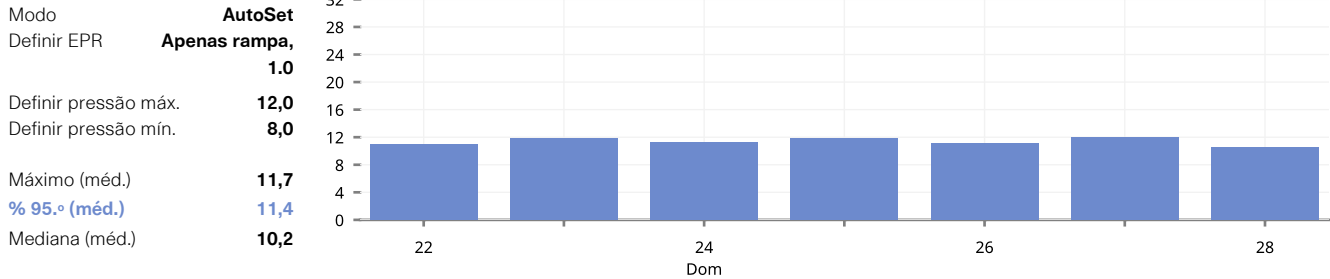

IAH (eventos/hora)

