


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/12/2025 - 03/01/2026
Dias de utilização	22/30 dias (73%)	
>= 4 horas	14 dias (47%)	
< 4 horas	8 dias (27%)	
Horas de utilização	91 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/01/2026)	4,723 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221021276
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.8	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 3.7	Percentil 95.º: 20.2	Máximo: 27.5	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.1	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

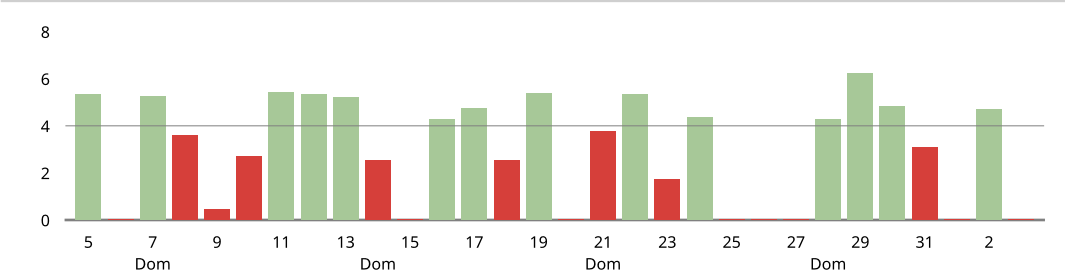


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221021276


Utilização (horas)

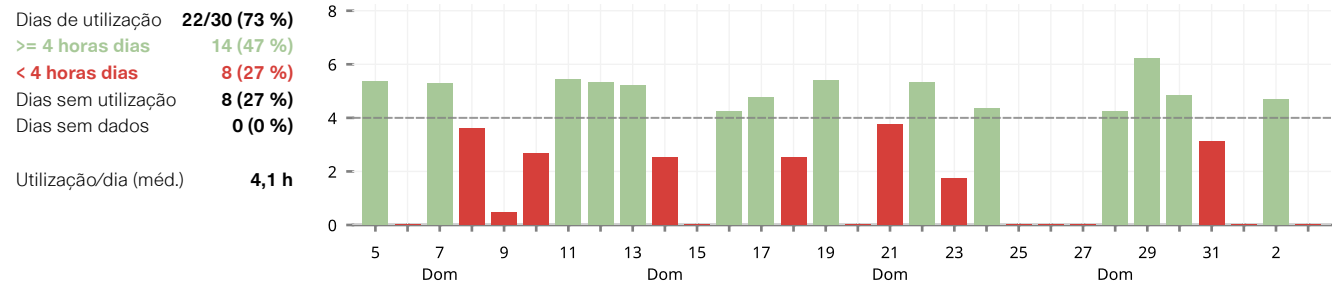

Fuga (l/min)

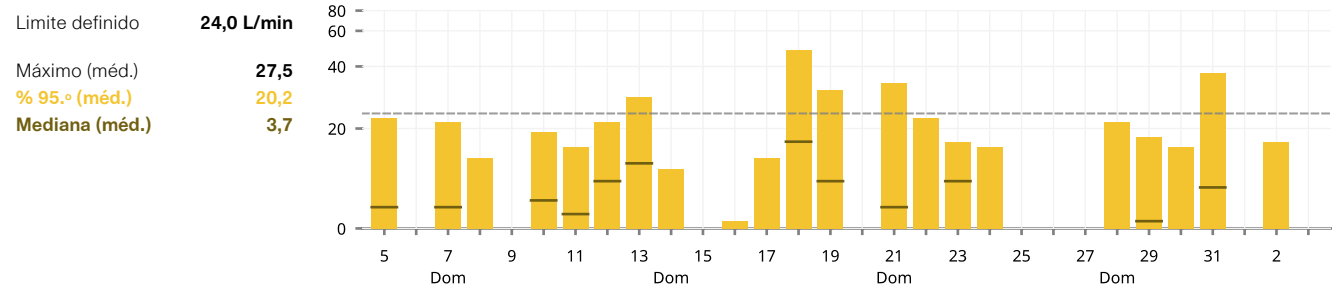

Pressão (cmH2O)

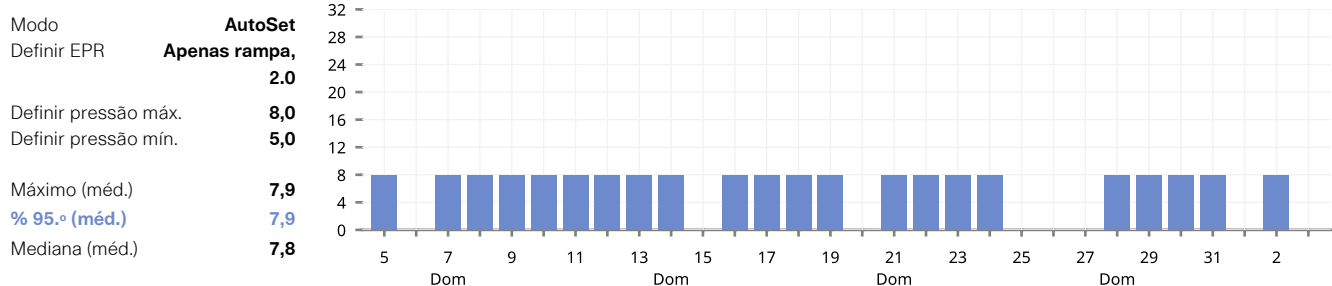

IAH (eventos/hora)

