

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. WALDIR DA SILVA BRANCO**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **25 outubro 1953** Idade: **71**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **25/08/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

19/07/2025 - 17/08/2025 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 2222322765)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 11,0 cmH2O	APE: FULL_TIME
Nível APE: 3,0 cmH2O	Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON
Activação subida: AUTO	Tempo de rampa: 45,0 Minutos	Acesso: LIGADO
Fuga - l/min		
Mediana: 3,6	Percentil 95: 28,8	Máximo/a: 39,0
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 1,0	Índice de hipopneia: 0,5	AHI: 1,6
Obstrutiva: 0,0	Central: 0,8	Desconhecida: 0,0
Índice RERA: 0,1	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 21	Dias de Uso < 4 horas : 9	% Dias de Uso >= 4 horas : 70
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 166:10
Mediana do uso diário: 5:52	Média de uso diário: 5:32	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


19/07/2025 - 17/08/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 2222322765)


Pressão

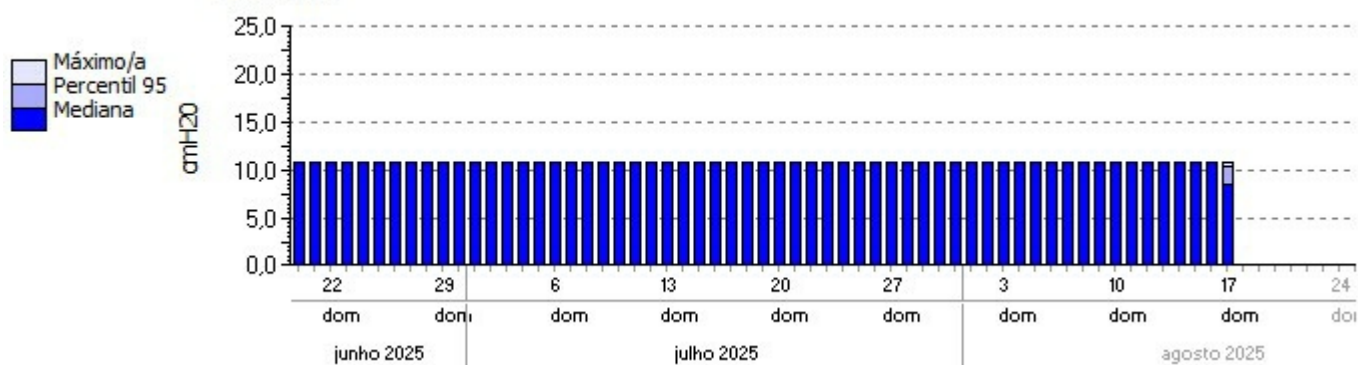


Fuga

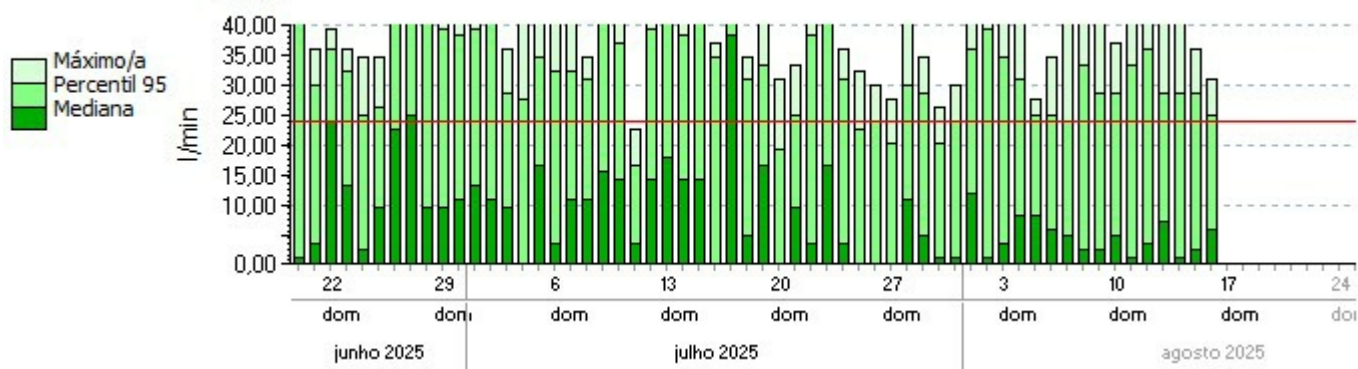

IAH & IA

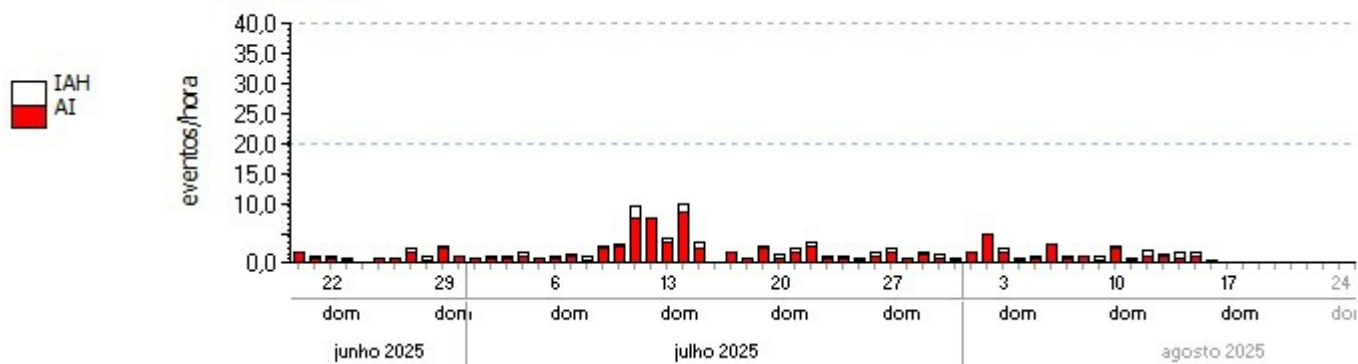

Uso

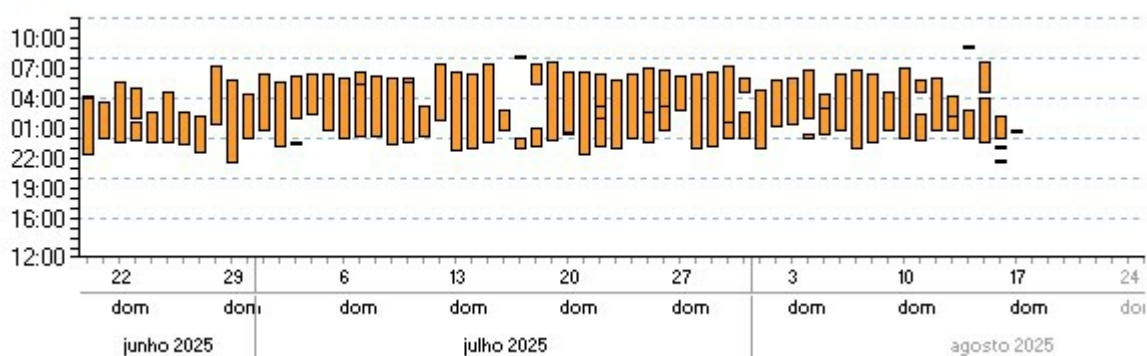

Utilização total e Cheyne-Stokes

