



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Márcia Tigani Machado

SOLICITADO POR: Dra. Ana Claudia Matos e Faria

DATA: 20/08/2025

IDADE: 65 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 6h32min, com duração do registro do fluxo durante 5h28min e a avaliação da saturação de O₂ durante 6h22min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 0,9/hora, sendo 0 apneia/hora e 0,9 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 5,8 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 96%, sendo a **média** de 87 e a **mínima** de 83%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 62; **máxima**: 92 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).


CONCLUSÃO:

O **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (0,9/hora; índice normal até 4/hora) permaneceu no limite da normalidade. Registraram-se dessaturações da oxi-hemoglobina (**índice de dessaturação de oxigênio**: 5,8).

Registraram-se 5470 episódios respiratórios, sendo 16,7 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 9 eventos de ronco (2 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).



Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Relatório de diagnóstico


Detalhes da gravação				20/08/2025
Dispositivo	ApneaLink Air		Tipo:	III
Gravação	Início: 10:45pm	Fim: 5:18am	Duração - h:	6:32
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 10:55pm	Fim: 5:16am	Duração - h:	5:28
Avaliação saturação O2	Início: 10:55pm	Fim: 5:18am	Duração - h:	6:22

Estatísticas			
			
Índice de eventos	IER (IAH): 0.9	IA: 0.0	IH: 0.9
Supina	Tempo - h: 2:21	Porcentagem: 43.1	
	IER (IAH): 1.7	IA: 0.0	IH: 1.7
Não-supina	Tempo - h: 3:06	Porcentagem: 56.9	
	IER (IAH): 0.3	IA: 0.0	IH: 0.3
Em pé	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.0	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Eventos totais	Apneias: 0	Hipopneias: 5	
AI	Obstrutiva: 0.0	Central: 0.0	Mista: 0.0 Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0	
Dessaturação de oxigênio	IDO: 5.8	Total: 37	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 96	Média: 87	Mais baixo: 83
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 96	Sat. <=85%: 33	Sat. <=80%: 0
	Sat. <=88%: 78	Tempo <=88%-h: 4:58	
Respirações	Total: 5470	Média/minuto: 16.7	Ronco: 9
Pulso - bpm	Mín.: 62	Média: 73	Máx.: 92

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.


Gráficos

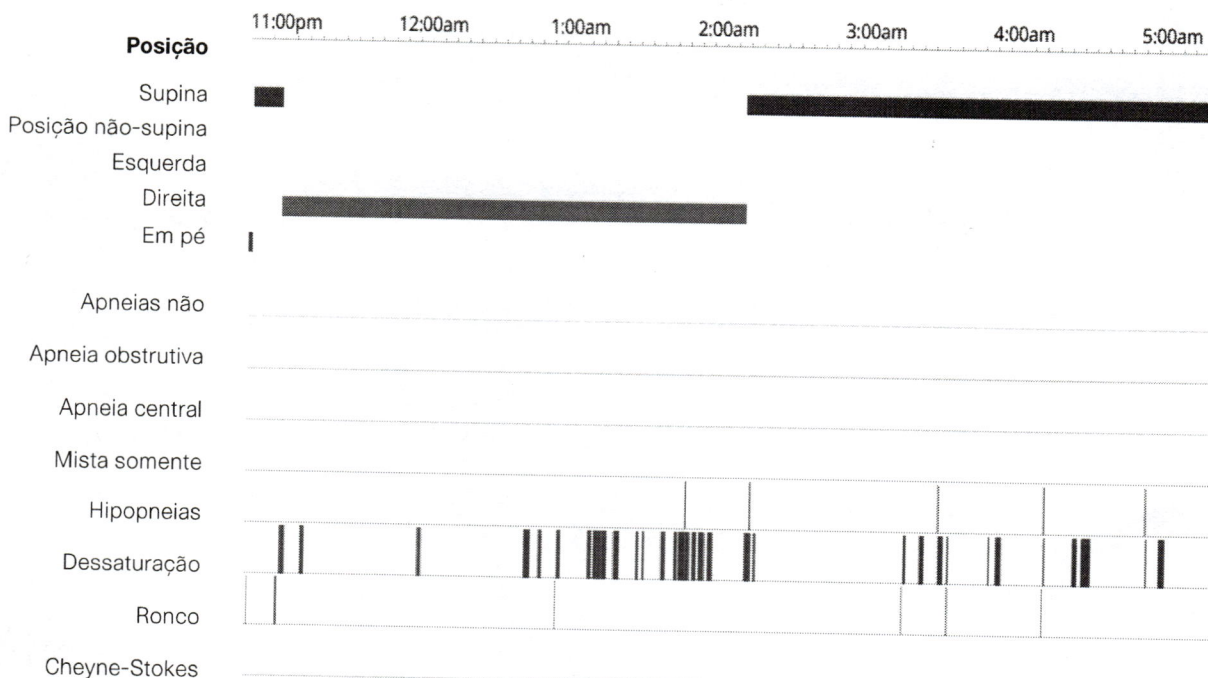

Saturação de

(%)

Valor inicial 96
Média 87
Mais baixo 83

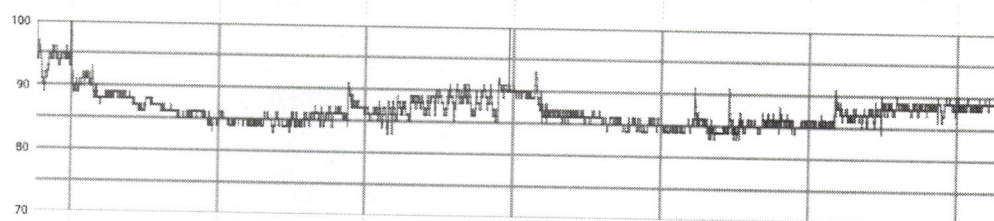

Pulso (bpm)

Mín. 62
Média 73
Máx. 92

